

IND256x

Weighing Terminal

Installation Manual | Guía de instalación |
Installationshandbuch | Guide d'installation |
Guida all'installazione | Guia de instalação



METTLER TOLEDO

IND256x Weighing Terminal

METTLER TOLEDO Service

Essential Services for Dependable Performance of Your IND256x Weighing Terminal

Congratulations on choosing the quality and precision of METTLER TOLEDO. Proper use of your new equipment according to this Manual and regular calibration and maintenance by our factory-trained service team ensures dependable and accurate operation, protecting your investment. Contact us about a service agreement tailored to your needs and budget. Further information is available at www.mt.com/service.

There are several important ways to ensure you maximize the performance of your investment:

1. **Register your product:** We invite you to register your product at www.mt.com/productregistration so we can contact you about enhancements, updates and important notifications concerning your product.
2. **Contact METTLER TOLEDO for service:** The value of a measurement is proportional to its accuracy – an out of specification scale can diminish quality, reduce profits and increase liability. Timely service from METTLER TOLEDO will ensure accuracy and optimize uptime and equipment life.
 - a. **Installation, Configuration, Integration and Training:** Our service representatives are factory-trained, weighing equipment experts. We make certain that your weighing equipment is ready for production in a cost effective and timely fashion and that personnel are trained for success.
 - b. **Initial Calibration Documentation:** The installation environment and application requirements are unique for every industrial scale so performance must be tested and certified. Our calibration services and certificates document accuracy to ensure production quality and provide a quality system record of performance.
 - c. **Periodic Calibration Maintenance:** A Calibration Service Agreement provides on-going confidence in your weighing process and documentation of compliance with requirements. We offer a variety of service plans that are scheduled to meet your needs and designed to fit your budget.
 - d. **GWP® Verification:** A risk-based approach for managing weighing equipment allows for control and improvement of the entire measuring process, which ensures reproducible product quality and minimizes process costs. GWP (Good Weighing Practice), the science-based standard for efficient life-cycle management of weighing equipment, gives clear answers about how to specify, calibrate and ensure accuracy of weighing equipment, independent of make or brand.

© METTLER TOLEDO 2019

No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any purpose without the express written permission of METTLER TOLEDO.

U.S. Government Restricted Rights: This documentation is furnished with Restricted Rights.

Copyright 2019 METTLER TOLEDO. This documentation contains proprietary information of METTLER TOLEDO. It may not be copied in whole or in part without the express written consent of METTLER TOLEDO.

METTLER TOLEDO reserves the right to make refinements or changes to the product or manual without notice.

COPYRIGHT

METTLER TOLEDO® is a registered trademark of Mettler-Toledo, LLC. All other brand or product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

METTLER TOLEDO RESERVES THE RIGHT TO MAKE REFINEMENTS OR CHANGES WITHOUT NOTICE.

FCC Notice


This device complies with Part 15 of the FCC Rules and the Radio Interference Requirements of the Canadian Department of Communications. Operation is subject to the following conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.






This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his or her expense.

■ Declaration of Conformity is available at
<http://glo.mt.com/global/en/home/search/compliance.html/compliance/>.

Warnings and Cautions

- READ this manual BEFORE operating or servicing this equipment and FOLLOW these instructions carefully.
- SAVE this manual for future reference.

	 WARNING
	DO NOT INSTALL OR PERFORM ANY SERVICE ON THIS EQUIPMENT BEFORE THE AREA IN WHICH THE IND256x IS LOCATED HAS BEEN SECURED AS NON-HAZARDOUS BY PERSONNEL AUTHORIZED TO DO SO BY THE RESPONSIBLE PERSON AT THE CUSTOMER'S SITE.
	 CAUTION
	CONFIRM COMPLIANCE WITH APPLICABLE NATIONAL AND LOCAL WIFI REGULATIONS BEFORE INSTALLING AND COMMISSIONING IND256x TERMINAL CONFIGURED WITH WIFI MODULE. METTLER TOLEDO ACCEPTS NO RESPONSIBILITY FOR TERMINAL INSTALLATION IN COUNTRIES WHERE WIFI REGULATIONS ARE NOT FULFILLED.
	 WARNING
	IF THE IND256x KEYBOARD, DISPLAY LENS OR ENCLOSURE IS DAMAGED, THE DEFECTIVE COMPONENT MUST BE REPLACED IMMEDIATELY. REMOVE POWER IMMEDIATELY AND DO NOT REAPPLY POWER UNTIL THE DISPLAY LENS, KEYBOARD OR ENCLOSURE HAS BEEN REPAIRED OR REPLACED BY QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. FAILURE TO DO SO COULD RESULT IN BODILY HARM AND/OR PROPERTY DAMAGE.
	 WARNING
	AVOID ELECTROSTATIC CHARGING DURING OPERATION AND MAINTENANCE.
	 WARNING
	OPERATION IS ONLY PERMITTED WHEN OPERATIONAL AND PROCESS-RELATED ELECTROSTATIC CHARGES ARE NOT PRESENT.
	 WARNING
	USE THE WEIGHING TERMINAL ONLY WHEN ELECTROSTATIC PROCESSES LEADING TO PROPAGATION BRUSH DISCHARGE IS IMPOSSIBLE.
	 WARNING
	KEEP THE TERMINAL AWAY FROM PROCESSES THAT GENERATE HIGH CHARGING POTENTIAL SUCH AS ELECTROSTATIC COATING, RAPID TRANSFER OF NON-CONDUCTIVE MATERIALS, RAPID AIR JETS, AND HIGH PRESSURE AEROSOLS.
	 WARNING
	DO NOT USE DRY CLOTH TO CLEAN THE WEIGHING TERMINAL. ALWAYS USE A DAMP CLOTH TO CLEAN THE TERMINAL GENTLY.
	 WARNING
	WEAR SUITABLE CLOTHING. AVOID NYLON, POLYESTER OR OTHER SYNTHETIC MATERIALS THAT GENERATE AND HOLD CHARGE. USE CONDUCTIVE FOOTWEAR AND FLOORING.

	WARNING
	AVOID PLASTIC COVERS OVER THE TERMINAL.
	WARNING
	ENSURE PROPER EQUIPOTENTIAL GROUNDING OF THE TERMINAL, MOUNTING ACCESSORIES, AND THE SCALE BASE.
	WARNING
	TERMINAL MUST BE PROTECTED FROM UV LIGHT.
	WARNING
	FOR THE DC VERSION OF THE IND256x TERMINAL, THERE IS NO GALVANIC SEPARATION BETWEEN NON-INTRINSICALLY SAFE SUPPLY CIRCUIT AND INTRINSICALLY SAFE OUTPUT CIRCUITS. THE NON-INTRINSICALLY SAFE CIRCUIT MUST BE SAFELY CONNECTED TO EARTH. AND POTENTIAL EQUALIZATION MUST EXIST ALONG INTRINSICALLY SAFE CIRCUITS. ALTERNATIVELY, THE NON-INTRINSICALLY SAFE SUPPLY CIRCUIT (SELV) MUST BE SAFELY SEPARATED FROM EARTH.
	WARNING
	THE EXTERNAL CUSTOMER-PROVIDED DC POWER SUPPLY MUST HAVE A CATEGORY II MAXIMUM OVER-VOLTAGE, ACCORDING TO IEC 60664-1.
	WARNING
	SUFFICIENT STRAIN RELIEF MUST BE ENSURED TO PREVENT TENSILE FORCES ON THE CABLE GLANDS.
	WARNING
	THE CABLE GLANDS MUST BE PROTECTED AGAINST DAMAGE FROM IMPACT.
	WARNING
	THE TERMINAL ASSEMBLED WITH WIFI ANTENNA SHALL BE INSTALLED IN A POSITION IN SUCH A WAY THAT THE RISK FOR MECHANICAL DAMAGE IS LOW. REPLACE THE WIFI ANTENNA IMMEDIATELY IF DAMAGED.
	WARNING
	IND256x TERMINALS FACTORY-CONFIGURED WITH WIFI ARE APPROVED FOR USE IN ZONE 1 EQUIPMENT GROUP IIB CLASSIFIED AREAS. IND256x TERMINALS FACTORY-CONFIGURED WITH WIFI MUST NOT BE USED IN EQUIPMENT GROUP IIC CLASSIFIED AREA. USING THE IND256X TERMINAL FACTORY-CONFIGURED WITH WIFI IN A CLASSIFIED AREA FOR WHICH IT IS NOT APPROVED COULD RESULT IN BODILY HARM AND/OR PROPERTY DAMAGE.
	WARNING
	THE EXTERNAL CUSTOMER-PROVIDED DC POWER SUPPLY MUST HAVE A MAXIMUM OVER-VOLTAGE CATEGORY II ACCORDING TO IEC 60664-1.

	 WARNING DO NOT OPEN THE TERMINAL WHEN THE ATMOSPHERE IS EXPLOSIVE DUE TO DUST. TO PREVENT IGNITION OF HAZARDOUS ATMOSPHERES, DISCONNECT THE IND256x FROM ITS POWER SOURCE BEFORE OPENING THE ENCLOSURE. KEEP COVER TIGHTLY CLOSED WHILE THE CIRCUIT IS ENERGIZED. DO NOT OPEN WHEN AN EXPLOSIVE DUST ATMOSPHERE IS PRESENT.
	 WARNING ALL EQUIPMENT MUST BE INSTALLED PER MANUFACTURER'S DOCUMENT DRAWING NUMBER 30282892B AND APPLICABLE LOCAL CODES.
	 WARNING ONLY THE COMPONENTS SPECIFIED IN THE INSTALLATION MANUAL INCLUDED ON THE DOCUMENTATION CD-ROM 30512916 CAN BE USED IN THIS DEVICE. ALL EQUIPMENT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE INSTALLATION INSTRUCTIONS. INCORRECT OR SUBSTITUTE COMPONENTS AND/OR DEVIATION FROM THESE INSTRUCTIONS CAN IMPAIR THE INTRINSIC SAFETY OF THE TERMINAL AND COULD RESULT IN BODILY INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.
	 WARNING FOR CONTINUED PROTECTION AGAINST SHOCK HAZARD, CONNECT TO PROPERLY GROUNDED POWER SOURCE ONLY. DO NOT REMOVE THE GROUNDING CONNECTION.
	 WARNING WHEN THIS EQUIPMENT IS INCLUDED AS A COMPONENT PART OF A SYSTEM, THE RESULTING DESIGN MUST BE REVIEWED BY QUALIFIED PERSONNEL WHO ARE FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF ALL COMPONENTS IN THE SYSTEM AND THE POTENTIAL HAZARDS INVOLVED. FAILURE TO OBSERVE THIS PRECAUTION COULD RESULT IN BODILY HARM AND/OR PROPERTY DAMAGE.
	 WARNING ONLY PERMIT QUALIFIED PERSONNEL TO SERVICE THE IND256x. EXERCISE CARE WHEN MAKING CHECKS, TESTS AND ADJUSTMENTS THAT MUST BE MADE WITH POWER ON. FAILING TO OBSERVE THESE PRECAUTIONS CAN RESULT IN BODILY HARM AND/OR PROPERTY DAMAGE.
	 WARNING BEFORE CONNECTING/DISCONNECTING ANY INTERNAL ELECTRONIC COMPONENTS OR INTERCONNECTING WIRING BETWEEN ELECTRONIC EQUIPMENT ALWAYS REMOVE POWER AND WAIT AT LEAST THIRTY (30) SECONDS BEFORE ANY CONNECTIONS OR DISCONNECTIONS ARE MADE. FAILURE TO OBSERVE THESE PRECAUTIONS COULD RESULT IN DAMAGE TO OR DESTRUCTION OF THE EQUIPMENT AND/OR BODILY HARM.
	NOTICE OBSERVE PRECAUTIONS FOR HANDLING ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES.

Disposal of Electrical and Electronic Equipment



In conformance with the European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) this device may not be disposed of in domestic waste. This also applies to countries outside the EU, per their specific requirements.

Please dispose of this product in accordance with local regulations at the collecting point specified for electrical and electronic equipment.

If you have any questions, please contact the responsible authority or the distributor from which you purchased this device.

Should this device be passed on to other parties (for private or professional use), the content of this regulation must also be related.

Thank you for your contribution to environmental protection.

Contents

1	Introduction	1-1
1.1.	IND256x Overview	1-1
1.2.	Product Specification	1-2
1.3.	Testing Standards	1-4
1.4.	Warnings and Precautions	1-6
1.5.	Inspection and Contents Checklist	1-6
1.6.	Configuration	1-7
1.7.	Equipotential Bonding (EB)	1-9
1.8.	Operating Environment	1-9
1.9.	Dimensions	1-10
1.10.	Main Board	1-12
1.11.	Communication Option Boards	1-12
2	Installation	2-1
2.1.	Opening the Enclosure	2-1
2.2.	Install Cables and Connectors	2-2
2.3.	Bonding and Grounding	2-6
2.4.	Equipotential Bonding (EB)	2-6
2.5.	Closing the Enclosure	2-7
2.6.	Analog Load Cell Connection	2-7
2.7.	Communication Boards Connection	2-8
2.8.	Sealing the Enclosure	2-12
2.9.	Interface Parameters	2-12

1 Introduction

1.1. IND256x Overview

The IND256x reflects the latest weighing technology from METTLER TOLEDO. The IND256x has passed third-party certification for weighing in hazardous areas, and can be directly used in Zone 1/Zone 21 locations.

A high-performance single-range or multi-range weighing terminal, the IND256x uses analog load cells to achieve reliable weighing at low cost, from grams to tons. It is easily integrated in an existing weighing system.

By connecting the appropriate safety barrier or isolated barrier, the IND256x can provide various intrinsically safe communication interfaces to communicate with PCs and printers in the safe area. These features permit IND256x to support a majority of weighing applications in most industrial fields, including:

- Pharmacy
- Powder processes
- Special chemicals
- Petrochemicals
- Agriculture
- Paints and inks
- Fine chemical engineering

1.1.1. IND256x Terminal Version

The IND256x is available with three different power supply choices:

- AC power input, using external alternating voltage (187-250 V 50/60 Hz)
- DC power input, using external direct voltage (DC 18-30 V)
- Intrinsically safe power input, using an external Ex NiMH battery pack (64060627)

Each of these versions has received ATEX and IECEx approvals for use in Zone 1 and Zone 21 classified areas.

1.1.2. IND256x Product Features

- Basic weighing in hazardous areas, including zero, tare and print functions
- Harsh environment desk, column- or wall-mounted enclosure
- Connects to a single analog weighing platform
- 240 x 96 pixel white backlit LCD, 25mm high digits
- Real-time clock (power-down save)

- Includes one intrinsically safe serial port (COM1) for asynchronous two-way communication and print output
- Support for the following internal option boards:
 - Intrinsically safe 4-20 mA analog output
 - WiFi communication module with antenna (only in IND256x terminals factory-configured with WiFi module)
 - Active current loop – for connection to an ACM200 communication module located in the safe area, or to connect second IND256x terminal configured with passive current loop option
 - Passive current loop (used as the second display to connect another terminal with an active current loop)
- Supports three customized ID inputs
- Target table supports 25 pre-set targets for Checkweighing
- Tare table supports 20 pre-set tare values
- Supports g, kg, t, ton, lb and oz
- Saves 60,000 transaction data items
- Supports accumulation and accumulative total
- Permits the customization of five different print templates
- Supports weight-free calibration (CalFREE™)

1.2. Product Specification

Table 1-1 shows the IND256x specifications.

Table 1-1: IND256x Specifications

Item	Specification
Enclosure	304 stainless steel, can be wall- or pole-mounted
Dimensions h × w × d)	173 mm × 230 mm × 127 mm (6.8 in. × 9.1 in. × 5.0 in.)
Transport weight	3.5 kg (8 lb)
Protection grade	IP66
Storage environment	Storage temperature range: –20°C to 60° C (–4° to 140°F) Relative humidity: 10% to 95%, non-condensing
Service environment	Operating temperature range: –10°C to 40° C (14° to 104°F) Relative humidity: 10% to 95%, non-condensing

Item	Specification
Hazardous area	IND256x is approved for use in Zone 1/Zone 21 hazardous areas
Power supply	AC power (187-253V 50/60Hz) DC power (CD 18-30 V) External NiMH Ex battery pack (64060627)
Display	240 x 96 pixel white backlit LCD, 25mm high digits Display update rate: 10 Hz
Weight display	Maximum 100,000 divisions
Weighing platform type	Analog load cell
Sensor quantity	Maximum of four 350-ohm load cells (minimum 87 ohm), 2 mv/V or 3 mv/V
Weighing platform quantity	Supports one weighing platform
Refresh rate	>366 Hz
Sensor excitation voltage	4.5 VDC
Minimum sensitivity	0.6µV/e
Keyboard	26 keys; 1.5mm thick membrane keyboard
Communication mode	Standard interface: The mainboard is provided with an intrinsically safe RS232 communication interface Interface options: Intrinsically safe 4-20 mA analog output module, with 16-bit D/A conversion and 25 Hz update rate to PLC or WiFi communication module (only in IND256x terminals factory-configured with WiFi module); or Intrinsically safe active current loop or Intrinsically safe passive current loop Communication Protocols: Serial port input: ASCII commands - CTPZ (Clear, Tare, Print, Zero), SICS commands (supports SICS level 0 and level 1) Serial port output: Toledo continuous output, command print output (5 configurable templates), SICS command and report print
Metrological Approval	Europe: OIML R76; Class III, 6000e; TC10878 Global: OIML R76; Class III, 6000e; R76-2006-A-NL1-18.27
Hazardous Area Approval, factory-configured WiFi version	Hazardous approval with non-intrinsically safe power supply (AC version and DC version): II 2G Ex eb ib [ib] mb IIB T4 Gb II 2D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db with intrinsically safe battery: II 2G Ex ib IIB T4 Gb II 2D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db

Item	Specification
Hazardous Area Approval, version without WiFi	with non-intrinsically safe power supply (AC version and DC version): II 2G Ex eb ib [ib] mb IIC T4 Gb II 2D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db with intrinsically safe battery: II 2G Ex ib IIC T4 Gb II 2D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db

Table 1-2: WiFi Module Specification (only for IND256x terminals factory-configured with WiFi module)

Item	Specification
Standard	802.11 b/g/n
Transmitting Power	14dBm (average)
RF Frequency Range	2.4GHz – 2.497GHz
Encryption	WEP, WPA
WEP	64 Bit, 128 Bit
WPA	WPA-TKIP, WPA2-AES
Protocol	TCP/IP
Work Mode	Server, Client
Transmitting distance	Max 50 meters in the open air
Approval	China: SRRC

1.3. Testing Standards

The IND256x terminal has been tested according to the following standards.

EN 60079-0:2012 + A11:2013	General requirements
EN 60079-7:2015	Increased safety "e"
EN 60079-11:2012	Intrinsic safety "i"
EN 60079-18:2015	Encapsulation "m"
EN 60079-31:2014	Protection by Enclosure "t"
IEC 60079-0:2017, Ed. 7.0	General requirements
IEC 60079-7:2017, Ed. 5.1	Increased safety "e"
IEC 60079-11:2011, Ed. 6.0	Intrinsic safety "i"
IEC 60079-18:2017, Ed. 4.1	Encapsulation "m"
IEC 60079-31:2013, Ed. 2.0	Protection by Enclosure "t"
FM3600 (2011)	Electrical Equipment for Use In Hazardous (Classified) Locations - General Requirements

FM3610 (2010)	Intrinsically Safe Apparatus and Associated Apparatus for Use in Class I, II & III, Division 1, Hazardous (Classified) Locations
FM3810 (2005)	Electrical Equipment for Measurement, Control and Laboratory Use
ANSI/IEC 60529	Degrees of Protection Provided by Enclosure(IP Code)
CSA C22.2 No. 157-1992 / 2006	Intrinsically safe and non-Incentive equipment for use in hazardous locations
CSA C22.2 No. 142-1990 / 2004	Process control equipment
CSA C22.2 No. 61010.1-2004	Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use – Part 1: General requirements
CAN/CSA 22.2 No. 60529-2005	Degrees of Protection Provided by Enclosure (IP Code)

1.3.1. **Special Conditions for Safe Use**

1. The apparatus must be protected from UV-light
2. Electrostatic charging during operation and maintenance has to be excluded. The terminal shall only be installed in areas where operational and process related electrostatic charges are not present.
3. For versions with non-intrinsically safe DC-supply (type key ends with "44" or "46"): There is no galvanic separation between non-intrinsically safe supply circuit and intrinsically safe output circuits:

The non-intrinsically safe supply circuit has to be safely connected to earth. In this case, the intrinsically safe circuits are earthed as well. Along the intrinsically safe circuits, potential equalization must exist.

or

The non-intrinsically safe circuit has to be safely separated from earth (e.g. SELV-circuit).
4. For DC version terminal, the supply circuit shall have at a maximum overvoltage category II according to IEC 60664-1.
5. The cable glands Series HSK-M-Ex... and V-Ms-Ex... according to KEMA 99 ATEX 6971X resp. IECEx BVS 07.0014X are tested with a reduced tensile force (25%) in accordance with clause A.3.1 if IEC 60079-0 and may only be used for fixed installation of group II apparatus. The user shall ensure adequate clamping of the cable.
6. The WiFi antenna is tested for low risk of mechanical danger (impact height 0.4m with 1kg mass) and shall be protected against high impact energy levels.

1.4. Warnings and Precautions

Please read these instructions carefully before putting the new terminal into operation.

Although the IND256x is ruggedly constructed, it is nevertheless a precision instrument. Use care in handling and installing the terminal.

	 WARNING
	DO NOT INSTALL OR PERFORM ANY SERVICE ON THIS EQUIPMENT BEFORE THE AREA HAS BEEN SECURED AS NON-HAZARDOUS BY PERSONNEL AUTHORIZED TO DO SO BY THE RESPONSIBLE PERSON AT THE CUSTOMER'S SITE.
	 WARNING
	ONLY THE COMPONENTS SPECIFIED IN THIS MANUAL CAN BE USED IN THIS TERMINAL. ALL EQUIPMENT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE INSTALLATION INSTRUCTIONS DETAILED IN THIS MANUAL. INCORRECT OR SUBSTITUTE COMPONENTS AND/OR DEVIATION FROM THESE INSTRUCTIONS CAN IMPAIR THE INTRINSIC SAFETY OF THE TERMINAL AND COULD RESULT IN BODILY INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.
	 WARNING
	DO NOT OPEN WHEN ENERGIZED.
	 WARNING
	POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD- SEE INSTRUCTIONS.
	 WARNING
	DO NOT OPEN WHEN AN EXPLOSIVE ATMOSPHERE IS PRESENT.
	 WARNING
	THE TERMINAL ASSEMBLED WITH WIFI ANTENNA SHALL BE INSTALLED IN A POSITION IN SUCH A WAY THAT THE RISK FOR MECHANICAL DAMAGE IS LOW. REPLACE THE WIFI ANTENNA IMMEDIATELY IF DAMAGED!

1.5. Inspection and Contents Checklist

On receipt of IND256x, check that the packaging is intact. If the box is damaged, check whether IND256x is damaged and, if necessary, lodge a freight claim with the carrier. If the packaging is not damaged, unpack the IND256x, paying attention to its original packaging, and check that nothing is damaged.

-  To ensure safe transport, it is best to use the original packaging and the correct packaging method.

The packaging box contains:

- IND256x weighing terminal
- Documentation CD (including manual and certificate of inspection)
- Bag of accessories for use during installation

1.6. Configuration

1.6.1. System Configuration

Figure 1-1 shows the configuration options for the terminal.

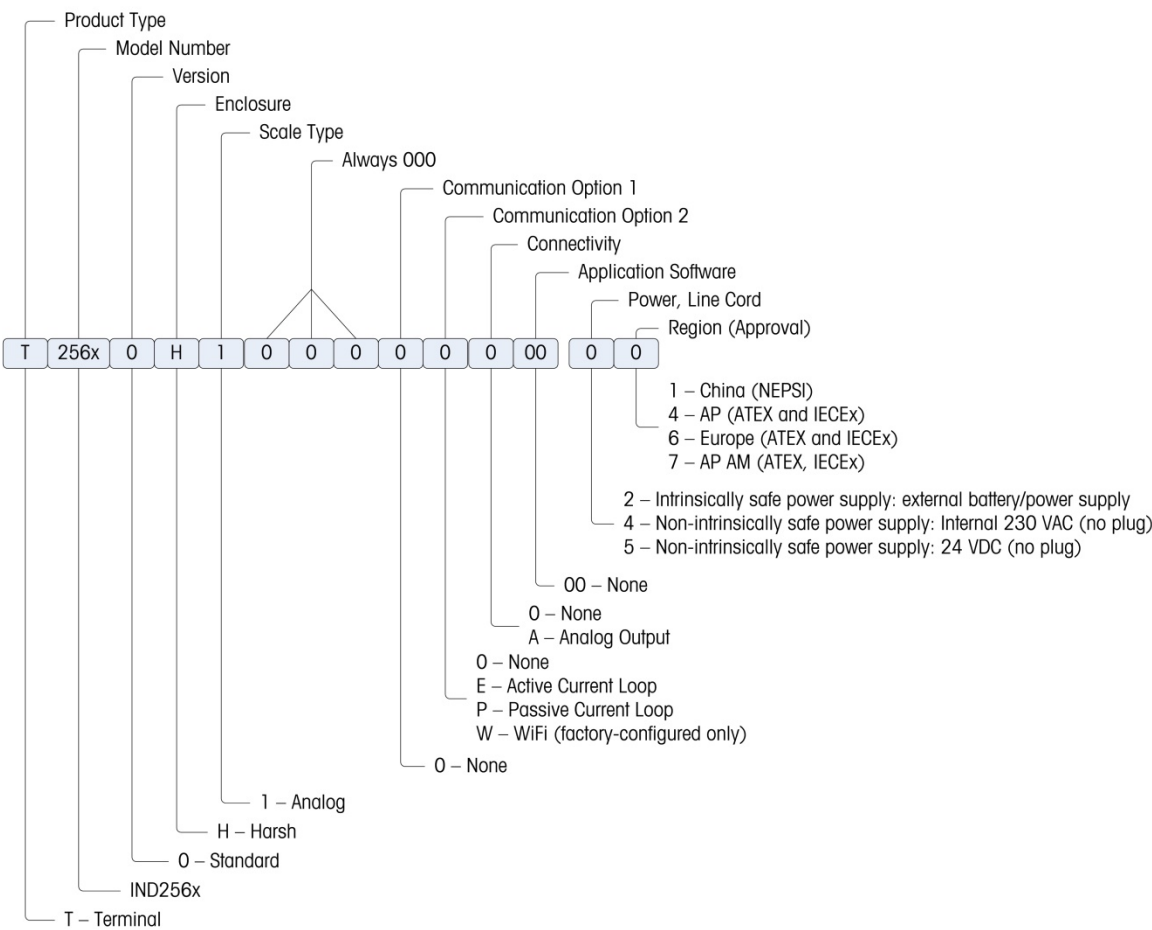


Figure 1-1: IND256x Configuration Chart

WARNING

IND256x TERMINALS FACTORY-CONFIGURED WITH WIFI ARE APPROVED FOR USE IN ZONE 1 EQUIPMENT GROUP IIB CLASSIFIED AREAS. IND256x TERMINALS FACTORY-CONFIGURED WITH WIFI MUST NOT BE USED IN EQUIPMENT GROUP IIC CLASSIFIED AREA. USING THE IND256X TERMINAL FACTORY-CONFIGURED WITH WIFI IN A CLASSIFIED AREA FOR WHICH IT IS NOT APPROVED COULD RESULT IN BODILY HARM AND/OR PROPERTY DAMAGE.

NOTICE

WIFI CAPABILITY IS ONLY AVAILABLE IN IND256x TERMINALS SO CONFIGURED AT THE FACTORY.

1.6.2. Product Date Code

The manufacturing date or the date code for the terminal can be found on the serial data plate (on the top of the enclosure).

The serial number will begin with a letter and a number (for example B212000371). The letter represents the first three digits of the year per the date code chart in Table 1-3 (the letter “B” in our example represents “201x”) and the number is the unit’s digit of the year (the number “2” in our example). So, “B4” decodes to the year 2014.

Table 1-3: Current and Later Date Code Formats

Date Code	Year	Date Code	Year
A	200x	F	205x
B	201x	G	206x
C	202x	H	207x
D	203x	J	208x
E	204x	K	209x

1.6.3. Connections

The following figure shows the connection locations on the back of the harsh enclosure.

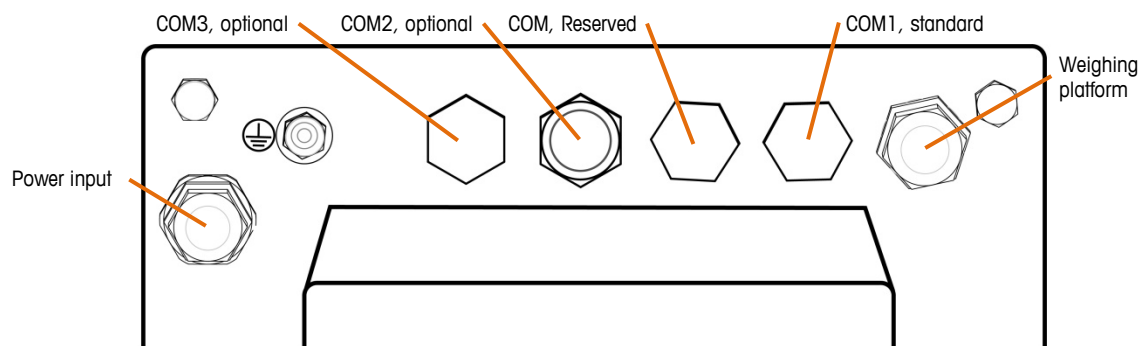


Figure 1-2: IND256x Connection Port Locations

Power input	AC power supply 220V (187-250V 50/60Hz) input (ATEX & IECEx version) <i>or</i> DC power supply 24V(18V-30V) input (ATEX & IECEx version) <i>or</i> external Ex battery
COM1 (standard)	intrinsically safe RS232
COM2 (optional)	intrinsically safe analog 4-20mA output <i>or</i> Wi-Fi communication module (factory-configured only)

COM3 (optional)	intrinsically safe active current loop <i>or</i> intrinsically safe passive current loop
COM Reserved	Not used

1.6.4. Warnings

1.6.4.1. CENELEC

Connection of EB per Country-Specific Regulations: It must be ensured that the housings of all devices are connected to the same potential via the EB terminals. No circulating current may flow via the shielding of the intrinsically safe cables.

1.6.4.2. cFMus

Connection of EB per ANSI/NFPA 70, Article 504, and ANSI/IA RP 12.06.01 or Canadian Electric Code C22.2: It must be ensured that the housings of all devices are connected to the same potential via the EB terminals. No circulating current may flow via the shielding of the intrinsically safe cables.

1.7. Equipotential Bonding (EB)

Equipotential bonding must be installed by an electrician authorized by the owner. METTLER TOLEDO Service performs only a monitoring and consulting function for this procedure.

Connect equipotential bonding of all devices (power supply unit, weighing terminal, interface converter and weighing platform) in accordance with the terminal diagram and all country-specific regulations and standards. In the process, it must ensure that:

- All device housings are connected to the same potential via the EB terminals.
- No circulating current flows via the cable shielding for intrinsically safe circuits.
- The neutral point for equipotential bonding is as close to the weighing system as possible.

1.8. Operating Environment

When selecting a location:

- Choose a stable, vibration-free surface to mount the terminal
- Ensure there are no excessive fluctuations in temperature and there is **no direct exposure to sunlight**
- Avoid drafts on the weighing platform (for example, from open windows or air conditioning)
- Calibrate the terminal after any major change of geographical location

1.8.1.1. Temperature and Humidity

The IND256x can be stored and operated at temperatures and relative humidity conditions as listed in Table 1-1.

1.8.1.2. Environmental Protection

The IND256x terminal has environmental protection as listed in Table 1-1.

1.9. Dimensions

Figure 1-3 and Figure 1-4 show the terminal's dimensions. Units are inches and [mm].

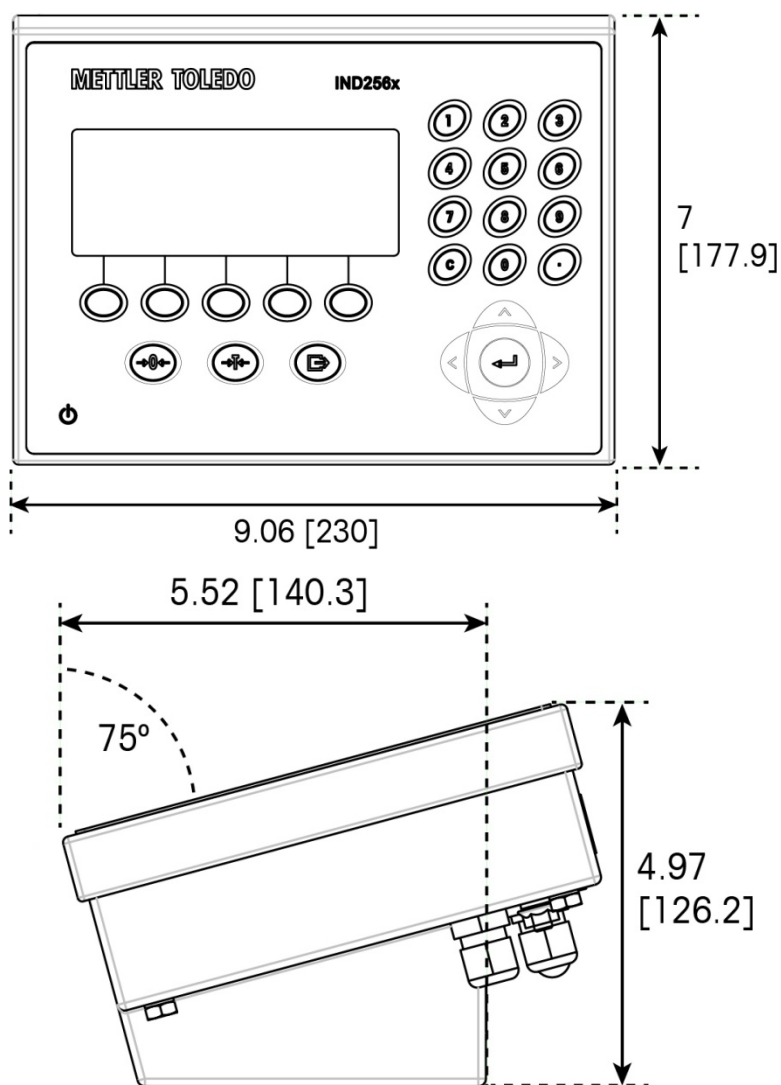


Figure 1-3: IND256x Dimensions, Desktop Installation

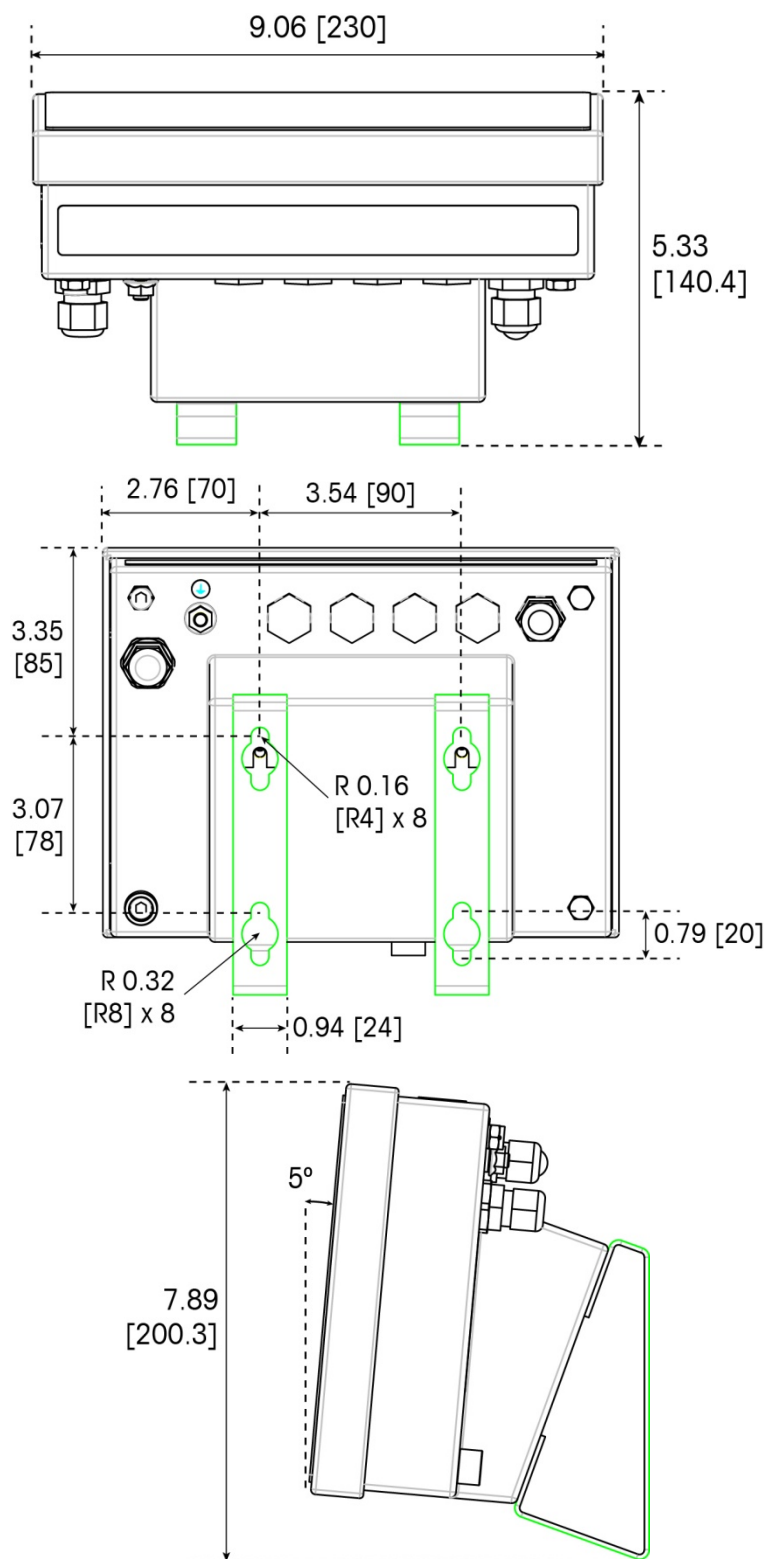


Figure 1-4: IND256x Dimensions, with Fixed Wall-Mount Bracket

1.10. Main Board

The IND256x main board has the following main connections, indicated in Figure 1-5:

1. Analog load cell weighing interface
2. Intrinsically safe power input interface, connecting the power module
3. Flat ribbon harness interface, used to connect the display
4. Intrinsically safe RS232 interface (COM1)
5. Two communication option board interfaces (COM2 and COM3)

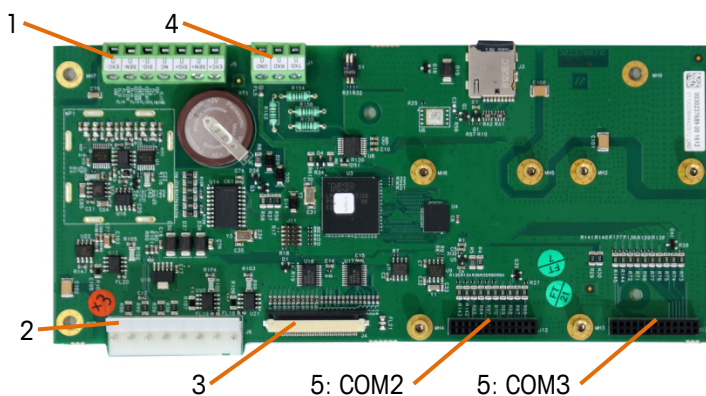


Figure 1-5: IND256x Main Board

1.11. Communication Option Boards

The IND256x can be configured with a maximum of two of the three communication option boards installed inside its enclosure. The options are:

- WiFi communication module (available only in IND256x terminals factory-configured with WiFi)
- Intrinsically safe 3-20 mA analog output
- Active current loop for connection to communication module ACM200 located in the safe area, or to connect second IND256x terminal configured with passive current loop option
- Passive current loop (used as the second display to connect another IND256x with active current loop)

2 Installation

2.1. Opening the Enclosure

	 WARNING
	DO NOT INSTALL OR PERFORM ANY SERVICE ON THIS EQUIPMENT BEFORE THE AREA HAS BEEN SECURED AS NON-HAZARDOUS BY PERSONNEL AUTHORIZED TO DO SO BY THE RESPONSIBLE PERSON AT THE CUSTOMER'S SITE.
	 CAUTION
	CONFIRM COMPLIANCE WITH APPLICABLE NATIONAL AND LOCAL WIFI REGULATIONS BEFORE INSTALLING AND COMMISSIONING IND256x TERMINAL CONFIGURED WITH WIFI MODULE. METTLER TOLEDO ACCEPTS NO RESPONSIBILITY FOR TERMINAL INSTALLATION IN COUNTRIES WHERE WIFI REGULATIONS ARE NOT FULFILLED.
	 WARNING
	TO PREVENT IGNITION OF HAZARDOUS GAS, BE SURE TO CUT OFF THE POWER BEFORE OPENING IND256X ENCLOSURE. AFTER IND256X IS POWERED ON, KEEP THE ENCLOSURE STRICTLY SEALED. DO NOT OPEN THE CASE IN THE PRESENCE OF EXPLOSIVE DUST OR GAS.

Open IND256x terminal according to the steps in the following sections.

The front cover of the IND256x terminal is attached by 4 screws. For hardware configuration inside the instrument, open it as shown below:

1. Place the terminal face-down on a flat surface, taking care not to damage the fascia.
2. Unscrew the four captive screws indicated in Figure 2-1.



Figure 2-1: Enclosure screws

- Lift the rear cover and flip it to expose its interior. Note the two straps that secure the front panel to the enclosure.

2.2. Install Cables and Connectors

The cables and connectors of IND256x terminal are as follows:

- Harsh Enclosure Cable Glands
- Mainboard Wiring Connections
- Power Connection

	 WARNING ONLY PROFESSIONAL SERVICE PERSONNEL MAY OPERATE THIS INSTRUMENT. BE CAREFUL DURING INSPECTION, TEST AND ADJUSTMENT. INCORRECT OPERATION MAY RESULT IN INJURY.
---	---

The IND256x terminal is suitable for severe wash-down and dust environments. However, it is necessary to access the interior of the terminal enclosure when installing cables and/or connectors. Each cable entering the enclosure is allocated a specific position.

2.2.1. Harsh Enclosure Cable Glands

To ensure water resistance and dust sealing:

1. Pass the appropriately sized cable through the correct gland before connecting the wires. Depending upon the gland size, cables of a specific diameter must be used. The required cable sizes are shown in Table 2-1.

Table 2-1: Cable Diameters for Glands

Gland	Cable diameter
Analog load cell	6–10 mm (0.24–0.39 in.)
COM1 (IS-RS232)	6–10 mm (0.24–0.39 in.)
Current loop (active & passive)	6–10 mm (0.24–0.39 in.)
AC/DC Power cable	6–10 mm (0.24–0.39 in.)
4-20 mA analog output	6–10 mm (0.24–0.39 in.)
External battery	4-8 mm (0.16–0.3 in)

Important Notes:

- Use only ATEX-certified glands and blanks with the IND256x terminal.
- The cable glands must be protected against damage from impact.
- Sufficient strain-relief must be ensured to prevent tensile forces on the cable glands.

2. When making cable terminations inside the harsh enclosure, ensure that the cable length from the terminal strip/connector to the terminal housing is sufficient so that no strain is placed on the connector assembly when the housing is in the fully open position.
3. Cables that include shields should have the shield terminated at the gland as shown in Figure 2-2. Spread the shield wires out and make sure enough shield wire is present to make good contact with the metal part of the gland.

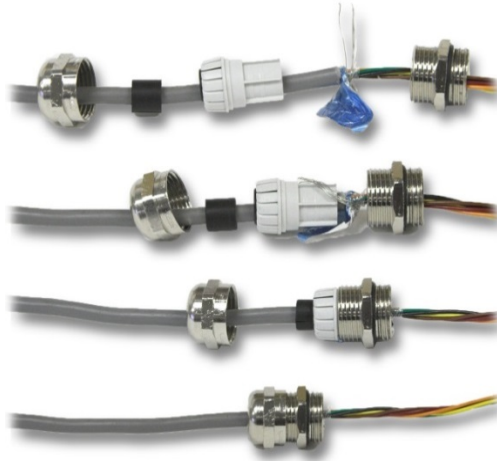


Figure 2-2: Shield Termination at Gland

2.2.2. Power Connection

	 WARNING
	THE MAINS CONNECTION OF THE POWER SUPPLY UNIT MUST BE MADE BY A PROFESSIONAL ELECTRICIAN AUTHORIZED BY THE OWNER AND IN ACCORDANCE WITH THE RESPECTIVE TERMINAL DIAGRAM, THE ACCOMPANYING INSTALLATION INSTRUCTIONS AS WELL AS THE COUNTRY-SPECIFIC REGULATIONS.

Where IECEx & ATEX are accepted, the IND256x can be powered by either:

- An internal power supply connected to an external AC230V or DC 24V power input, or
- An external NiMH battery (P/N 64060625).

The IND256x can use any of three encapsulated power boards, each supporting a different power input. Power is connected via an increased safety connector at the right corner inside the enclosure (Figure 2-3). The connector is protected by a plastic cover.

For the internal AC or DC power input version, the terminal is supplied with a 5 meter power cable, without plug. Terminals with an intrinsically safe power supply are supplied without a power cable.

2.2.2.1. Internal AC Power Input (IECEX & ATEX Approved Terminals Only)

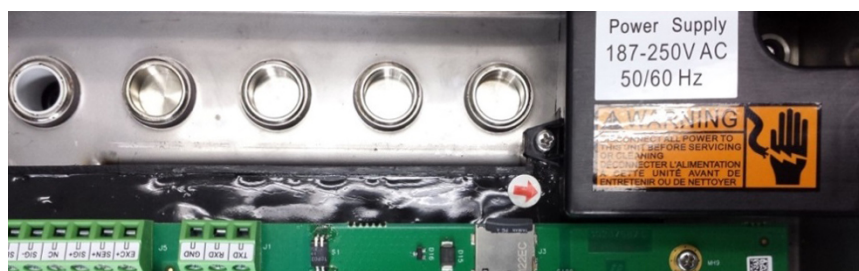


Figure 2-3: AC Power Input Connector with Cover



Figure 2-4: AC Power Input Connector, Cover Removed

Table 2-2: AC Power Input Cable Color Code

Pin	Pin color
L	Brown
N	Blue

2.2.2.2. Internal DC power input (IECEX & ATEX Approved Terminals Only)

		WARNING
		THE DC POWER SUPPLY MUST BE CONNECTED TO AN 18-30V DC INPUT. DO NOT CONNECT TO AC POWER
		WARNING
		FOR IND256X DC VERSION TERMINALS, THERE IS NO GALVANIC SEPARATION BETWEEN THE NON-INTRINSICALLY SAFE SUPPLY CIRCUIT AND THE INTRINSICALLY SAFE OUTPUT CIRCUITS. THE NON-INTRINSICALLY SAFE CIRCUIT MUST BE SAFELY CONNECTED TO EARTH. AND POTENTIAL EQUALIZATION MUST EXIST ALONG INTRINSICALLY SAFE CIRCUITS. ALTERNATIVELY, THE NON-INTRINSICALLY SAFE SUPPLY CIRCUIT SELV) MUST BE SAFELY SEPARATED FROM EARTH.
		WARNING
		THE EXTERNAL CUSTOMER-PROVIDED DC POWER SUPPLY MUST HAVE A MAXIMUM OVER-VOLTAGE CATEGORY II ACCORDING TO IEC 60664-1.



Figure 2-5: DC Power input Connector with Cover

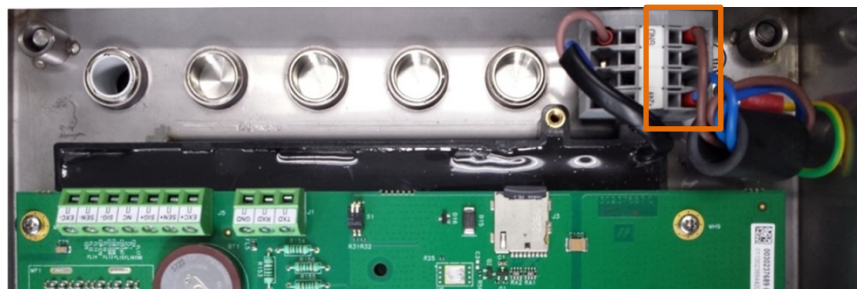


Figure 2-6: DC Power input Connector without Cover

Table 2-3: DC Power Input Cable Color Code

Pin	Pin color
GND	Brown
+24V	Blue

A.2.2.3

External NiMH Battery or Power Supply Input

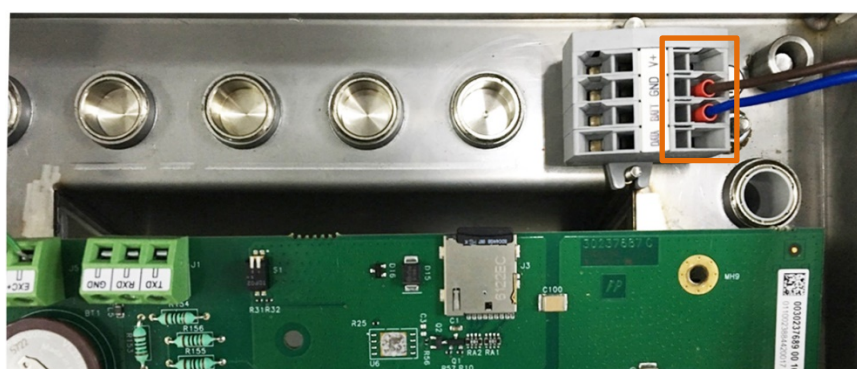


Figure 2-7: NiMH battery input connector internal view

Table 2-4: NiMH Battery Input Cable Color Code

Pin	Pin color
DATA	Empty
BATT	Blue
GND	Brown

Pin	Pin color
V+	Empty

2.3. Bonding and Grounding

All grounding and equal potential bonding connections must be made according to local regulations applicable in the country of installation. Refer to local codes and the control drawings for more specific information regarding grounding.

It is typical that local regulations will require that all connected pieces of equipment in the system be bonded together and grounded to a single point. A special external ground screw designed for equal potential bonding is provided on the IND256x terminal (Figure 2-8).



Figure 2-8: IND256x Terminal Grounding Screw

2.4. Equipotential Bonding (EB)

Equipotential bonding must be installed by an electrician authorized by the owner. METTLER TOLEDO Service performs only a monitoring and consulting function for this procedure.

Connect equipotential bonding of all devices (power supply unit, weighing terminal, interface converter and weighing platform) in accordance with the terminal diagram and all country-specific regulations and standards. In the process, it must ensure that:

- All device housings are connected to the same potential via the EB terminals.
- No circulating current flows via the cable shielding for intrinsically safe circuits.
- The neutral point for equipotential bonding is as close to the weighing system as possible.

2.4.1. Warnings

2.4.1.1. CENELEC

2.4.1.1.1. Connection of EB per Country-Specific Regulations

It must be ensured that the housings of all devices are connected to the same potential via the EB terminals. No circulating current may flow via the shielding of the intrinsically safe cables.

2.4.1.2.

cFMus

2.4.1.2.1.

Connection of EB per ANSI/NFPA 70, Article 504, and ANSI/IA RP 12.06.01 or Canadian Electric Code C22.2

It must be ensured that the housings of all devices are connected to the same potential via the EB terminals. No circulating current may flow via the shielding of the intrinsically safe cables.

2.5. Closing the Enclosure

To ensure that the front cover is correctly installed:

- Place the front cover on a flat surface
- Ensure that the seal ring is accurately located
- Install the rear cover and ensure it is accurately positioned
- Install the screws in their original positions
- Tighten each screw to 3.0 Nm

2.6. Analog Load Cell Connection

Analog cells are connected to the mainboard at the connector show in Chapter 1, Introduction.

The IND256x terminal is designed to power up to four 350-ohm load cells (or a minimum resistance of approximately 87 ohms). To confirm that the load cell load for the installation is within limits, the total scale resistance (TSR) must be calculated.

To calculate TSR:

$$\text{TSR} = \frac{\text{Load Cell Input Resistance } (\Omega\text{ms})}{\text{Number of cells}}$$


Ensure that the TSR of the load cell network to be connected to the IND256x has a resistance greater than 87 ohms before connecting the load cells. If the resistance is less than 87 ohms, the IND256x will not operate properly.

In addition, the maximum cable distance must be reviewed. Table 2-5 provides recommended maximum cable lengths based on cable gauge and correct operation of the terminal. Note that the entity values for the load cell cable must be considered as a safety factor in the installation.

Table 2-5: Maximum Recommended Cable Lengths

TSR (Ohms)	24 Gauge (meters/feet)	20 Gauge (meters/feet)	16 Gauge (meters/feet)
One to four-350 Ω cells	60/200	182/600	304/1000

Figure 2-9 shows the wiring for analog load cells. When a four-conductor cell is used, +Exc must be jumpered to +Sen and -Exc jumpered to -Sen.

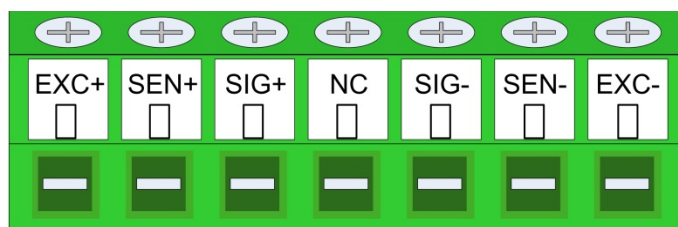**NOTES**


1. WIRE SIZE: 18 AWG (0.823 mm²) MAX., 24 AWG (0.205 mm²) MIN.
2. CHASSIS GROUND: METAL GLAND

Figure 2-9: Load Cell Termination

2.7. Communication Boards Connection

2.7.1. Serial Port (COM1)


The COM1 port includes connections for an intrinsically safe serial device. Figure 2-10 indicates the COM1 port connector. The cable length of this connection is limited to 10m (33 ft.).



IND256x	Signal
J1 - 1	TxD—send data
J1 - 2	RxD—receive data
J1 - 3	GND—logic ground

Figure 2-10: COM1 Port Signals

An example of connecting to an RS-232 device in the safe area through a Zener diode barrier is shown in Figure 2-11. Refer to the entity approval values of COM1 when selecting a barrier. Note that seals and other protective devices will also be required to meet hazardous area wiring codes.

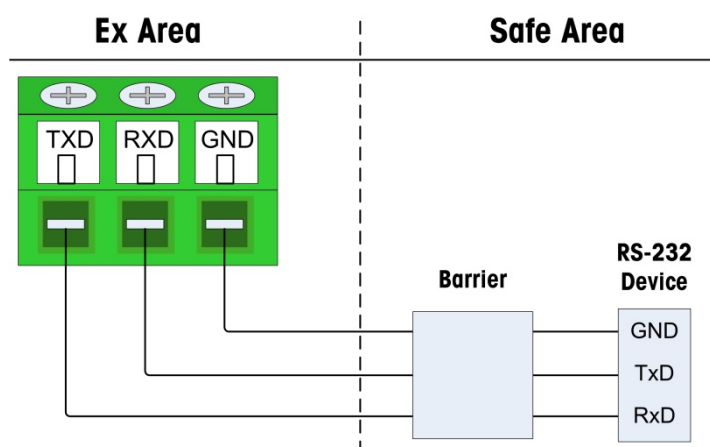**Figure 2-11: Sample RS-232 Connection**

A barrier that has been tested for correct operation with the IND256x, and can be connected directly to COM1, is:

- MTL7761Pac (IECEx and ATEX approvals)

2.7.2. Active Current Loop


The active current loop option board can only be installed in the COM3 socket of the mainboard. When IND256x is connected to ACM200, it is necessary to connect the ACM200 using the active current loop to achieve communication in the safety area.

Table 2-6: Active Current Loop Connections to ACM200

IND256x COM3 (J2)	ACM200 COM (J3)
1	4
2	3
3	2
4	1

Customer-specific cables for intrinsically safe circuits must be customized as follows:

	IND256x – ACM200
Cable	2 x 2 x 0.5 mm ²
Dimension A (IND256x)	110 mm (2.4")
Dimension B (ACM200)	70 mm (2.8")
Max. length	300 m (1000 ft)

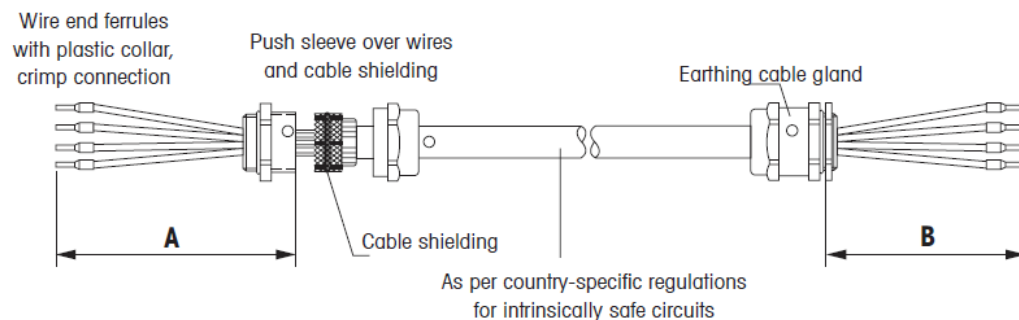

4. Cut the cable to length and strip the cable ends according to dimension A/B.
5. Shorten cable shielding on both sides to 10 mm (0.4").
6. Strip wire ends.
7. Crimp wire end ferrules onto wire ends with a crimping tool.
8. Push second rear section of the earthing cable gland onto the cable.
9. Apply the cable shielding only to the IND256x end by pushing the sleeve over the wires and the cable shielding and folding it over the cable shielding.
10. Push on front section of cable gland and screw it onto the rear section.

2.7.3. Passive Current Loop

If IND256x terminal is connected to another IND256x weighing system as remote display, the passive current loop interface must be connected to the active current loop of another IND256x terminal. The passive current loop can only be installed in the COM3 socket of the mainboard.

Table 2-7: Passive Current Loop Connection Between Terminals

IND256x COM3 (passive current loop J4) (Remote display)		IND256x COM3 (active current loop J2) (Instrument connecting the weighing platform)
1	←→	1
2	←→	2
3	←→	3
4	←→	4

2.7.4. Intrinsically Safe Analog 4-20 mA Output

The optional intrinsically safe analog 4-20 mA communication board connects to the COM2 port on the IND256x mainboard. It provides an intrinsically safe analog signal of 4-20 mA, proportional to the weight applied to the scale or to the rate of change of weight on the scale. The maximum cable length for the Analog Output connection is 300 m / 980 ft. The cable used for the analog output signal must be shielded.

■ This option cannot be used together with WiFi option.



Figure 2-12: Intrinsically Safe Analog Output Option Board

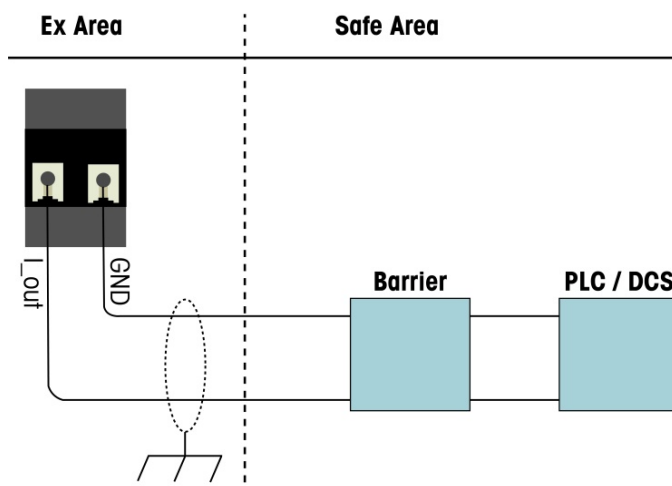


Figure 2-13: Analog Output Wiring

The KFD2-STC4-EX1 analog isolated barrier produced by P&F (certificate numbers: IECEx BAS 04.0016X; BAS 99 ATEX 7060X) has been verified and can be connected directly with the IND256x intrinsically safe analog 4-20 mA option, and then connected to a PLC or DCS system in the safe area.

2.7.5. Wireless Communication

IND256x wireless communication option board is installed on the mainboard with other option boards, and is not connected with peripherals. The option should be configured as described in Chapter 3, section 3.8.4. A strong WiFi signal is required to achieve wireless communication with peripherals.

The IND256x supports a single WiFi option.

- This option cannot be used together with the intrinsically safe analog 4-20 mA output option.



Figure 2-14: IND256x WiFi Option Board and Antenna

2.8. Sealing the Enclosure

When the IND256x terminal is used in a metrologically “approved” application, it must be protected from tampering by use of seals. IND256x versions include the optional sealing kit.

The method used for sealing will vary depending upon local requirements. The IND256x supports external sealing.

2.8.1. External Sealing of the Enclosure, US

IND256x lead seal details are shown in Figure 2-15. The procedure is as follows:

11. Determine that the correct area has been selected under **Scale > Type > Approval** and set the metrology switch SW1-1 to ON (refer to Chapter 2, **Operation**, for the location and function of this switch).
12. Pass the seal wire through two adjacent sealing bolts and then fix the seal retainer as shown in Figure 2-15.
13. Cut off the excessive lead seal wire.

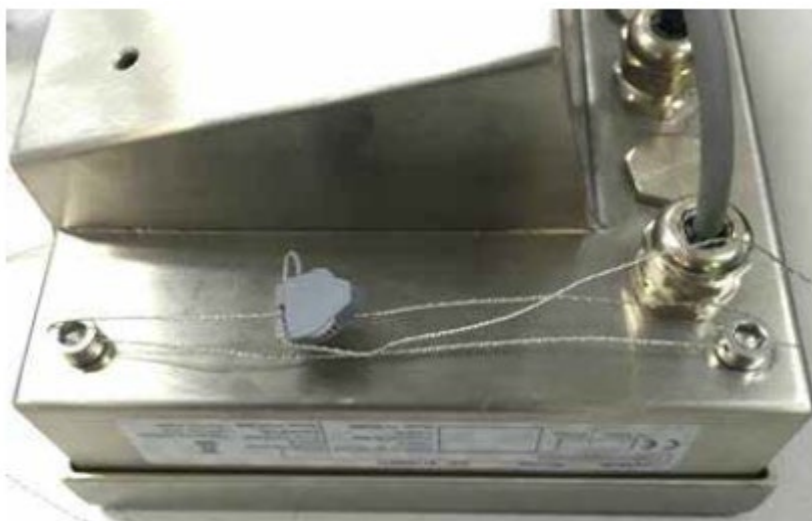


Figure 2-15: Sealing Method

2.9. Interface Parameters

2.9.1. Supply Circuit (Power Supply Port)

Supply circuit	Parameters	
Variant with non-intrinsically safe AC-supply (Type key ends with “46” or “44”) (only ATEX & IECEx approved) Permanently connected cable with ferrule	Rated voltage:	AC 187...250 V (50/60 Hz)
	Rated current:	125 mA
	Maximum input voltage:	Um AC 250 V

Supply circuit	Parameters
Variant with non-intrinsically safe DC-supply (Type key ends with "56" or "54") (only ATEX & IECEx approved) Permanently connected cable with ferrule: Blue: +24V, Brown: gnd, Green-yellow: PE	Rated voltage: DC 18...30 V Rated current: 250 mA Maximum input voltage on associated apparatus: Um AC 250 V (Note: the rated voltage is lower)
Variants with intrinsically safe (battery) DC-supply (Type key ends with "25" or "27") Connection terminals: V+, GND, BATT, DATA	Nominal input voltage: DC 10 V Nominal input current: 350 mA
	Maximum input voltage: Ui DC 12.8 V Maximum input current: Ii 3.03 A Maximum input power: Pi 6.83 W
	Effective internal inductance: Li negligible
	Effective internal capacitance: Ci negligible

2.9.2. Intrinsically Safe RS232 Interface

Intrinsically safe RS232-interface	Parameters
Terminals J1.1 (TXD), J1.2(RXD) – J1.3 (GND)	Maximum input voltage: Ui DC ± 10 V Effective internal capacitance: Ci negligible Effective internal inductance: Li negligible
	Maximum output voltage: Uo DC J1.1-GND resp. J1.2-GND each: ± 5.36 V
	Maximum output current: Io J1.1-GND resp. J1.2-GND each: ± 12.9 mA
	Maximum output power: Po J1.1-GND resp. J1.2-GND each: 17.2 mW
	Maximum external capacitance: Co 100 nF Maximum external inductance: Lo 100 μ H

2.9.3. Intrinsically Safe Output for Connection to a Load Cell

Intrinsically safe output for connection to a load cell	Parameters
Terminals J5.1 (EXC+), J5.2 (SEN+), J5.3 (SIG+), J5.5 (SIG-), J5.6 (SEN-), J5.7 (EXC-)	Maximum output voltage: Uo DC 5.88 V Maximum output current: Io 171 mA Maximum output power: Po 940 mW
	Maximum external capacitance: Co 6.8 μ F Maximum external inductance: Lo 0.3 mH

2.9.4. Optional Communication Board Interfaces

Interfaces of the optional communication boards	Parameters
Intrinsically safe 4-20mA-interface Only for variants with analog output option board (Type key "A") Terminals J2.1 (I_OUT) – J2.2 (GND)	Maximum input voltage: U_i DC 3.5 V Maximum input current: I_i 115 mA Maximum internal capacitance: C_i 110 nF Maximum internal inductance: $L_o=0$
	Maximum output voltage: U_o DC 13.65 V Maximum output current: I_o 115 mA Maximum output power: P_o 0.4 W Maximum external capacitance: C_o 680 nF Maximum external inductance: L_o 400 μ H
WiFi-antenna-connection Only for variants with Wifi option board (Type key "W") IPEX-connector for connection to the external antenna type AC-Q24-50ZD	Maximum RF-power: < 1.3 W Frequency: 2400...2483 MHz
Intrinsically safe active current loop-interface Only for variants with active current loop option board (type key "E") Terminal block J2, terminals J2.1...J2.4 (Active CL)	Maximum output voltage: U_o DC 5.36 V Maximum output current: I_o 131 mA Maximum output power: P_o 176 mW
	Maximum external capacitance: C_o 600 nF Maximum external inductance: L_o 400 μ H
Intrinsically safe passive current loop-interface Only for variants with passive current loop option board (type key "P") Terminal block J4, terminals J4.1...J4.4 (Passive CL)	Maximum input voltage: U_i DC 10 V Maximum input current: I_i 300 mA Maximum input power: P_i 500 mW
	Effective internal capacitance: C_i 110 nF Effective internal inductance: L_i negligible

2.9.5. Ambient Temperature Range

Parameters
Ambient temperature range: T_a -10 °C...+40 °C

IND256x

Terminal de pesaje



METTLER TOLEDO

Terminal de pesaje IND256x

METTLER TOLEDO Service

Servicios esenciales para el desempeño confiable

Enhorabuena por elegir la calidad y precisión de METTLER TOLEDO. El uso adecuado de su nuevo equipo siguiendo este manual, y la calibración y mantenimiento regulares por parte del equipo de servicio formado en fábrica garantizan un funcionamiento fiable y preciso, protegiendo su inversión. Póngase en contacto con nosotros acerca del acuerdo de servicio ajustado a sus necesidades y presupuesto. Hay más información disponible en www.mt.com/service.

Existen varias maneras importantes de garantizar que usted maximizará el rendimiento de su inversión:

1. **Registre su producto:** Le invitamos a registrar su producto en www.mt.com/productregistration para que podamos ponernos en contacto con usted si hubiera mejoras, actualizaciones y notificaciones importantes relacionadas con su producto.
2. **Póngase en contacto con METTLER TOLEDO para obtener servicio:** El valor de una medida es proporcional a su precisión: una báscula fuera de las especificaciones puede disminuir la calidad, reducir las ganancias y aumentar la responsabilidad. El servicio oportuno por parte de METTLER TOLEDO garantizará precisión y optimizará el tiempo de funcionamiento y la vida útil del equipo.
 - a. **Instalación, configuración, integración y formación:** Nuestros representantes de servicio reciben una capacitación en fábrica y son expertos en equipos de pesaje. Nos aseguramos de que el equipo de pesaje esté listo para la producción de manera rentable y oportuna y de que el personal esté formado para obtener resultados exitosos.
 - b. **Documentación de calibración inicial:** Los requisitos de aplicación y del entorno de instalación son únicos para cada báscula industrial. Su rendimiento se debe comprobar y certificar. Nuestros servicios y certificados de calibración documentan la precisión para garantizar la calidad en la producción y para proporcionar un registro de rendimiento del sistema de calidad.
 - c. **Mantenimiento periódico de calibración:** El acuerdo de servicio de calibración proporciona confianza en el proceso de pesaje y documentación de cumplimiento de los requisitos. Ofrecemos diversos planes de servicio que se programan para satisfacer sus necesidades y están diseñados para ajustarse a su presupuesto.
 - d. **Verificación de GWP®:** Un enfoque basado en el riesgo para manejar equipos de pesaje permite el control y mejora del proceso de medición completo, lo que asegura la calidad reproducible del producto y minimiza los costos del proceso. GWP (Good Weighing Practice [Buenas prácticas de pesaje]), el estándar basado en la ciencia para el manejo eficiente del ciclo de vida del equipo de pesaje, ofrece respuestas claras acerca de cómo especificar, calibrar y asegurar la precisión del equipo de pesaje, independientemente del modelo o la marca.

© METTLER TOLEDO 2019

Ninguna parte de este manual puede ser reproducida o transmitida en ninguna forma y por ningún medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado y grabación, para ningún propósito sin permiso por escrito de METTLER TOLEDO.

Derechos restringidos del Gobierno de los Estados Unidos: Esta documentación se proporciona con Derechos Restringidos.

Derechos de autor 2019 METTLER TOLEDO. Esta documentación contiene información patentada de METTLER TOLEDO. Esta información no puede copiarse total o parcialmente sin el consentimiento expreso por escrito de METTLER TOLEDO.

METTLER TOLEDO se reserva el derecho de refinar o cambiar el producto o el manual sin previo aviso.

DERECHOS DE AUTOR

METTLER TOLEDO® es una marca registrada de Mettler-Toledo, LLC. Todas las demás marcas o nombres de productos son marcas comerciales o registradas de sus respectivas compañías.

METTLER TOLEDO SE RESERVA EL DERECHO DE HACER REFINACIONES O CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Aviso de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Pautas de la FCC y los Requerimientos de Radio-Interferencia del Departamento Canadiense de Telecomunicaciones. La operación está sujeta a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda causar una operación indeseada.

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital clase A, consecuente con la Parte 15 de las Pautas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina cuando el equipo es operado en un ambiente comercial. Este equipo genera, usa y puede irradiar frecuencias de radio y, si no es instalado y utilizado de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencia dañina a las radiocomunicaciones. Es probable que la operación de este equipo en un área residencial cause interferencia dañina, en cuyo caso se le exigirá al usuario que corrija la interferencia con gastos a su cargo.

- La declaración de conformidad del producto está disponible en <http://glo.mt.com/global/en/home/search/compliance.html/compliance/>.





Enunciado referente a sustancias nocivas

Nosotros no usamos directamente sustancias nocivas como asbestos, sustancias radioactivas o compuestos de arsénico. Sin embargo, compramos componentes de terceros que pueden contener algunas de estas sustancias en cantidades muy pequeñas.

Precauciones

- LEA este manual ANTES de operar o dar servicio a este equipo y SIGA estas instrucciones detalladamente.
- GUARDE este manual para futura referencia.

	 ADVERTENCIA NO INSTALE, NI REALICE TAREAS DE MANTENIMIENTO EN EL EQUIPO, ANTES DE QUE EL PERSONAL AUTORIZADO POR LA PERSONA RESPONSABLE EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE HAYA DETERMINADO QUE EL ÁREA EN LA QUE SE ENCUENTRA EL TERMINAL IND245x NO ES PELIGROSA.
	 PRECAUCIÓN CONFIRME LA CONFORMIDAD CON LAS REGULACIONES LOCALES Y NACIONALES APLICABLES EN CUANTO A LA CONEXIÓN WIFI ANTES DE INSTALAR Y PONER EN MARCHA EL TERMINAL IND256x CONFIGURADO CON UN MÓDULO WIFI. METTLER TOLEDO NO SE HARÁ RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN DE TERMINALES EN PAÍSES EN LOS QUE NO SE CUMPLAN LAS REGULACIONES RELATIVAS A LA CONEXIÓN WIFI.
	 ADVERTENCIA SI EL TECLADO, EL CRISTAL DE LA PANTALLA O LA CAJA DEL IND245x SE DAÑAN, EL COMPONENTE DEFECTUOSO DEBE SUSTITUIRSE INMEDIATAMENTE. DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA INMEDIATAMENTE Y NO VUELVA A CONECTARLA HASTA QUE EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO CUALIFICADO HAYA REEMPLAZADO EL CRISTAL DE LA PANTALLA, EL TECLADO O LA CAJA. DE NO HACERLO, PODRÍAN PROVOCARSE DAÑOS PERSONALES O MATERIALES.
	 ADVERTENCIA EVITE LA CARGA ELECTROSTÁTICA DURANTE EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO.
	 ADVERTENCIA EL FUNCIONAMIENTO SE PERMITE SOLAMENTE CUANDO LAS CARGAS ELECTROSTÁTICAS RELACIONADAS CON EL PROCESO Y EL PROCESO SON ELIMINADAS.
	 ADVERTENCIA UTILICE EL TERMINAL DE PESAJE ÚNICAMENTE CUANDO NO SEAN POSIBLES LOS PROCESOS ELECTROESTÁTICOS QUE PROVOQUEN DESCARGAS DE PROPAGACIÓN.
	 ADVERTENCIA MANTENGA EL TERMINAL ALEJADO DE PROCESOS QUE GENEREN UN ELEVADO POTENCIAL DE CARGA, COMO UN REVESTIMIENTO ELECTROESTÁTICO, LA TRANSFERENCIA RÁPIDA DE MATERIALES NO CONDUCTORES, CHORROS DE AIRE RÁPIDOS Y AEROSOLAS DE ALTA PRESIÓN.
	 ADVERTENCIA NO UTILICE UN PAÑO SECO PARA LIMPIAR EL TERMINAL DE PESAJE. UTILICE SIEMPRE UN PAÑO HÚMEDO PARA LIMPIAR EL TERMINAL SUAVEMENTE.
	 ADVERTENCIA VISTA UN ATUENDO ADECUADO. EVITE EL NAILON, EL POLIÉSTER U OTROS MATERIALES SINTÉTICOS QUE GENEREN Y MANTENGAN CARGA. UTILICE UN PAVIMENTO Y UN CALZADO CONDUCTOR.

	 ADVERTENCIA
	EVITE COLOCAR FUNDAS DE PLÁSTICO SOBRE EL TERMINAL.
	 ADVERTENCIA
	ASEGÚRESE DE QUE LA BASE DE LA BÁSCULA, LOS ACCESORIOS DE MONTAJE Y EL TERMINAL CUENTA CON UNA TOMA DE TIERRA EQUIPOTENCIAL ADECUADA.
	 ADVERTENCIA
	SE DEBE PROTEGER EL TERMINAL DE LA LUZ ULTRAVIOLETA.
	 ADVERTENCIA
	PARA LA VERSIÓN DE CC DEL TERMINAL IND256x, NO HAY SEPARACIÓN GALVÁNICA ENTRE EL CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN DE SEGURIDAD NO INTRÍNSECA Y LOS CIRCUITOS DE SALIDA DE SEGURIDAD INTRÍNSECA. EL CIRCUITO DE SEGURIDAD NO INTRÍNSECA DEBE ESTAR CONECTADO CON SEGURIDAD A TIERRA. ADEMÁS, LA ECUALIZACIÓN POTENCIAL DEBE EXISTIR A LO LARGO DE LOS CIRCUITOS DE SEGURIDAD INTRÍNSECA. COMO ALTERNATIVA, EL CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN DE SEGURIDAD NO INTRÍNSECA (SELV) DEBE ESTAR SEPARADO DE TIERRA DE FORMA SEGURA.
	 ADVERTENCIA
	LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA DE CC PROPORCIONADA POR EL CLIENTE DEBE TENER UNA SOBRETENSIÓN MÁXIMA DE CATEGORÍA II, DE ACUERDO CON LA IEC 60664-1.
	 ADVERTENCIA
	DEBE GARANTIZARSE UNA LIBERACIÓN DE TENSIÓN SUFICIENTE PARA EVITAR FUERZAS DE TENSIÓN EN LOS PRENSAESTOPAS.
	 ADVERTENCIA
	LOS PRENSAESTOPAS DEBEN ESTAR PROTEGIDOS CONTRA DAÑOS POR IMPACTO.
	 ADVERTENCIA
	EL TERMINAL ENSAMBLADO CON UNA ANTENA WIFI DEBERÁ INSTALARSE DE TAL FORMA QUE EL RIESGO DE DAÑO MECÁNICO SEA BAJO. REEMPLACE LA ANTENA WIFI INMEDIATAMENTE SI SE DAÑA.
	 ADVERTENCIA
	LOS TERMINALES IND256X CONFIGURADOS EN FÁBRICA CON WIFI ESTÁN APROBADOS PARA SU USO EN ÁREAS CLASIFICADAS PARA EL GRUPO DE EQUIPOS IIB DE ZONA 1. LOS TERMINALES IND256X CONFIGURADOS EN FÁBRICA CON WIFI NO SE DEBEN USAR EN ÁREAS CLASIFICADAS PARA EL GRUPO DE EQUIPOS IIC. USAR EL TERMINAL IND256X CONFIGURADO EN FÁBRICA CON WIFI EN UN ÁREA CLASIFICADA PARA LA CUAL NO ESTÁ APROBADO PODRÍA PROVOCAR LESIONES CORPORALES O DAÑOS EN LA PROPIEDAD.

	 ADVERTENCIA LA ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA CD EXTERNA PROPORCIONADA POR EL CLIENTE DEBE TENER UNA CATEGORÍA II DE SOBREVOLTAJE MÁXIMO DE ACUERDO CON IEC 60664-1.
	 ADVERTENCIA NO ABRA EL TERMINAL CUANDO LA ATMÓSFERA SEA EXPLOSIVA DEBIDO AL POLVO. PARA PREVENIR LA IGNICIÓN DE ATMÓSFERAS PELIGROSAS, DESCONECTE EL IND256x DE SU FUENTE DE ENERGÍA ANTES DE ABRIR LA CAJA. MANTENGA LA TAPA BIEN CERRADA MIENTRAS EL CIRCUITO ESTÉ CONECTADO. NO ABRIR CUANDO SE ENCUENTRE EN UNA ATMÓSFERA CON POLVO EXPLOSIVO.
	 ADVERTENCIA SE DEBE INSTALAR TODO EL EQUIPO DE ACUERDO CON EL NÚMERO DE IMAGEN DEL DOCUMENTO DEL FABRICANTE 30282892B Y LOS CÓDIGOS LOCALES APLICABLES.
	 ADVERTENCIA EN ESTE DISPOSITIVO, SOLO SE PUEDEN USAR LOS COMPONENTES ESPECIFICADOS EN EL MANUAL DE INSTALACIÓN INCLUIDO EN EL CD-ROM DE DOCUMENTACIÓN 30512916. TODO EL EQUIPO DEBE INSTALARSE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE. LA SUSTITUCIÓN DE LOS COMPONENTES, EL USO DE UNOS NO ADECUADOS O EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE AFECTAR A LA SEGURIDAD INTRÍNSECA DEL TERMINAL Y PODRÍAN PROVOCAR LESIONES PERSONALES O DAÑOS MATERIALES.
	 ADVERTENCIA PARA PROTECCIÓN CONTINUA CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS, CONECTE SÓLO EN UNA TOMA CON CONEXIÓN A TIERRA APROPIADA. NO RETIRE EL POLO DE CONEXIÓN A TIERRA
	 ADVERTENCIA SI ESTE EQUIPO SE INTEGRA COMO COMPONENTE EN UN SISTEMA, LA REVISIÓN DEL DISEÑO FINAL DEBERÁ LLEVARLA A CABO EL PERSONAL CUALIFICADO QUE CONOZCA LA ESTRUCTURA Y EL FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS COMPONENTES DE DICHO SISTEMA, ASÍ COMO LOS RIESGOS POTENCIALES QUE EXISTEN. SI NO SE TIENE EN CUENTA ESTA PRECAUCIÓN, SE PODRÍAN PRODUCIR DAÑOS PERSONALES O MATERIALES.
	 ADVERTENCIA EL MANTENIMIENTO DEL TERMINAL IND245x SOLO LO DEBE REALIZAR PERSONAL CUALIFICADO. TENGA CUIDADO AL REALIZAR COMPROBACIONES, PRUEBAS Y AJUSTES QUE SE DEBAN LLEVAR A CABO CON EL EQUIPO ENCENDIDO. SI NO SE TIENEN EN CUENTA ESTAS PRECAUCIONES, SE PUEDEN PRODUCIR LESIONES PERSONALES Y/O DAÑOS MATERIALES.
	 ADVERTENCIA ANTES DE CONECTAR O DESCONECTAR CUALQUIER COMPONENTE ELÉCTRICO INTERNO O INTERCONECTAR CABLES ENTRE EQUIPOS ELECTRÓNICOS, SIEMPRE DEBE DESCONECTAR LA ALIMENTACIÓN Y ESPERAR COMO MÍNIMO TREINTA (30) SEGUNDOS ANTES DE REALIZAR CUALQUIER CONEXIÓN O DESCONEXIÓN. SI NO SE TIENEN EN CUENTA ESTAS PRECAUCIONES, SE PUEDEN PRODUCIR DAÑOS EN EL EQUIPO O SU DESTRUCCIÓN.
	AVISO TENGA EN CUENTA ESTAS PRECAUCIONES PARA MANIPULAR LOS DISPOSITIVOS SENSIBLES A LA ELECTROESTÁTICA.

Requerimiento de desecho seguro



En conformidad con la Directiva Europea 2002/96/EC sobre Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (WEEE), este dispositivo no puede desecharse con la basura doméstica. Esto también es aplicable para países fuera de la UE, según sus requerimientos específicos.

Deseche este producto de acuerdo con las regulaciones locales en el punto de recolección especificado para equipos eléctricos y electrónicos.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la autoridad responsable o con el distribuidor a quien compró este dispositivo.

En caso que este dispositivo sea transferido a otras partes (para uso privado o profesional), también deberá mencionarse el contenido de esta regulación.

Gracias por su contribución a la protección ambiental.

Contenido

1	Introducción	1-1
1.1.	Información general del IND256x	1-1
1.2.	Especificaciones del producto	1-2
1.3.	Normas de prueba	1-4
1.4.	Advertencias y precauciones	1-6
1.5.	Inspección y lista de verificación del contenido	1-6
1.6.	Configuración	1-7
1.7.	Compensación de potencial (EB)	1-9
1.8.	Ambiente operativo	1-9
1.9.	Dimensiones	1-10
1.10.	Tarjeta principal	1-13
1.11.	Tarjetas opcionales de comunicación	1-13
2	Instalación	1
2.1.	Apertura de la caja	1
2.2.	Instale los cables y conectores	2
2.3.	Enlace y conexión a tierra	6
2.4.	Enlace de un solo punto equipotencial (EB)	7
2.5.	Cierra de la caja	7
2.6.	Conexión de celda de carga analógica	8
2.7.	Conexión de las tarjetas de comunicación	9
2.8.	Sellado de la caja	12
2.9.	Parámetro de interfaz	13

1 Introducción

1.1. Información general del IND256x

El IND256x refleja la tecnología de pesaje más reciente de METTLER TOLEDO. El IND256x ha aprobado la certificación de terceros para pesaje en áreas peligrosas, y puede usarse directamente en ubicaciones zona 1/zona 21.

Ya sea como terminal de pesaje de rango simple o de rango múltiple de alto rendimiento, el IND256x usa celdas de carga analógicas para lograr pesaje confiable a bajo costo, desde gramos hasta toneladas. Se integra fácilmente en un sistema de pesaje existente.

Al conectar la barrera de seguridad adecuada o barrera aislada, el IND256x puede proporcionar varias interfaces de comunicación intrínsecamente seguras para comunicarse con varias PC e impresoras en el área segura. Estas características permiten al IND256x ser compatible con la mayoría de las aplicaciones de pesaje en la mayor parte de los campos de la industria, entre otros:

- Farmacéutico
- Procesos de polvos
- Químicos especiales
- Petroquímica
- Agricultura
- Pinturas y tintas
- Ingeniería química fina

1.1.1. Versión del terminal IND256x

El IND256x está disponible con tres opciones diferentes de alimentación de energía:

- Entrada de energía de CA, mediante el uso de voltaje alternante externo 187 -250 V 50/60 Hz)
- Entrada de energía de CD, mediante el uso de voltaje directo externo 18 -30 V)
- Entrada de energía intrínsecamente segura, con el uso de un paquete de batería de Ex NiMH 64060627)

Cada una de estas versiones ha recibido aprobaciones de ATEX e IECEx para usarse en áreas clasificadas como zona 1 y zona 21.

1.1.2. Características del producto IND256x

- Pesaje básico en áreas peligrosas, incluyendo funciones de poner en cero, tara e imprimir
- Caja para montarse en escritorio, columna o pared en ambientes adversos
- Se conecta a una plataforma de pesaje analógica simple
- LCD con luz de fondo blanca de 240 x 96 pixeles y dígitos de 25 mm de altura

- Reloj en tiempo real ahorro al cortar la corriente)
- Incluye un puerto serial intrínsecamente seguro COM1) para comunicación de dos vías asíncrona e impresión
- Compatible con las siguientes tarjetas opcionales internas:
 - Salida analógica de 4-20 mA intrínsecamente seguro
 - Módulo de comunicaciones Wi-Fi con antena solo para terminales IND256x configurados de fábrica con módulo Wi-Fi)
 - Bucle de corriente activa – para conexión con un módulo de comunicaciones ACM200 ubicado en el área segura, o para conexión con un segundo terminal IND256x configurado con opción de bucle de corriente pasiva
 - Bucle de corriente pasiva se usa como la segunda pantalla para conectar otro terminal con un bucle de corriente activa)
- Compatible con tres entradas de número de identificación personalizada
- La tabla de objetivos soporta 25 objetivos predefinidos para pesaje de comprobación
- La tabla de tara soporta 20 valores predefinidos
- Compatible con g, kg, t, ton, lb y oz
- Guarda 60,000 elementos de datos de transacción
- Compatible con acumulación y total acumulativo
- Permite la personalización de cinco plantillas de impresión diferentes
- Compatible con calibración sin pesos CalFREE™)

1.2. Especificaciones del producto

Tabla 1-1 muestra las especificaciones del IND256x.

Tabla 1-1: Especificaciones del IND256x

Elemento	Especificación
Caja	Acero inoxidable 304, puede ser para montaje en pared o en poste
Dimensiones alto × ancho × profundidad)	173 mm × 230 mm × 127 mm 6.8 pulg. × 9.1 pulg. × 5.0 pulg.)
Peso de transporte	3.5 kg 8 lb)
Grado de protección	IP66
Ambiente para almacenamiento	Rango de temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60° C -4° a 140 °F) Humedad relativa: 10% a 95%, no condensante
Ambiente de servicio	Rango de temperatura de operación: -10°C a 40° C 14° a 104°F) Humedad relativa: 10% a 95%, no condensante

Elemento	Especificación
Área peligrosa	La aprobación del IND256x se usa para área peligrosa zona 1/zona 21.
Alimentación de energía	Energía de CA 187 -253 V 50/60 Hz)
	Energía de CD 18 -30 V)
	Paquete de batería externa de NiMHEx 64060627)
Alimentación de energía	Energía de CA 187 -253 V 50/60 Hz)
Pantalla	LCD con luz de fondo blanca de 240 x 96 pixeles y dígitos de 25 mm de altura Velocidad de actualización de la pantalla: 10 Hz
Presentación de peso	Máximo 100,000 divisiones
Tipo de plataforma de pesaje	Celda de carga analógica
Cantidad del sensor	Máximo de cuatro celdas de carga de 350 ohmios mínimo 87 ohmios), 2 mv/V o 3 mv/V
Cantidad de plataformas de pesaje	Compatible con una plataforma de pesaje
Velocidad de actualización	> 366 Hz
Voltaje de excitación del sensor	4.5 VCD
Sensibilidad mínima	0.6μV/e
Teclado	26 teclas; teclado de membrana de 1.5 mm de espesor
Modo de comunicación	Interfaz estándar: La tarjeta principal se proporciona con una interfaz de comunicación RS232 intrínsecamente segura Opciones de interfaz: Módulo de salida analógica de 4-20 mA intrínsecamente segura, con conversión D / A de 16 bits y velocidad de actualización de 25 Hz a PLC; o Módulo de comunicaciones Wi-Fi solo para terminales IND256x configurados de fábrica con módulo Wi-Fi); o Bucle de corriente activa intrínsecamente seguro o Bucle de corriente pasiva intrínsecamente seguro Protocolos de comunicación: Entrada de puerto serial: Comandos ASCII para CTPZ borrar, tara, imprimir, cero), SICS compatible con SICS nivel 0 y nivel 1) Salida de puerto serial: Salida continua Toledo, salida de impresión de comando 5 5 plantillas configurables), comando SICS e impresión de reportes
Aprobación metrológica	Europa: OIML R76; Clase III, 6000e; TC10878 Global: OIML R76; Clase III, 6000e; R76-2006-A-NL1-18.27

Elemento	Especificación
Aprobación de áreas peligrosas, versión WiFi configurada de fábrica	Con alimentación no intrínsecamente segura versión CA y versión CD): II 2G Ex eb ib [ib] mb IIB T4 Gb II 2D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db con alimentación intrínsecamente segura batería): II 2G Ex ib IIB T4 Gb II 2D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
Aprobación de áreas peligrosas, versión sin WiFi	Con alimentación no intrínsecamente segura versión CA y versión CD): II 2G Ex eb ib [ib] mb IIC T4 Gb II 2D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db con alimentación intrínsecamente segura batería): II 2G Ex ib IIC T4 Gb II 2D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db

Tabla 1-2: Especificación de módulo Wi-Fi solo para terminales IND256x configurados de fábrica con módulo Wi-Fi)

Elemento	Especificación
Estándar	802.11 b/g/n
Energía de transmisión	14 dBm promedio)
Rango de frecuencia RF	2.4 GHz – 2.497 GHz
Cifrado	WEP, WPA
WEP	64 bit, 128 bit
WPA	WPA-TKIP, WPA2-AES
Protocolo	TCP/IP
Modo de trabajo	Servidor, cliente
Distancia de transmisión	Máx. 50 metros en campo abierto
Aprobación	China: SRRC

1.3. Normas de prueba

El terminal IND256x ha sido probado de acuerdo con las siguientes normas.

EN 60079-0:2012 + A11:2013	Requerimientos generales
EN 60079-7:2015	Mayor seguridad "e"
EN 60079-11:2012	Seguridad intrínseca "i"
EN 60079-18:2015	Encapsulamiento "m"
EN 60079-31:2014	Protección mediante caja "t"
IEC 60079-0:2017, Ed. 7.0	Requerimientos generales
IEC 60079-7:2017, Ed. 5.1	Mayor seguridad "e"

IEC 60079-11:2011, Ed. 6.0	Seguridad intrínseca "i"
IEC 60079-18:2017, Ed. 4.1	Encapsulamiento "m"
IEC 60079-31:2013, Ed. 2.0	Protección mediante caja "t"
FM3600 2011)	Equipo eléctrico para usarse en lugares peligrosos clasificados), requerimientos generales
FM3610 2010)	Aparato seguro intrínsecamente y aparatos asociados para usarse en lugares peligrosos clasificados) Clase I, II y III, División 1
FM3810 2005)	Equipo eléctrico para medición, control y uso en laboratorio
ANSI/IEC 60529	Grados de protección proporcionados por cajas código IP)
CSA C22.2 No. 157-1992 / 2006	Equipo intrínsecamente seguro y no incendiario para usarse en lugares peligrosos
CSA C22.2 No. 142-1990 / 2004	Equipo de control de proceso
CSA C22.2 No. 61010.1-2004	Requerimientos de seguridad para equipo eléctrico de medición, control y uso en laboratorio - Parte 1: Requerimientos generales
CAN/CSA 22.2 No. 60529-2005	Grados de protección proporcionados por cajas código IP)

1.3.1. Condiciones especiales de uso

1. El aparato debe estar protegido de la luz ultravioleta
2. La carga electrostática durante la operación y el mantenimiento debe excluirse. El terminal solo deberá instalarse en áreas donde no haya presentes cargas operativas y electrostáticas relacionadas con el proceso.
3. Para versiones con alimentación de CD no intrínsecamente segura la clave de tipo termina con "44" o "46"): No existe separación galvánica entre el circuito de alimentación no intrínsecamente seguro y los circuitos de salida intrínsecamente seguros:

El circuito de alimentación no intrínsecamente seguro tiene que estar conectado en forma segura a tierra. En este caso, los circuitos intrínsecamente seguros están conectados a tierra también. Junto con los circuitos intrínsecamente seguros, debe existir ecualización potencial.

O bien

El circuito no intrínsecamente seguro tiene que estar separado en forma segura de la conexión a tierra por ejemplo, SELV -circuito).

4. Para el terminal versión para CD, el circuito de alimentación deberá tener como máximo una categoría de sobrevoltaje II de acuerdo con IEC 60664-1.
5. Los casquillos para cables serie HSK-M-Ex... y V-MS-Ex... de acuerdo con KEMA 99 ATEX 6971X resp. a IECEx BVS 07.0014X se prueban con una fuerza de tensión reducida 25%) de acuerdo con la cláusula A.3.1 de IEC 60079-0 y pueden usarse solamente para instalación fija de aparatos grupo II. El usuario se asegurará de la sujeción adecuada del cable.
6. La antena WiFi se prueba para bajo riesgo o peligro mecánico altura de impacto de 0.4 m con peso de 1 kg) y deberá estar protegida contra niveles de energía de alto impacto.

1.4. Advertencias y precauciones

Lea las siguientes instrucciones detenidamente antes de comenzar a operar el nuevo terminal.

Aunque el IND256x tiene una construcción resistente, no obstante es un instrumento de precisión. Tenga cuidado con el terminal al manejarlo e instalarlo.

	 ADVERTENCIA
	NO INSTALE, NI LLEVE A CABO NINGÚN SERVICIO EN ESTE EQUIPO ANTES DE QUE LA PERSONA RESPONSABLE HAYA AUTORIZADO AL PERSONAL PARA ASEGURAR EL ÁREA COMO NO PELIGROSA EN EL CENTRO DEL CLIENTE.
	 ADVERTENCIA
	SOLO LOS COMPONENTES ESPECIFICADOS EN ESTE MANUAL PUEDEN USARSE EN ESTE TERMINAL. TODO EL EQUIPO DEBE INSTALARSE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DESCRITAS EN ESTE MANUAL. EL USO DE COMPONENTES INCORRECTOS O SUSTITUTOS Y/O LA DESVIACIÓN DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE ALTERAR LA SEGURIDAD INTRÍNSECA DEL TERMINAL Y DAR COMO RESULTADO LESIONES PERSONALES O DAÑOS A LA PROPIEDAD.
	 ADVERTENCIA
	NO ABRIR AL ESTAR ENERGIZADO.
	 ADVERTENCIA
	RIESGO DE CARGA ELECTROSTÁTICA POTENCIAL, VEA LAS INSTRUCCIONES.
	 ADVERTENCIA
	NO ABRIR CUANDO HAYA UNA ATMÓSFERA EXPLOSIVA PRESENTE.
	 ADVERTENCIA
	EL TERMINAL ENSAMBLADO CON UNA ANTENA WIFI DEBERÁ INSTALARSE DE TAL FORMA QUE EL RIESGO DE DAÑO MECÁNICO SEA BAJO. REEMPLACE LA ANTENA WIFI INMEDIATAMENTE SI SE DAÑA.

1.5. Inspección y lista de verificación del contenido

Al recibir el IND256x, verifique que el embalaje esté intacto. Si la caja está dañada, revise si el IND256x está dañado y, si es necesario, presente un reclamo ante la empresa de transporte. Si el embalaje no está dañado, desempaque el IND256x, preste atención al embalaje original y verifique que nada esté dañado.

- Para asegurar el transporte seguro, es mejor usar el embalaje original y el método de embalaje correcto.

La caja de embalaje contiene:

Terminal de pesaje IND256x CD de documentación incluyendo manual y certificado de inspección)

Bolsa de accesorios para usarse durante la instalación

1.6. Configuración

1.6.1. Configuración del sistema

Figura 1-1 muestra las opciones de configuración del terminal.

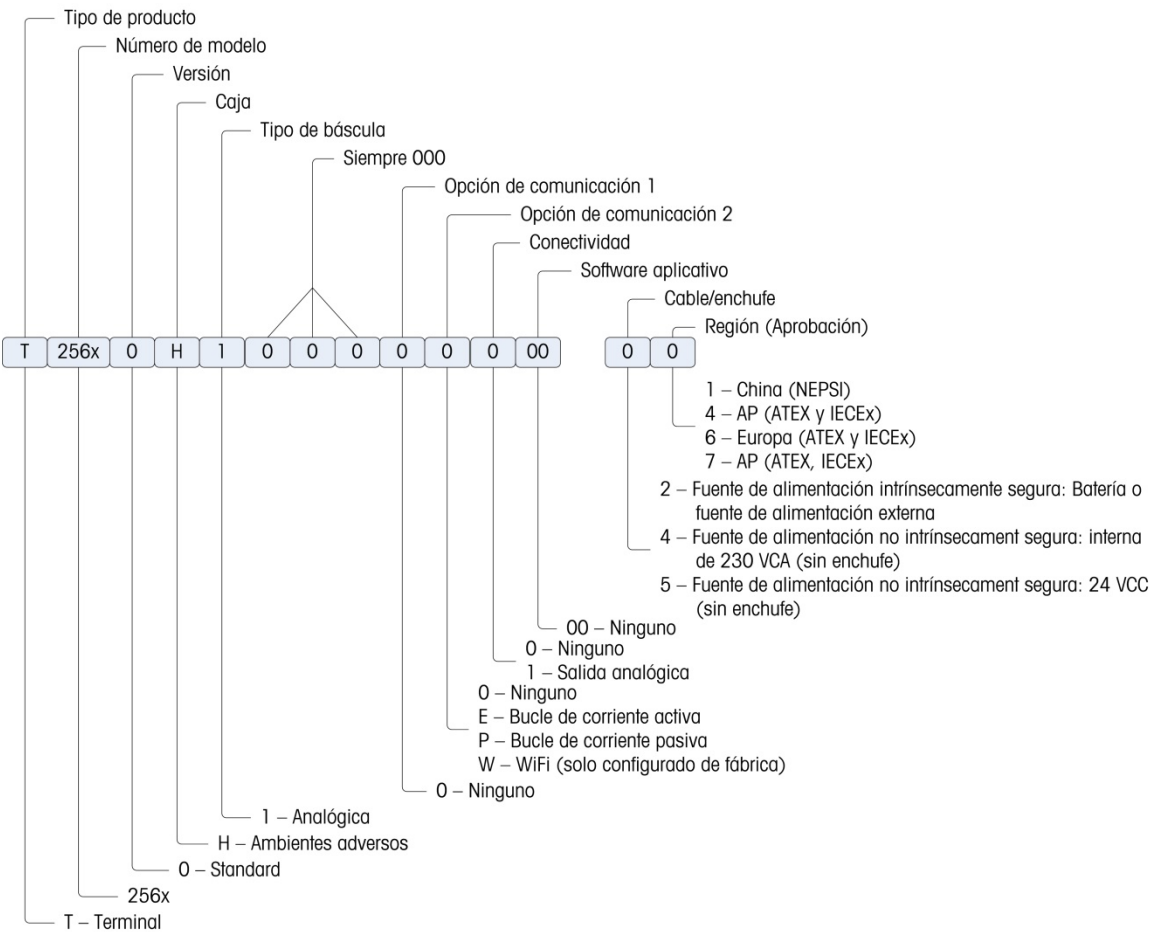


Figura 1-1: Tabla de configuración del IND256x

ADVERTENCIA

LOS TERMINALES IND256X CONFIGURADOS EN FÁBRICA CON WIFI ESTÁN APROBADOS PARA SU USO EN ÁREAS CLASIFICADAS PARA EL GRUPO DE EQUIPOS IIB DE ZONA 1. LOS TERMINALES IND256X CONFIGURADOS EN FÁBRICA CON WIFI NO SE DEBEN USAR EN ÁREAS CLASIFICADAS PARA EL GRUPO DE EQUIPOS IIC. USAR EL TERMINAL IND256X CONFIGURADO EN FÁBRICA CON WIFI EN UN ÁREA CLASIFICADA PARA LA CUAL NO ESTÁ APROBADO PODRÍA PROVOCAR LESIONES CORPORALES O DAÑOS EN LA PROPIEDAD.

AVISO

LA CAPACIDAD WI-FI ESTÁ DISPONIBLE SOLAMENTE EN TERMINALES IND256x CONFIGURADOS ASÍ EN LA FÁBRICA.

1.6.2. Código de fecha del producto

La fecha de fabricación o el código de fecha para el terminal se encuentra en la placa de datos seriales en la parte superior de la caja).

El número de serie comenzará con una letra y un número por ejemplo, B212000371). La letra representa los tres primeros dígitos del año de acuerdo con la tabla de códigos de fecha en Tabla 1-3 la letra "B" en nuestro ejemplo representa "201x") y el número es el dígito del año de la unidad el número "2" en nuestro ejemplo). Por lo tanto, "B4" representa el año 2014.

Tabla 1-3: Formatos de códigos de fecha actuales y posteriores

Código de fecha	Año	Código de fecha	Año
A	200x	F	205x
B	201x	G	206x
C	202x	H	207x
D	203x	J	208x
E	204x	K	209x

1.6.3. Conexiones

La siguiente figura muestra los lugares de conexión en la parte posterior de la caja para ambientes adversos.

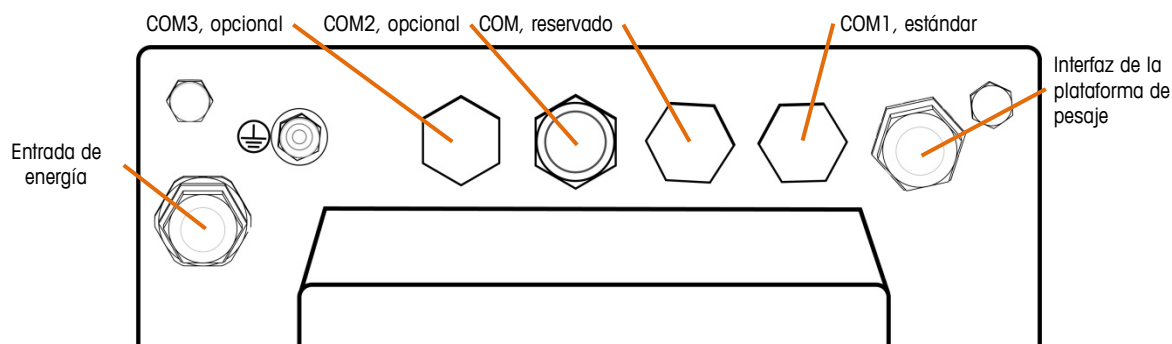


Figura 1-2: Ubicaciones de los puertos de conexión del IND256x

Entrada de energía Entrada de alimentación de energía de 220 VCA 187 -250 V 50/60 Hz) versión ATEX e IECEx)
o bien entrada de alimentación de energía de 24 VCD 18 V 50/60 Hz) versión ATEX e IECEx)
o bien batería externa Ex

COM1 estándar)	intrínsecamente segura RS232
COM2 opcional)	salida analógica intrínsecamente segura de 4-20 mA <i>o bien</i> módulo de comunicación WiFi solo para terminales IND256x configurados de fábrica)
COM3 opcional)	bucle de corriente activa intrínsecamente seguro <i>o bien</i> bucle de corriente pasiva intrínsecamente seguro
Reservado para COM	No se usa

1.6.4. Advertencias

1.6.4.1. CENELEC

Conexión de EB según las regulaciones específicas del país: Debe asegurarse de que las cajas de todos los dispositivos estén conectadas al mismo potencial a través de terminales EB. No debe fluir corriente circulante a través del blindaje de los cables intrínsecamente seguros.

1.6.4.2. cFMus

Conexión de EB según ANSI/NFPA 70, artículo 504, y ANSI/IA RP 12.06.001 o Código Eléctrico Canadiense C22.2: Debe asegurarse de que las cajas de todos los dispositivos estén conectadas al mismo potencial a través de terminales EB. No debe fluir corriente circulante a través del blindaje de los cables intrínsecamente seguros.

1.7. Compensación de potencial EB)

Un técnico eléctrico autorizado por el propietario debe realizar la compensación de potencial. El servicio de METTLER TOLEDO realiza solamente una función de monitoreo y consulta para este procedimiento.

Conecte el enlace de un solo punto equipotencial de todos los dispositivos unidad de alimentación de energía, terminal de pesaje, convertidor de interfaz y plataforma de pesaje) de acuerdo con el diagrama del terminal y todos los reglamentos y normas específicos del país. En el proceso, se debe asegurar que:

- Todas las cajas de dispositivos estén conectadas al mismo potencial a través de terminales EB.
- No fluya corriente circulante a través del blindaje del cable para circuitos intrínsecamente seguros.
- El punto neutral para el enlace de un solo punto equipotencial esté tan cerca como sea posible del sistema de pesaje.

1.8. Ambiente operativo

Cuando seleccione la ubicación:

- Seleccione una superficie estable libre de vibraciones para instalar el terminal

- Verifique que no haya fluctuaciones excesivas de temperatura ni **exposición directa a los rayos solares**
- Evite corrientes de aire sobre la plataforma de pesaje por ejemplo, de ventanas abiertas o de aire acondicionado)
- Calibre el terminal después de cualquier cambio de ubicación geográfica

1.8.1.1.

Temperatura y humedad

El IND256x puede almacenarse y operarse en las condiciones de temperatura y humedad relativa descritas en la Tabla 1-1.

1.8.1.2.

Protección ambiental

El terminal IND256x tiene protección ambiental como se especifica en la Tabla 1-1.

1.9. Dimensiones

La Figura 1-3 y la Figura 1-4 muestran las dimensiones del terminal. Las unidades son en pulgadas y [mm].

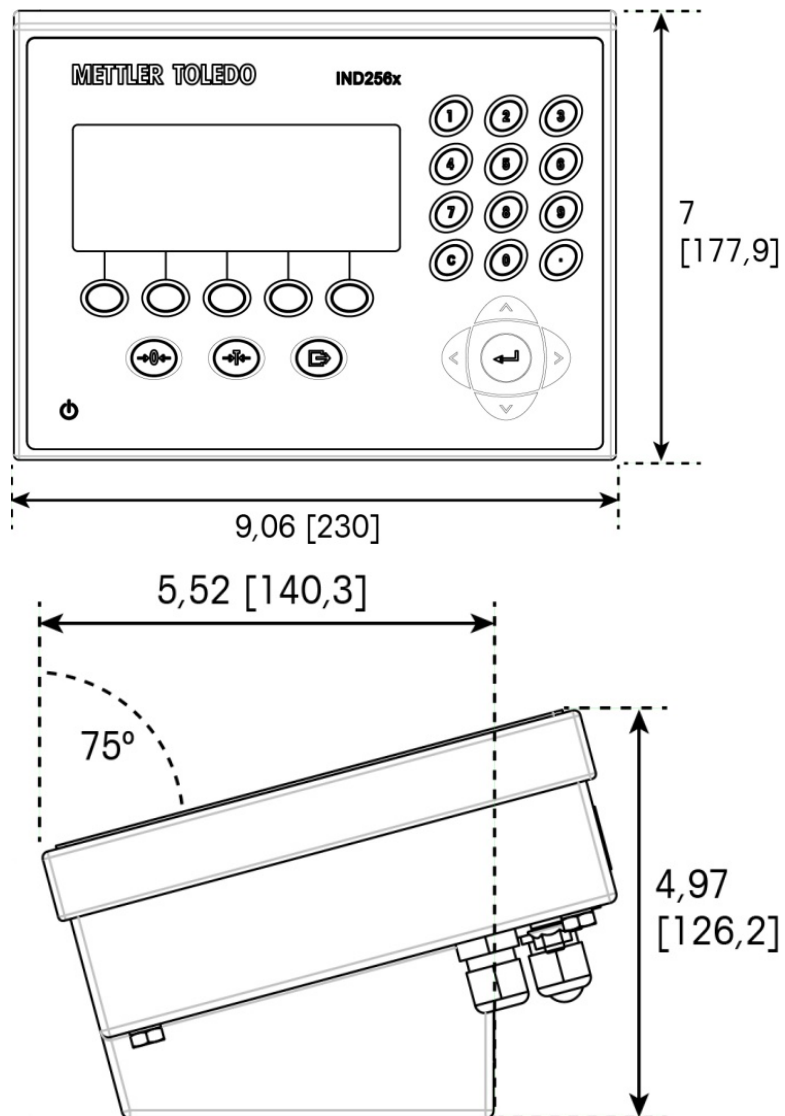


Figura 1-3: Dimensiones del IND256x, instalación en escritorio

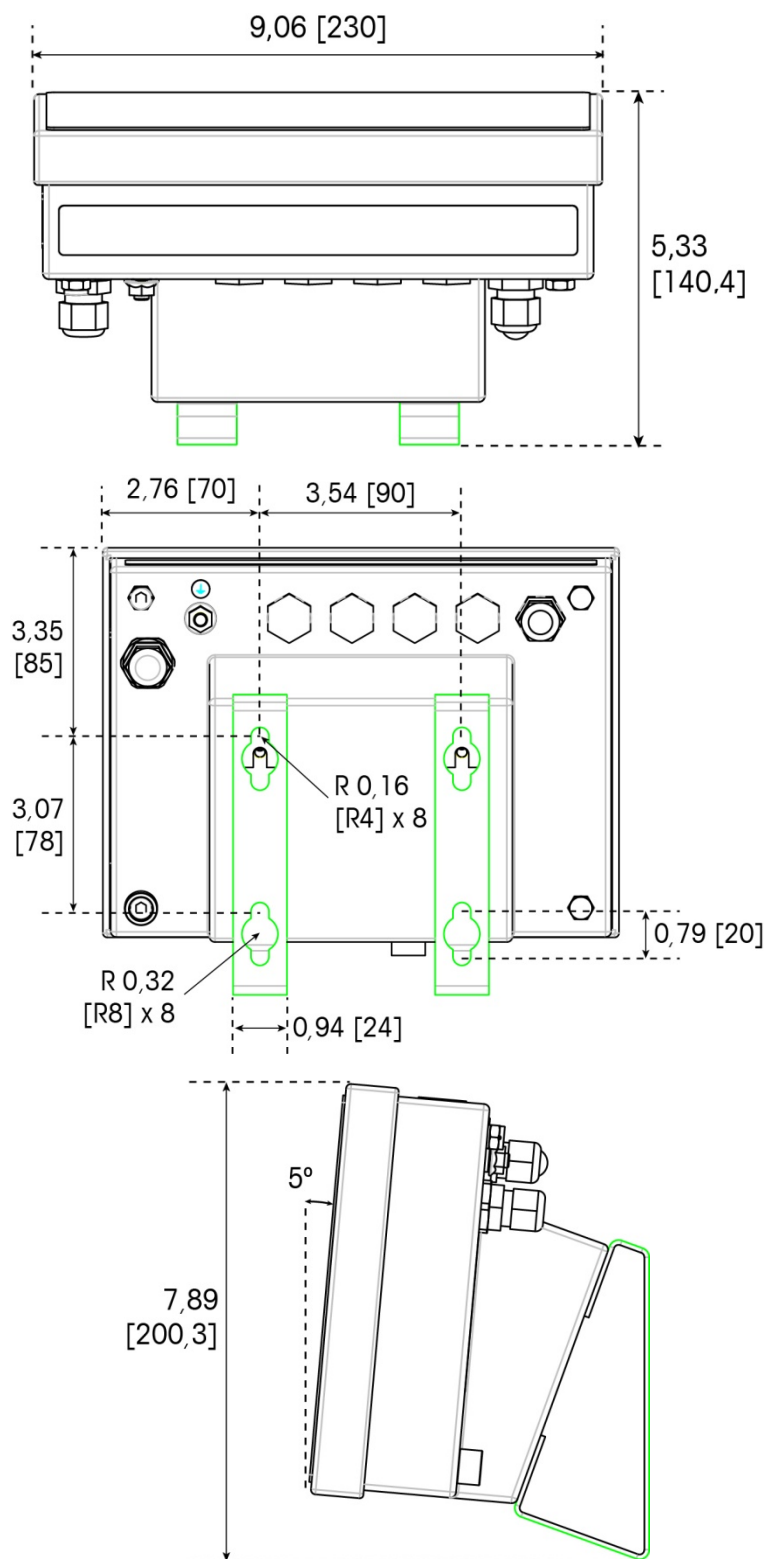


Figura 1-4: Dimensiones del IND256x, con soporte para montaje en pared

1.10. Tarjeta principal

La tarjeta principal del IND256x tiene las siguientes conexiones principales, indicadas en la Figura 1-5:

1. Interfaz de pesaje de celdas de carga analógicas
2. Interfaz de entrada de energía intrínsecamente segura, que conecta el módulo de energía
3. Interfaz de arnés de cable plano, usado para conectar la pantalla
4. Interfaz RS232 intrínsecamente segura COM1)
5. Dos interfaces de tarjetas opcionales de comunicación COM2 y COM3)

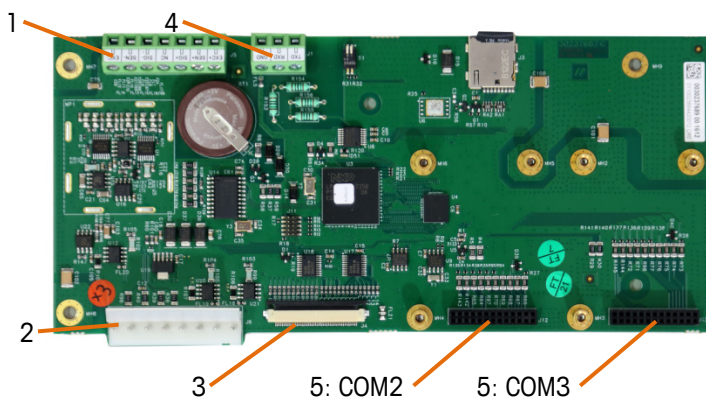


Figura 1-5: Tarjeta principal del IND256x

1.11. Tarjetas opcionales de comunicación

El IND256x puede configurarse con un máximo de dos de las tres tarjetas opcionales de comunicación instaladas dentro de la caja. Las opciones son:

- Módulo de comunicación Wi-Fi disponible solamente en terminales IND256x configurados de fábrica con Wi-Fi)
- Salida analógica de 4-20 mA intrínsecamente seguro
- Bucle de corriente activa módulo de comunicaciones ACM200 que puede conectarse al área segura)
- Bucle de corriente activa para conexión con un módulo de comunicaciones ACM200 ubicado en el área segura, o para conexión con un segundo terminal IND256x configurado con opción de bucle de corriente pasiva

2 Instalación

2.1. Apertura de la caja

	 ADVERTENCIA
	NO INSTALE, NI REALICE TAREAS DE MANTENIMIENTO EN EL EQUIPO, ANTES DE QUE EL PERSONAL AUTORIZADO POR LA PERSONA RESPONSABLE EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE HAYA DETERMINADO QUE EL ÁREA EN LA QUE SE ENCUENTRA EL TERMINAL IND245x NO ES PELIGROSA.
	 PRECAUCIÓN
	CONFIRME LA CONFORMIDAD CON LAS REGULACIONES LOCALES Y NACIONALES APLICABLES EN CUANTO A LA CONEXIÓN WIFI ANTES DE INSTALAR Y PONER EN MARCHA EL TERMINAL IND256x CONFIGURADO CON UN MÓDULO WIFI. METTLER TOLEDO NO SE HARÁ RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN DE TERMINALES EN PAÍSES EN LOS QUE NO SE CUMPLAN LAS REGULACIONES RELATIVAS A LA CONEXIÓN WIFI.
	 ADVERTENCIA
	PREVENGA LA IGNICIÓN DE GAS PELIGROSO. ASEGÚRESE DE INTERRUPTIR LA ENERGÍA ANTES DE ABRIR LA CAJA DEL IND256X. UNA VEZ QUE EL IND256X ESTÁ ENCENDIDO, MANTENGA LA CAJA EstrictAMENTE SELLADA. NO ABRA LA CAJA EN PRESENCIA DE POLVO O GAS EXPLOSIVO.

Abra el terminal IND256x de acuerdo con los pasos de las siguientes secciones.

La cubierta frontal del terminal IND256x está fijada con 4 tornillos. Para ver la configuración del hardware dentro del instrumento, ábralo como se muestra a continuación:

1. Coloque el terminal boca abajo sobre una superficie plana, teniendo cuidado de no dañar la fascia.
2. Afloje los tornillos prisioneros como se indica en Figura 2-1.



Figura 2-1: Tornillos de la caja

3. Levante la cubierta posterior y gírela para exponer el interior. Observe las dos correas que fijan el panel frontal a la caja.

2.2. Instale los cables y conectores

Los cables y conectores del terminal IND256x son los siguientes:

- Casquillos para cables de cajas para ambientes adversos
- Conexiones del cableado de la tarjeta principal
- Conexión de energía

	ADVERTENCIA
	SOLAMENTE SE PERMITE AL PERSONAL DE SERVICIO PROFESIONAL OPERAR ESTE INSTRUMENTO. TENGA CUIDADO DURANTE LA INSPECCIÓN, PRUEBA Y AJUSTE. LA OPERACIÓN INCORRECTA PUEDE CAUSAR LESIONES.

El terminal IND256x es adecuado para lavado intenso en entornos con polvo. Sin embargo, es necesario tener acceso al interior de la caja del terminal al instalar cables o conectores. Cada cable que entra en la caja tiene asignada una posición específica.

2.2.1. Casquillos para cables de cajas para ambientes adversos

Para asegurar la resistencia al agua y el sello contra el polvo:

1. Pase el cable de tamaño adecuado a través del casquillo correcto antes de conectar los alambres. Dependiendo del tamaño del casquillo, se deben usar cables de un diámetro específico. Los tamaños de cables requeridos se muestran en la Tabla 2-1.

Tabla 2-1: Diámetros de cables para casquillos

Casquillo	Diámetro del cable
Celda de carga analógica	6–10 mm (0,24–0,39")
COM1 (IS-RS232)	6–10 mm (0,24–0,39")

Casquillo	Diámetro del cable
Bucle de corriente (activa y pasiva)	6–10 mm (0,24–0,39")
Cable eléctrico CA/CD	6–10 mm (0,24–0,39")
Salida analógica de 4-20 mA	6–10 mm (0,24–0,39")
Batería externa	4-8 mm (0,16–0,3 pulg.)

Avisos importantes

- Use solamente casquillos o tapones certificados ATEX con el terminal IND256x
 - Los casquillos para cables deben estar protegidos contra daños por impactos.
 - Debe asegurarse suficiente alivio de la tensión para prevenir fuerzas de tracción en los casquillos de los cables.
2. Al hacer terminaciones de cables dentro de la caja para ambientes adversos, asegúrese de que toda la longitud del cable desde la banda/conector a la caja del terminal sea suficiente para que no se ejerza ninguna tensión en el mecanismo del conector cuando la caja esté totalmente abierta.
 3. Los cables que incluyen blindajes deben tener el blindaje terminado en el casquillo como se muestra en la Figura 2-2. Separe los alambres del blindaje y asegúrese de que haya suficiente alambre de blindaje presente para hacer buen contacto con la parte metálica del casquillo.

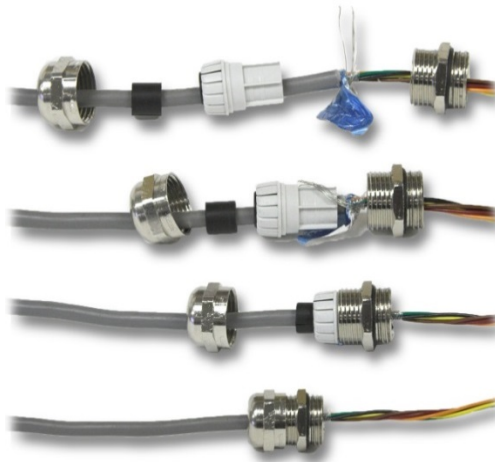


Figura 2-2: Terminación del blindaje en el casquillo

2.2.2. Conexión de energía

	 ADVERTENCIA
	LA CONEXIÓN DE LA UNIDAD DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA DEBE HACERLA UN TÉCNICO ELÉCTRICO PROFESIONAL AUTORIZADO POR EL PROPIETARIO Y DE ACUERDO CON EL RESPECTIVO DIAGRAMA DEL TERMINAL, LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN INCLUIDAS Y LAS NORMAS ESPECÍFICAS DEL PAÍS.

Donde se acepte IECEx y ATEX, el IND256x puede energizarse con una alimentación de energía interna conectada a una entrada de energía externa de CA de 230 V.

La energía se conecta a través de un conector de seguridad aumentada en la esquina derecha dentro de la caja (Figura 2-3). El protector está cubierto por una cubierta de plástico.

El terminal se proporciona con un cable de energía de 5 metros, sin clavija. Los terminales con alimentación de energía intrínsecamente segura se entregan sin cable de alimentación eléctrica.

2.2.2.1. Entrada de energía de CA interna (solo terminales aprobados IECEx y ATEX)

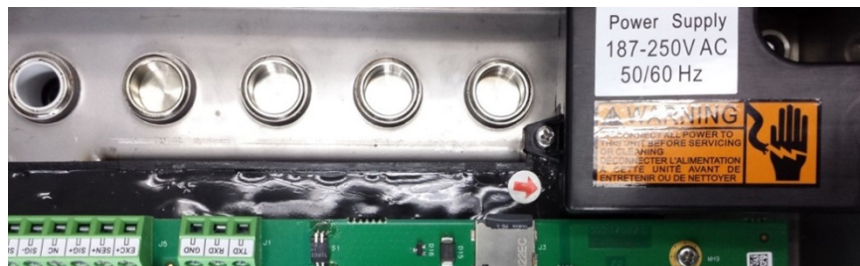


Figura 2-3: Conector de entrada de energía de CA con cubierta



Figura 2-4: Conector de entrada de energía de CA, con la cubierta retirada

Tabla 2-2: Código de colores del cable de entrada de energía de CA

Patilla	Color de la patilla
L	Marrón
N	Azul

2.2.2.2. Entrada de energía de CD interna (solo terminales aprobados IECEx y ATEX)

	¡ADVERTENCIA
	LA ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA DE CD DEBE CONECTARSE A UNA ENTRADA DE CD DE 18-30 V. NO LA CONECTE A ENERGÍA DE CA

	⚠ ¡ADVERTENCIA PARA LOS TERMINALES IND256x VERSIÓN CD, NO HAY SEPARACIÓN GALVÁNICA ENTRE EL CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN NO INTRÍNECAMENTE SEGURO Y LOS CIRCUITOS DE SALIDA INTRÍNECAMENTE SEGUROS. EL CIRCUITO NO INTRÍNECAMENTE SEGURO DEBE CONECTARSE EN FORMA SEGURA A TIERRA. Y DEBE EXISTIR ECUALIZACIÓN DE POTENCIA A LO LARGO DE LOS CIRCUITOS INTRÍNECAMENTE SEGUROS. EN FORMA ALTERNATIVA, EL CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN NO INTRÍNECAMENTE SEGURO (SELV) DEBE ESTAR SEPARADO EN FORMA SEGURA DE LA TIERRA.
	⚠ ¡ADVERTENCIA LA ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA CD EXTERNA PROPORCIONADA POR EL CLIENTE DEBE TENER UNA CATEGORÍA II DE SOBREVOLTAJE MÁXIMO DE ACUERDO CON IEC 60664-1.

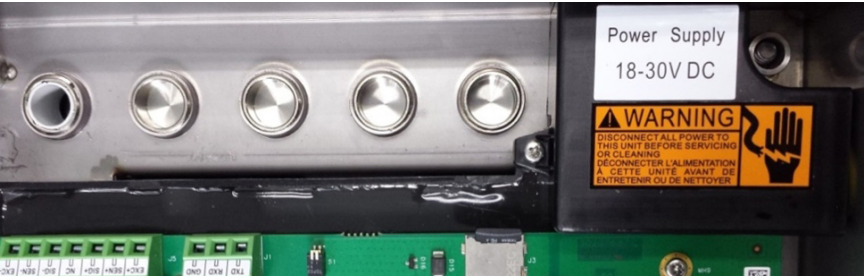


Figura 2-5: Conector de entrada de energía de CD con cubierta

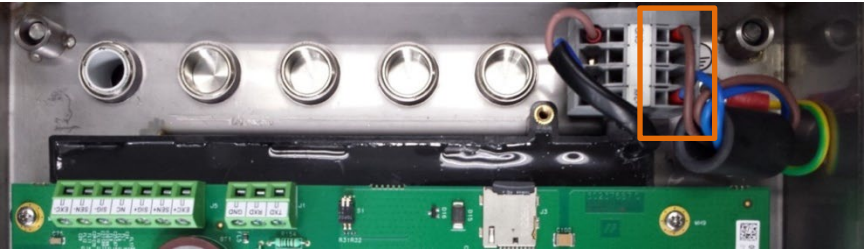


Figura 2-6: Conexiones de entrada de energía de CD, vista interna

Tabla 2-3: Código de colores del cable de entrada de energía de CD

Patilla	Color de la patilla
TIERRA	Marrón
+24 V	Azul

2.2.2.3.

Entrada externa de la batería NiMH

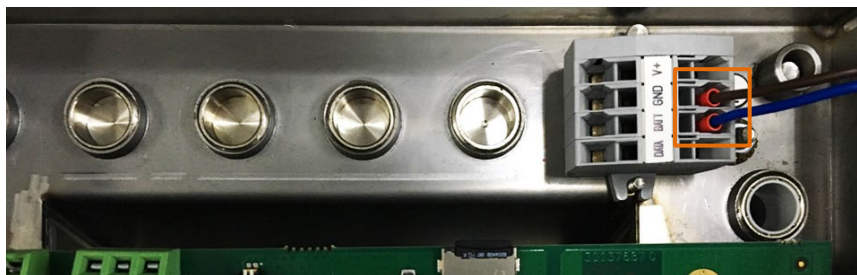


Figura 2-7: Conexiones de entrada de batería NiMH, vista interna

Tabla 2-3: Código de colores del cable de entrada de batería NiMH

Patilla	Color de la patilla
DATOS	Vacío
BAT.	Azul
TIERRA	Marrón
V+	Vacío

2.3. Enlace y conexión a tierra

Toda la conexión a tierra y conexiones de enlace potencial igual deben hacerse de acuerdo con las regulaciones locales aplicables en el país de instalación. Consulte los códigos locales y el diagrama de control para detalles específicos referentes a la conexión a tierra.

Es común que las regulaciones regionales requieran que todos los equipos conectados en el sistema sean enlazados unos con otros y conectados a tierra en un solo punto. En el terminal IND256x Figura 2-8 se proporciona un tornillo especial para conexión a tierra externo diseñado para enlace potencial igual.



Figura 2-8: Tornillo de conexión a tierra del terminal IND256x:

2.4. Enlace de un solo punto equipotencial (EB)

Un técnico eléctrico autorizado por el propietario debe realizar el enlace de un solo punto equipotencial. El servicio de METTLER TOLEDO realiza solamente una función de monitoreo y consulta para este procedimiento.

Conecte el enlace de un solo punto equipotencial de todos los dispositivos (unidad de alimentación de energía, terminal de pesaje, convertidor de interfaz y plataforma de pesaje) de acuerdo con el diagrama del terminal y todos los reglamentos y normas específicos del país. En el proceso, se debe asegurar que:

- Todas las cajas de dispositivos estén conectadas al mismo potencial a través de terminales EB.
- No fluya corriente circulante a través del blindaje del cable para circuitos intrínsecamente seguros.
- El punto neutral para el enlace de un solo punto equipotencial esté tan cerca como sea posible del sistema de pesaje.

2.4.1. Advertencias

2.4.1.1. CENELEC

2.4.1.1.1. Conexión de EB según las regulaciones específicas del país

Debe asegurarse de que las cajas de todos los dispositivos estén conectadas al mismo potencial a través de terminales EB. No debe fluir corriente circulante a través del blindaje de los cables intrínsecamente seguros.

2.4.1.2. cFMus

2.4.1.2.1. Conexión de EB según ANSI/NFPA 70, artículo 504, y ANSI/IA RP 12.06.01 o Código Eléctrico Canadiense C22.2

Debe asegurarse de que las cajas de todos los dispositivos estén conectadas al mismo potencial a través de terminales EB. No debe fluir corriente circulante a través del blindaje de los cables intrínsecamente seguros.

2.5. Cierra de la caja

Para asegurar que la cubierta frontal esté instalada correctamente:

- Coloque la cubierta frontal sobre una superficie plana
- Asegúrese de que el anillo de sello esté colocado con precisión
- Instale la cubierta posterior y asegúrese de que esté colocada con precisión
- Instale los tornillos en sus posiciones originales
- Apriete cada tornillo a 3.0 Nm

2.6. Conexión de celda de carga analógica

Las celdas analógicas están conectadas a la tarjeta principal en el conector como se muestra en el Capítulo 1, Introducción.

El terminal IND256x está diseñado para energizar hasta cuatro celdas de carga de 350 ohmios (o una resistencia mínima de aproximadamente 87 ohmios). Para confirmar que la celda de carga para esta instalación esté dentro de los límites, se debe calcular la resistencia total de la báscula (TSR).

Para calcular la TSR:

$$\text{TSR} = \frac{\text{Resistencia de entrada de la celda de carga (ohmios)}}{\text{Número de celdas}}$$


Compruebe que la TSR de la red de trabajo de las celdas de carga a ser conectada al IND256x tenga una resistencia mayor de 87 ohmios antes de conectarla a las celdas de carga. Si la resistencia es menor de 87 ohmios, el IND256x no funcionará correctamente.

Además, se debe revisar la distancia máxima del cable. La Tabla 2-4 proporciona longitudes de cable máximas recomendadas con base en el calibre del cable y la operación correcta del terminal. Observe que los valores de entidad para el cable de la celda de carga deben considerarse como un factor de seguridad en la instalación.

Tabla 2-4: Longitudes máximas recomendadas de cable

TSR (ohmios)	Calibre 24 (metros/pies)	Calibre 20 (metros/pies)	Calibre 16 (metros/pies)
1 a 4 celdas de carga de 350 Ω	60/200	182/600	304/1000

La Figura 2-9 muestra el cableado para celdas de carga analógicas. Cuando se usa una celda de cuatro conductores, +Exc debe conectarse en puente a +Sen y -Exc debe conectarse en puente a -Sen.

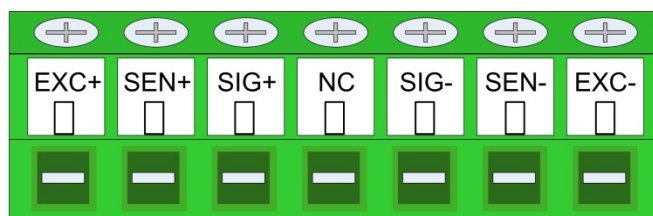

OBSERVAÇÕES

1. BITOLA DO FIO: 18 AWG (0.823 mm²) MÁX., 24 AWG (0.205 mm²) MIN.
2. TERRA DE CHASSIS: GLÁNDULA DE METAL

Figura 2-9: Terminación de las celdas de carga

2.7. Conexión de las tarjetas de comunicación

2.7.1. Puerto serial (COM1)

El puerto COM1 incluye conexiones para un dispositivo serial intrínsecamente seguro. La Figura 2-10 indica el conector del puerto COM1. La longitud del cable de esta conexión está limitada a 10 m (33 pies).

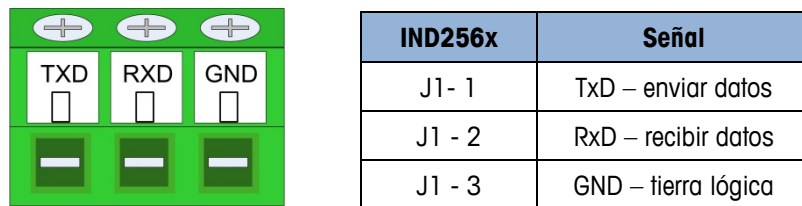


Figura 2-10: Señales del puerto COM1

La Figura 2-11 muestra un ejemplo de conexión a un dispositivo RS-232 en el área segura a través de una barrera de diodos Zener. Cuando seleccione una barrera, consulte los valores de aprobación de entidad de COM1. Observe que los sellos y otros dispositivos de protección también se requieren para cumplir con los códigos de cableado en área peligrosa.

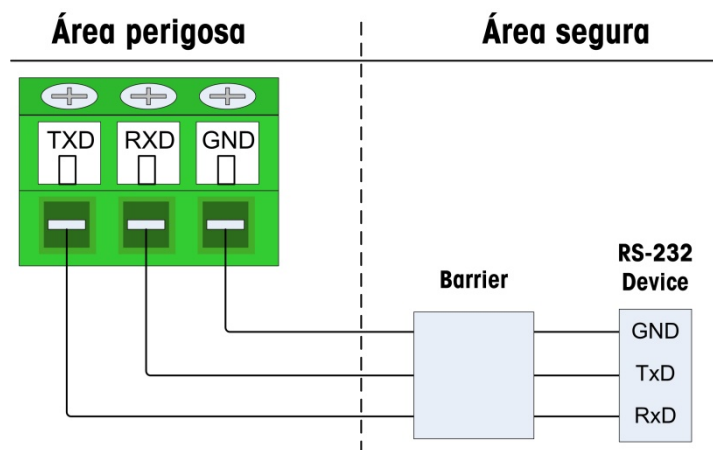


Figura 2-11: Conexión RS-232 de ejemplo

Una barrera que se ha probado para operación correcta con el IND256x, y puede conectarse directamente con COM1, es:

- MTL7761Pac (aprobaciones IECEx y ATEX)

2.7.2. Bucle de corriente activa


La tarjeta opcional de bucle de corriente activa puede instalarse solamente en el conector COM3 de la tarjeta principal. Cuando el IND256x está conectado al ACM200, es necesario conectar el ACM200 con el bucle de corriente activa para lograr comunicación en el área de seguridad.

Tabla 2-5: Conexiones del bucle de corriente activa con ACM200

IND256x COM3 (J2)	ACM200 COM (J3)
1	4
2	3
3	2
4	1

Los cables específicos del cliente para circuitos intrínsecamente seguros deben personalizarse de la siguiente manera:

	IND256x – ACM200
Cable	2 x 2 x 0,5 mm ²
Dimensión A (IND256x)	110 mm (2,4")
Dimensión B (ACM200)	70 mm (2,8")
Longitud máxima	300 m (1000 pies)

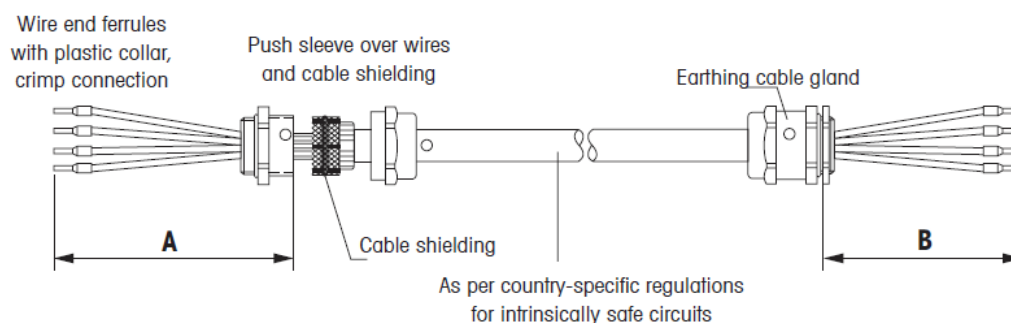

4. Corte el cable a la longitud y retire el aislamiento de los extremos del cable de acuerdo con la dimensión A/B.
5. Recorte el blindaje del cable en ambos lados a 10 mm (0,4").
6. Retire el aislamiento de los extremos del cable.
7. Doble férulas de extremo de cable en los extremos de los cables con una herramienta de doblado.
8. Empuje la segunda sección del casquillo posterior del cable de conexión a tierra hacia el cable.
9. Aplique el blindaje del cable solamente al extremo del IND256x al empujar la camisa sobre los cables y el blindaje del cable y plegándolo sobre el blindaje del cable.
10. Empuje la sección frontal del casquillo del cable y atorníllela en la sección posterior.

2.7.3. Bucle de corriente pasiva

Si el terminal IND256x está conectado con otro sistema de pesaje IND256x como pantalla remota, la interfaz del bucle de corriente pasiva debe conectarse al bucle de corriente activa de otro

terminal IND256x. El bucle de corriente activa puede instalarse solamente en el conector COM3 de la tarjeta principal.

Tabla 2-6: Conexión del bucle de corriente pasiva entre terminales

IND256x COM3 (bucle de corriente pasiva J4) (pantalla remota)		IND256x COM3 (bucle de corriente activa J2) (Instrumento que conecta la plataforma de pesaje)	
1	↔	1	
2	↔	2	
3	↔	3	
4	↔	4	

2.7.4. Salida de 4-20 mA analógica intrínsecamente segura

La tarjeta opcional de comunicación de 4-20 mA analógica intrínsecamente segura se conecta al puerto COM2 en la tarjeta principal del IND256x. Proporciona una señal analógica intrínsecamente segura de 4-20 mA, proporcional al peso aplicado a la báscula o a la velocidad de cambio de peso en la báscula. La longitud máxima del cable para la conexión de salida analógica es 300 m (980 pies). El cable usado para la señal de salida analógica debe estar blindado.

■ Esta opción no puede usarse con la opción WiFi.



Figura 2-12: Tarjeta opcional de salida analógica intrínsecamente segura

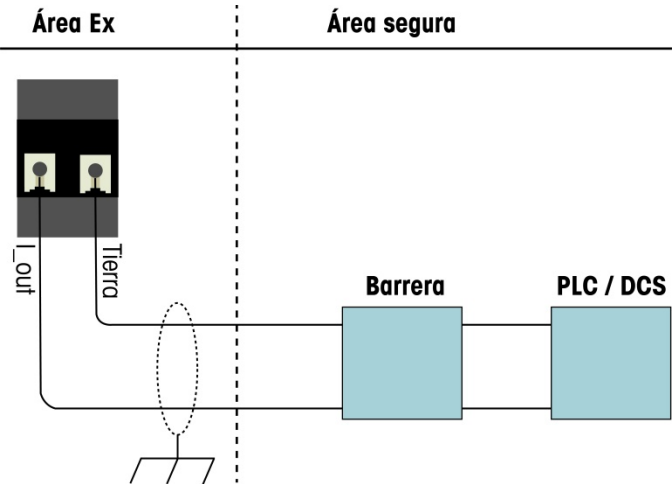


Figura 2-13: Cableado de salida analógica

La barrera aislada analógica KFD2-STC4-EX1 producida por P&F (números de certificado: IECEx BAS 04.0016X; BAS 99 ATEX 7060X) ha sido verificada y puede conectarse directamente con la opción de 4-20 mA analógica intrínsecamente segura del IND256x, y después conectarse a un sistema PLC o DCS en el área segura.

2.7.5. Comunicación inalámbrica

La tarjeta opcional de comunicación inalámbrica del IND256x se instala en la tarjeta principal con otras tarjetas opcionales, y no está conectada con periféricos. La opción debe configurarse como se describe en el Capítulo 3, sección 3.8.4. Se requiere una señal WiFi fuerte para lograr comunicación inalámbrica con periféricos.

El IND256x es compatible con una sola opción WiFi.

- Esta opción no puede usarse junto con la opción de salida de 4-20 mA analógica intrínsecamente segura.



Figura 2-14: Tarjeta opcional WiFi del IND256x y antena

2.8. Sellado de la caja

Cuando el terminal IND256x se usa en una aplicación "aprobada" por metrología, debe estar protegido contra alteraciones mediante el uso de sellos. Las versiones IND256x incluyen kit de sello opcional.

El método usado para sellado varía dependiendo de los requisitos de su localidad. El IND256x puede sellarse externamente.

2.8.1. Sellado externo de la caja, Estados Unidos

1. Determine que se seleccionó el área correcta en **Básculas > Tipo > Aprobación** y establezca el interruptor de metrología SW1-1 en ENCENDIDO (consulte el Capítulo 2, **Operación**, para conocer la ubicación y la función de este interruptor).

2. Pase el alambre de sellado a través de dos pernos de sellado adyacentes y luego fije el retenedor del sello como se muestra en la Figura 2-15.
3. Corte el exceso de alambre de sellado.

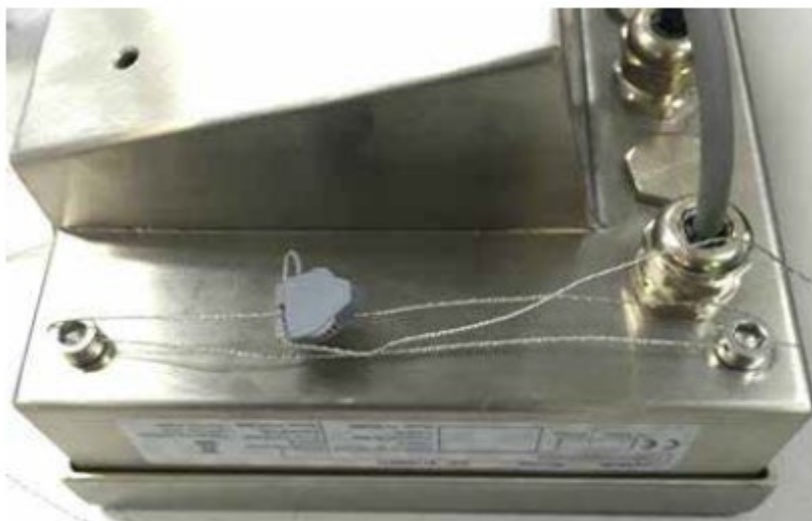


Figura 2-15: Método de sellado

2.9. Parámetro de interfaz

2.9.1. Circuito de alimentación (puerto de alimentación de energía)

Circuito de alimentación	Parámetros
Variante con alimentación de CA no intrínsecamente segura (la clave de tipo termina con "46" o "44") (solo aprobadas por ATEX e IECEx) Cable conectado permanentemente con ferrita	Voltaje nominal: CA 187...250 V (50/60 Hz) Corriente nominal: 125 mA Voltaje de entrada máximo: Um CA 250 V
Variable con alimentación de CD no intrínsecamente segura (la clave de tipo termina con "56" o "54") (solo aprobadas por ATEX e IECEx) Cable conectado permanentemente con ferrita: Azul: +24 V, marrón: tierra, verde-amarillo: PE	Voltaje nominal: CD 18...30 V Corriente nominal: 250 mA Voltaje de entrada máximo en aparatos asociados: Um CA 250 V (Nota: el voltaje nominal: es más bajo)
Variantes con alimentación de CD (batería) intrínsecamente segura (la clave de tipo termina con "25" o "27") Terminales de conexión: V+, TIERRA, BATERÍA, DATOS	Voltaje de entrada nominal: CD 10 V Corriente de entrada nominal: 350 mA
	Voltaje de entrada máximo: Ui CD 12.8 V Corriente de entrada máxima: Ii 3.03 A Energía de entrada máxima: Pi 6.83 W

Circuito de alimentación	Parámetros
	Inductancia interna efectiva: Li insignificante Capacitancia interna efectiva: Ci insignificante

2.9.2. Interfaz RS232 intrínsecamente segura

Interfaz RS232 intrínsecamente segura	Parámetros
Terminales J1.1 (TXD), J1.2 (RXD) – J1.3 (TIERRA)	Voltaje de entrada máximo: Ui CD ± 10 V
	Capacitancia interna efectiva: Ci insignificante
	Inductancia interna efectiva: Li insignificante
	Voltaje de salida máximo: Uo CD
	J1.1-TIERRA resp. J1.2-TIERRA cada uno: ± 5.36 V
	Corriente de salida máxima: Io
	J1.1-TIERRA resp. J1.2-TIERRA cada uno: ± 12.9 mA
	Energía de salida máxima: Po
	J1.1-TIERRA resp. J1.2-TIERRA cada uno: 17.2 mW
	Capacitancia externa máxima: Co 100 nF
	Inductancia externa máxima: Lo 100 μ H

2.9.3. Salida intrínsecamente segura para conexión con una celda de carga

Salida intrínsecamente segura para conexión con una celda de carga	Parámetros
Terminales J5.1 (EXC+), J5.2 (SEN+), J5.3 (SIG+), J5.5 (SIG-), J5.6 (SEN-), J5.7 (EXC-)	Voltaje de salida máximo: Uo CD 5.88 V
	Corriente de salida máxima: Io 171 mA
	Energía de salida máxima: Po 940 mW
	Capacitancia externa máxima: Co 6.8 μ F
	Inductancia externa máxima: Lo 0.3 mH

2.9.4. Interfaces de tarjeta de comunicación opcional

Interfaces de las tarjetas de comunicación opcionales	Parámetros
Interfaz de 4-20 mA intrínsecamente segura Solo para variantes con tarjeta opcional de salida analógica (clave tipo "A") Terminales J2.1 (I_OUT) – J2.2 (TIERRA)	Voltaje de entrada máximo: Ui CD 3.5 V
	Corriente de entrada máxima: Ii 115 mA
	Capacitancia interna máxima: Ci 110 nF
	Inductancia interna máxima: Lo=0
	Voltaje de salida máximo: Uo CD 13.65 V
	Corriente de salida máxima: Io 115 mA
	Energía de salida máxima: Po 0.4 W
	Capacitancia externa máxima: Co 680 nF
	Inductancia externa máxima: Lo 400 μ H

Interfaces de las tarjetas de comunicación opcionales	Parámetros
WiFi-antena-conexión Solo para variantes con tarjeta opcional WiFi (clave tipo "W") Conector IPEX para conexión con tipo de antena externa AC-Q24-50ZD	Energía de RF máxima: < 1.3 W Frecuencia: 2400..2483 MHz
Interfaz de bucle de corriente activa intrínsecamente segura Solo para variantes con tarjeta opcional de bucle de corriente activa (clave tipo "E") Bloque de terminal J2, terminales J2.1...J2.4 (CL activa)	Voltaje de salida máximo: Uo CD 5.36 V Corriente de salida máxima: Io 131 mA Energía de salida máxima: Po 176 mW
	Capacitancia externa máxima: Co 600 nF Inductancia externa máxima: Lo 400 µH
Interfaz de bucle de corriente pasiva intrínsecamente segura Solo para variantes con tarjeta opcional de bucle de corriente pasiva (clave tipo "P") Bloque de terminal J4, terminales J4.1...J4.4 (CL pasiva)	Voltaje de entrada máximo: Ui CD 10 V Corriente de entrada máxima: Ii 300 mA Energía de entrada máxima: Pi 500 mW
	Capacitancia interna efectiva: Ci 110 nF Inductancia interna efectiva: Li insignificante

2.9.5. Rango de temperatura ambiente

Parámetros
Rango de temperatura ambiente: Ta -10 °C...+40 °C

IND256x Wägeterminal



METTLER TOLEDO

IND256x Wägeterminal

METTLER TOLEDO Service

Wichtige Services zur Gewährleistung einer zuverlässigen Performance

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl der Qualität und Präzision von METTLER TOLEDO. Der ordnungsgemäße Gebrauch Ihres neuen Geräts gemäss dieses Handbuchs sowie die regelmäßige Kalibrierung und Wartung durch unser im Werk geschultes Serviceteam gewährleisten den zuverlässigen und genauen Betrieb und schützen somit Ihre Investition. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie an einem Service-Vertrag interessiert sind, der genau auf Ihre Anforderungen und Ihr Budget zugeschnitten ist. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mt.com/service.

Zur Optimierung des Nutzens, den Sie aus Ihrer Investition ziehen, sind mehrere wichtige Schritte erforderlich:

1. **Registrierung des Produkts:** Wir laden Sie dazu ein, Ihr Produkt unter www.mt.com/productregistration zu registrieren, damit wir Sie über Verbesserungen, Updates und wichtige Mitteilungen bezüglich Ihres Produkts informieren können.
2. **Kontaktaufnahme mit METTLER TOLEDO zwecks Service:** Der Wert einer Messung steht im direkten Verhältnis zu ihrer Genauigkeit – eine nicht den Spezifikationen entsprechende Waage kann zu Qualitätsminderungen, geringeren Gewinnen und einem höheren Haftbarkeitsrisiko führen. Fristgerechte Serviceleistungen von METTLER TOLEDO stellen die Genauigkeit sicher, reduzieren Ausfallzeiten und verlängern die Gerätelebensdauer.
 - a. **Installation, Konfiguration, Integration und Schulung:** Unsere Servicevertreter sind vom Werk geschulte Experten für Wägeausrüstungen. Wir stellen sicher, dass Ihre Wägegeräte auf kostengünstige und termingerechte Weise für den Einsatz in der Produktionsumgebung bereit gemacht werden und dass das Bedienungspersonal so geschult wird, dass ein Erfolg gewährleistet ist.
 - b. **Erstkalibrierungsdokumentation:** Die Installationsumgebung und Anwendungsanforderungen sind für jede Industriewaage anders; deshalb muss die Leistung geprüft und zertifiziert werden. Unsere Kalibrierungsservices und Zertifikate dokumentieren die Genauigkeit, um die Qualität der Produktion sicherzustellen und für erstklassige Aufzeichnungen der Leistung zu sorgen.
 - c. **Periodische Kalibrierungswartung:** Ein Kalibrierungsservicevertrag bildet die Grundlage für Ihr Vertrauen in Ihr Wägeverfahren und stellt gleichzeitig eine Dokumentation der Einhaltung von Anforderungen bereit. Wir bieten eine Vielzahl von Serviceprogrammen an, die auf Ihre Bedürfnisse und Ihr Budget maßgeschneidert werden können.
 - d. **GWP®-Verifizierung:** Ein risikobasierter Ansatz zur Verwaltung von Wägegeräten ermöglicht die Steuerung und Verbesserung des gesamten Messprozesses, um eine reproduzierbare Produktqualität zu gewährleisten und Prozesskosten zu minimieren. GWP (Gute Wägepraxis) ist der wissenschaftliche Standard für das effiziente Lebenszyklusmanagement von Wägegeräten und liefert eindeutige Antworten zur Spezifizierung, Kalibrierung und Genauigkeit der Wägegeräte unabhängig vom Hersteller oder von der Marke.

© METTLER TOLEDO 2019

Dieses Handbuch darf ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von METTLER TOLEDO weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form oder durch irgendwelche Mittel, seien es elektronische oder mechanische Methoden, einschließlich Fotokopieren und Aufzeichnen, für irgendwelche Zwecke reproduziert oder übertragen werden.

Durch die US-Regierung eingeschränkte Rechte: Diese Dokumentation wird mit eingeschränkten Rechten bereitgestellt.

Copyright 2019 METTLER TOLEDO. Diese Dokumentation enthält eigentumsrechtlich geschützte Informationen von METTLER TOLEDO. Sie darf ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von METTLER TOLEDO nicht ganz oder teilweise kopiert werden.

METTLER TOLEDO behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Verbesserungen oder Änderungen am Produkt oder Handbuch vorzunehmen.

COPYRIGHT

METTLER TOLEDO® ist eine eingetragene Marke von Mettler-Toledo, LLC. Alle anderen Marken- oder Produktbezeichnungen sind Marken bzw. eingetragene Marken ihrer jeweiligen Firmen.

**METTLER TOLEDO BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, VERBESSERUNGEN ODER ÄNDERUNGEN
OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG VORZUNEHMEN.**

FCC-Mitteilung

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften und den Funkstöranforderungen des kanadischen Kommunikationsministeriums. Sein Betrieb unterliegt folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Funkstörungen verursachen und (2) das Gerät muss in der Lage sein, alle empfangenen Funkstörungen zu tolerieren, einschließlich solcher Störungen, die u. U. den Betrieb negativ beeinflussen.

Dieses Gerät wurde geprüft und liegt gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften innerhalb der Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse A. Diese Grenzwerte gewährleisten den Schutz vor Funkstörungen, wenn das Gerät in einer gewerblichen Umgebung betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Die unsachgemäße Installation und Verwendung kann zu Störungen des Funkverkehrs führen. Das Betreiben dieses Geräts in einem Wohngebiet führt wahr scheinlich zu Funkstörungen, wobei der Benutzer auf eigene Kosten entsprechende Maßnahmen zur Behebung der Störung ergreifen muss.



Die Konformitätserklärung finden Sie unter

<http://glo.mt.com/global/en/home/search/compliance.html/compliance/>.

Vorsichtsmassnahmen

- LESEN Sie dieses Handbuch, BEVOR Sie dieses Gerät bedienen oder warten und BEFOLGEN Sie alle Anweisungen.
- BEWAHREN Sie dieses Handbuch für zukünftige Nachschlagezwecke auf.

	 WARNUNG
	DIESES GERÄT DARF NICHT INSTALLIERT ODER GEWARTET WERDEN, BEVOR DER BEREICH, IN DEM SICH DAS IND245x BEFINDET, VON DER VERANTWORTLICHEN PERSON VOR ORT FÜR AUTORISIERTE MITARBEITERN GESICHERT WURDE.
	 VORSICHT
	BESTÄTIGEN SIE DIE EINHALTUNG DER GELTENDEN NATIONALEN UND LOKALEN WIFI-BESTIMMUNGEN, BEVOR SIE DAS MIT DEM WIFI-MODUL KONFIGURIERTE IND256x-TERMINAL INSTALLIEREN UND IN BETRIEB NEHMEN. METTLER TOLEDO ÜBERNIMMT IN LÄNDERN, IN DENEN WIFI-BESTIMMUNGEN NICHT ERFÜLLT WERDEN, KEINE VERANTWORTUNG FÜR TERMINALINSTALLATIONEN.
	 WARNUNG
	WENN DIE TASTATUR, DIE ANZEIGELINSE ODER DAS GEHÄUSE DES IND245x BESCHÄDIGT IST, MUSS DAS BESCHÄDIGTE TEIL SOFORT AUSGETAUSCHT WERDEN. TRENNEN SIE SOFORT DIE STROMVERSORUNG UND SCHLIESSEN SIE DIESE ERST WIEDER AN, WENN DIE TASTATUR, DIE ANZEIGELINSE ODER DAS GEHÄUSE VON QUALIFIZIERTEM WARTUNGSPERSONAL AUSGETAUSCHT WURDE. DIE NICHTBEACHTUNG DIESER ANWEISUNG KANN VERLETZUNGEN UND/ODER SACHBESCHÄDIGUNGEN ZUR FOLGE HABEN.
	 WARNUNG
	ERMEIDEN SIE STATISCHE AUFLADUNGEN BEI BETRIEB UND WARTUNG.
	 WARNUNG
	BEDIENUNG IST NUR ZULÄSSIG, WENN FUNKTIONS- UND PROZESSVERWANDTE ELEKTROSTATISCHE CHARGEN ELIMINIERT WERDEN.
	 WARNUNG
	BENUTZEN SIE DAS WÄGETERMINAL NUR, WENN ELEKTROSTATISCHE PROZESSE, DIE ZUR AUSBREITUNG VON BÜSCHELENTLADUNGEN FÜHREN, AUSGESCHLOSSEN SIND.
	 WARNUNG
	HALTEN SIE DAS TERMINAL FERN VON PROZESSEN, DIE EIN HOHES LADEPOTENZIAL ERZEUGEN, BEISPIELSGEWEISE ELEKTROSTATISCHE BESCHICHTUNG, SCHNELLE ÜBERTRAGUNG NICHT LEITENDER MATERIALIEN, STARKE LUFTSTRÖME UND HOCHDRUCK-AEROSOLEN.
	 WARNUNG
	VERWENDEN SIE ZUR REINIGUNG DES WÄGETERMINALS KEINEN TROCKENEN LAPPEN. WISCHEN SIE DAS TERMINAL IMMER VORSICHTIG MIT EINEM FEUCHTEN LAPPEN AB.

	 WARNUNG TRAGEN SIE GEEIGNETE SCHUTZKLEIDUNG. VERMEIDEN SIE NYLON, POLYESTER ODER ANDERE SYNTHETISCHE MATERIALIEN, DIE EINE LADUNG ERZEUGEN ODER SPEICHERN. VERWENDEN SIE LEITFÄHIGES SCHUHWERK UND EINEN LEITFÄHIGEN BODENBELAG.
	 WARNUNG VERMEIDEN SIE KUNSTSTOFFABDECKUNGEN ÜBER DEM TERMINAL.
	 WARNUNG ACHTEN SIE DARAUF, FÜR DAS TERMINAL, DIE BEFESTIGUNGEN UND DIE WAAGENBASIS EINE ERDUNG MIT POTENZIALAUSGLEICH ZU VERWENDEN.
	 WARNUNG FÜR DIE DC-VERSION DES TERMINALS IND256x LIEGT KEINE GALVANISCHE TRENNUNG ZWISCHEN DEM NICHT-EIGENSICHEREN VERSORGENSSTROMKREIS UND DEN EIGENSICHEREN AUSGANGSSTROMKREISEN VOR. DER NICHT-EIGENSICHERER STROMKREIS MUSS SICHER MIT DER ERDE VERBUNDEN SEIN. AN DEN EIGENSICHEREN STROMKREISEN MUSS EIN POTENTIALAUSGLEICH BESTEHEN. ALTERNATIV MUSS DER NICHT-EIGENSICHERE VERSORGENSSTROMKREIS (SELV) SICHER VON DER ERDE GETRENNT SEIN.
	 WARNUNG DIE EXTERNE, VOM KUNDEN BEREITGESTELLTE DC-STROMVERSORGUNG MUSS ÜBER DIE ÜBERSpannungskategorie II GEMÄSS IEC 60664-1 VERFÜGEN.
	 WARNUNG DAS TERMINAL MUSS VOR UV-LICHT GESCHÜTZT WERDEN.
	 WARNUNG ES MUSS EINE AUSREICHENDE ZUGENTLASTUNG SICHERGESTELLT WERDEN, UM ZUGKRÄFTE AUF DEN KABELVERSCHRAUBUNGEN ZU VERMEIDEN.
	 WARNUNG DIE KABELVERSCHRAUBUNGEN MÜSSEN VOR STOSSSCHÄDEN GESCHÜTZT WERDEN.
	 WARNUNG DAS TERMINAL MIT EINER WLAN-ANTENNE IST SO ZU INSTALLIEREN, DASS DAS RISIKO EINER MECHANISCHEN BESCHÄDIGUNG GERING IST. EINE BESCHÄDIGTE WLAN-ANTENNE SOFORT ERSETZEN!

	 WARNUNG VOM WERK AUS MIT WIFI KONFIGURIERTE IND256X-TERMINALS SIND FÜR DIE VERWENDUNG IN NACH GERÄTEGRUPPE IIB KLASSIFIZIERTEN BEREICHEN DER ZONE 1 ZUGELASSEN. VOM WERK AUS MIT WIFI KONFIGURIERTE IND256X-TERMINALS DÜRFEN NICHT IN NACH GERÄTEGRUPPE IIC KLASSIFIZIERTEN BEREICHEN VERWENDET WERDEN. DIE VERWENDUNG DES VOM WERK AUS MIT WIFI KONFIGURIERTEN IND256X-TERMINALS IN EINEM KLASSIFIZIERTEN BEREICH, FÜR DEN KEINE GENEHMIGUNG VORLIEGT, KANN ZU VERLETZUNGEN UND/ODER SACHBESCHÄDIGUNG FÜHREN.
	 WARNUNG DIE EXTERNE GLEICHSTROMVERSORGUNG DES KUNDEN DARF EINE MAXIMALE ÜBERSPANNUNG DER KATEGORIE II ENTSPRECHEND IEC 60664-1 HABEN.
	 WARNUNG DAS TERMINAL NICHT ÖFFNEN, WENN DIE ATMOSPHERE AUFGRUND VON STAUB EXPLOSIONSGEFÄHRDET IST. DAS IND256X VOR DEM ÖFFNEN DES GEHÄUSES VON DER STROMVERSORGUNG TRENNEN, UM DAS ENTZÜNDEN VON GEFÄHRDETEN ATMOSPHEREN ZU VERHINDERN. DIE ABDECKUNG BEI STROMFÜHRENDEM STROMKREIS FEST GESCHLOSSEN HALTEN. BEI EINER EXPLOSIONSGEFÄHRDETEN STAUBATMOSPHERE NICHT ÖFFNEN.
	 WARNUNG ALLE GERÄTE MÜSSEN GEMÄSS DER DOKUMENTENZEICHNUNG NUMMER 30282892B UND GELTENDER LOKALER VORSCHRIFTEN INSTALLIERT WERDEN.
	 WARNUNG ES DÜRFEN NUR DIE IN DER INSTALLATIONSANLEITUNG DER DOKUMENTATIONS-CD-ROM 30512916 ANGEgebenEN BAUTEILE FÜR DIESES GERÄT EINGESETZT WERDEN. ALLE GERÄTE MÜSSEN IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN INSTALLATIONSANLEITUNGEN INSTALLIERT WERDEN. DIE VERWENDUNG FALSCHER ODER ANDERER BAUTEILE UND/ODER ABWEICHUNGEN VON DIESEN ANLEITUNGEN KÖNNEN DIE EIGENSICHERHEIT DES TERMINALS HERABSETZEN UND PERSONEN- UND/ODER SACHSCHÄDEN ZUR FOLGE HABEN.
	 WARNUNG FÜR EINEN KONTINUIERLICHEN SCHUTZ GEGEN STROMSCHLAG NUR AN EINE ORDNUNGSGEMÄSS GEERDETE STECKDOSE ANSCHLIESSEN. DEN ERDUNGSSTIFT NICHT ENTFERNEN.
	 WARNUNG WENN DIESES GERÄT ALS KOMPONENTE IN EINEM SYSTEM INTEGRIERT IST, MUSS DIE DARAUS ENTSTEHENDE KONSTRUKTION VON QUALIFIZIERTEM PERSONAL ÜBERPRÜFT WERDEN, DAS MIT DEM BAU UND BETRIEB ALLER KOMPONENTEN IM SYSTEM UND DEN POTENZIELLEN GEFAHREN VERTRAUT IST. DIE NICHTBEACHTUNG DIESER VORSICHTSMASSNAHME KANN VERLETZUNGEN UND/ODER SACHBESCHÄDIGUNGEN ZUR FOLGE HABEN.
	 WARNUNG DIE WARTUNG DES IND245x DARF NUR DURCH QUALIFIZIERTES PERSONAL ERFOLGEN. GEHEN SIE BEI KONTROLLEN, TESTS UND JUSTIERUNGEN BEI ANGESCHALTETEM STROM VORSICHTIG VOR. DIE NICHTBEACHTUNG DIESER VORSICHTSMASSNAHMEN KANN VERLETZUNGEN UND/ODER SACHBESCHÄDIGUNGEN ZUR FOLGE HABEN.

	 WARNUNG VOR DEM ANSCHLIESSEN/TRENNEN INTERNER ELEKTRONISCHER BAUTEILE ODER VERBINDUNGSKABEL ZWISCHEN ELEKTRONISCHEN GERÄTEN MUSS STETS DIE STROMZUFUHR UNTERBROCHEN UND MINDESTENS DREISSIG (30) SEKUNDEN GEWARTET WERDEN, BEVOR ANSCHLÜSSE ODER ABTRENNUNGEN Vorgenommen werden. DIE NICHTBEACHTUNG DIESER VORSICHTSMASSNAHMEN KANN DIE ZERSTÖRUNG DES GERÄTS ZUR FOLGE HABEN.
	HINWEIS BEACHTEN SIE DIE ENTSPRECHENDEN VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM UMGANG MIT GERÄTEN, DIE EMPFINDLICH AUF ELEKTROSTATIK REAGIEREN.

Anforderungen der sicheren Entsorgung



In Übereinstimmung mit der europäischen Richtlinie 2002/96/EC zu Elektrik- und Elektronikabfällen (WEEE) darf dieses Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden. Dies gilt auch je nach spezifischen Anforderungen für Länder außerhalb der EU.

Entsorgen Sie dieses Produkt bitte gemäß den örtlichen Vorschriften an der Sammelstelle, die für elektrische und elektronische Geräte vorgegeben ist.

Falls Sie irgendwelche Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die zuständige Behörde oder den Händler, von dem Sie dieses Gerät erworben haben.

Sollte dieses Gerät an andere Parteien weitergegeben werden (für den privaten oder kommerziellen Gebrauch), muss der Inhalt dieser Vorschrift ebenfalls weitergeleitet werden.

Vielen Dank für Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	1-1
1.1.	Übersicht über das IND256x	1-1
1.2.	Technische Daten des Produkts	1-2
1.3.	Prüfnormen	1-4
1.4.	Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen	1-6
1.5.	Lieferumfang und Prüfung der Teile	1-6
1.6.	Konfiguration.....	1-7
1.7.	Potentialausgleich (PA)	1-9
1.8.	Betriebsumgebung	1-9
1.9.	Abmessungen	1-10
1.10.	Hauptplatine.....	1-12
1.11.	Kommunikationsoptionsplatinen	1-12
2	Installation.....	2-1
2.1.	Öffnen des Gehäuses.....	2-1
2.2.	Installation von Kabeln und Anschlüssen	2-2
2.3.	Potentialausgleich und Erdung	2-6
2.4.	Potentialausgleich (PA)	2-6
2.5.	Schließen des Gehäuses	2-7
2.6.	Anschluss für analoge Wägezelle.....	2-7
2.7.	Anschluss der Kommunikationsplatinen.....	2-8
2.8.	Plombieren des Gehäuses.....	2-12
2.9.	Schnittstellenparameter	2-13

1 Einleitung

1.1. Übersicht über das IND256x

Das IND256x steht für die neueste Wägetechnologie von METTLER TOLEDO. Das IND256x besitzt eine externe Zulassung zum Wägen in Gefahrenbereichen und kann direkt in Bereichen der Zone 1/Zone 21 verwendet werden.

Das IND256x ist ein leistungsstarkes Wägeterminal für einen oder mehrere Bereiche, das mit analogen Wägezellen kostengünstig zuverlässige Wägeergebnisse von Gramm bis Tonne liefert. Das Terminal lässt sich problemlos in ein vorhandenes Wägesystem integrieren.

In Verbindung mit einer entsprechenden Sicherheitsbarriere oder Trennbarriere bietet das IND256x verschiedene eigensichere Kommunikationsschnittstellen für die Kommunikation mit PCs und Druckern im sicheren Bereich. Dank dieser Eigenschaft kann das IND256x für die meisten Wägeanwendungen in vielen Industriebereichen eingesetzt werden, beispielsweise:

- Pharmazie
- Petrochemikalien
- Feinchemikalien
- Pulververarbeitung
- Landwirtschaft
- Spezielle Chemikalien
- Farben und Lacke

1.1.1. Versionen des Terminals IND256x

Das IND256x gibt es mit drei verschiedenen Optionen für die Stromversorgung:

- Netzstromversorgung mit externer Wechselspannung 187 –250 V, 50/60 Hz)
- Gleichstromversorgung mit externer Gleichspannung 18 –30 VDC)
- Eigensichere Stromversorgung mit einem externen NiMH-Akku 64060627)

Jede dieser Versionen ist nach ATEX und IECEx für die Verwendung in Bereichen der Zone 1 und Zone 21 zugelassen.

1.1.2. Produkteigenschaften des IND256x

- Einfache Wägevorgänge in Gefahrenbereichen mit Nullstellungs-, Tara- und Druckfunktion
- Gehäuse für raue Umgebungen für die Tisch-, Säulen- oder Wandmontage
- Verbindung mit einer einzelnen analogen Wägeplattform
- LCD-Anzeige mit 240 x 96 Pixel und weißer Hinterleuchtung, 25 mm große Ziffern
- Echtzeituhr stromausfallsicher)

- Eigensicherer serieller Port COM1) für die asynchrone bidirektionale Kommunikation und Druckausgabe
- Unterstützung der folgenden internen Optionsplatinen:
 - Eigensicherer 4-20 mA Analogausgang
 - WLAN-Kommunikationsmodul mit Antenne nur in IND256x -Terminals, die werkseitig mit WiFi-Modul konfiguriert wurden)
 - Aktive Stromschleife – zum Anschluss an ein ACM200-Kommunikationsmodul im sicheren Bereich oder zum Anschluss an ein zweites Terminal IND256x, das mit passiver Stromschleife konfiguriert ist.
 - Passive Stromschleife Verwendung als zweite Anzeige zum Anschluss eines weiteren Terminals mit einer aktiven Stromschleife)
- Unterstützt drei benutzerdefinierte ID-Eingänge
- Die Zielwerttabelle unterstützt 25 voreingestellte Zielwerte für das Prüfwägen
- Die Taratabelle unterstützt 20 voreingestellte Tarawerte
- Unterstützt g, kg, t, lb und oz
- Speichert 60.000 Transaktionsdatenelemente
- Unterstützt kumuliertes Wägen und Gesamtsumme
- Benutzerdefinierte Anpassung der fünf verschiedenen Druckvorlagen
- Unterstützt gewichtsfreie Kalibrierung CalFREE™)

1.2. Technische Daten des Produkts

Tabelle 1-1 enthält die technischen Daten des IND256x.

Tabelle 1-1: Technische Daten des IND256x

Element	Spezifikation
Gehäuse	Edelstahl 304, Wand- oder Säulenmontage
Abmessungen H × B × T)	173 mm × 230 mm × 127 mm 6,8 in. × 9,1 in. × 5,0 in.)
Transportgewicht	3,5 kg 8 lb)
Schutzart	IP66
Lagerungsumgebung	Lagerungstemperaturbereich: –20 °C bis 60 °C –4 °F bis 140 °F) Relative Luftfeuchtigkeit: 10 %–95 %, nicht kondensierend
Betriebsumgebung	Betriebstemperaturbereich: –10 °C bis 40 °C 14 °F bis 104 °F) Relative Luftfeuchtigkeit: 10 %–95 %, nicht kondensierend
Gefahrenbereich	Das IND256x ist für die Verwendung im Gefahrenbereich Zone 1/Zone 21 zugelassen.

Element	Spezifikation
Stromversorgung	Netzstromversorgung 187 –253 V, 50/60 Hz)
	Gleichstromversorgung 18 –30 VDC)
	Externer NiMHEx-Akku 64060627)
Anzeige	LCD-Anzeige mit 240 x 96 Pixel und weißer Hinterleuchtung, 25 mm große Ziffern Aktualisierungsrate der Anzeige: 10 Hz
Gewichtsanzeige	Maximal 100.000 Teilstriche
Art der Wägeplattform	Analoge Wägezelle
Anzahl der Sensoren	Maximal vier 350 Ω -Wägezellen mindestens 87 Ω), 2 mV/V oder 3 mV/V
Anzahl der Wägeplattformen	Unterstützt eine Wägeplattform
Aktualisierungsrate	>366 Hz
Erregungsspannung des Sensors	4,5 VDC
Mindestempfindlichkeit	0,6 μ V/e
Tastatur	26 Tasten; 1,5 mm dicke Folientastatur
Kommunikationsmodus	Standardschnittstelle: Die Hauptplatine enthält eine eigensichere RS232-Kommunikationsschnittstelle Schnittstellenoptionen: Eigensicherer 4-20 mA Analogausgangsmodule, mit 16-Bit-D / A-Wandlung und 25-Hz-Aktualisierungsrate zur SPS oder WLAN-Kommunikationsmodul nur in IND256x -Terminals, die werkseitig mit WLAN-Modul konfiguriert wurden) oder eigensichere aktive Stromschleife oder eigensichere passive Stromschleife Kommunikationsprotokolle: Serieller Eingang: ASCII-Befehle für CTPZ Löschen, Trieren, Drucken, Nullstellung), SICS unterstützt SICS -Stufe 0 und 1) Serieller Ausgang: Kontinuierlicher Datenausgang von Toledo, Befehlsdruckausgang 5 konfigurierbare Vorlagen), SICS -Befehl und Ausdruck des Berichts
Metrologische Zulassung	Europa: OIML R76; Klasse III, 6000e; TC10878 Global: OIML R76; Klasse III, 6000e; R76-2006-A-NL1-18.27
Ex-Zulassung, werkseitig konfigurierte WLAN-Version	mit nicht eigensicherer Stromversorgung Netzstromversorgung und Gleichstromversorgung): II 2G Ex eb ib [ib] mb IIB T4 Gb II 2D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db mit eigensicherer Akku: II 2G Ex ib IIB T4 Gb II 2D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db

Element	Spezifikation
Ex-Zulassung, Version ohne WiFi	mit nicht eigensicherer Stromversorgung (Netzstromversorgung und Gleichstromversorgung): II 2G Ex eb ib [ib] mb IIC T4 Gb II 2D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db mit eigensicherer Akku: II 2G Ex ib IIC T4 Gb II 2D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db

Tabelle 1-2: WLAN-Modulspezifikation nur für Terminals IND256x, die im Werk mit einem WLAN -Modul konfiguriert wurden)

Element	Spezifikation
Standard	802,11 b/g/n
Übertragungsleistung	14 dBm (Durchschnitt)
Funkfrequenzbereich	2,4 GHz – 2,497 GHz
Verschlüsselung	WEP, WPA
WEP	64 Bit, 128 Bit
WPA	WPA-TKIP, WPA2-AES
Protokoll	TCP/IP
Arbeitsmodus	Server, Client
Übertragungsabstand	Maximal 50 m im Freien
Zulassung	China: SRRC

1.3. Prüfnormen

Das Terminal IND256x wurde nach den folgenden Normen geprüft.

EN 60079-0:2012 + A11:2013	Allgemeine Anforderungen
EN 60079-7:2015	Erhöhte Sicherheit „e“
EN 60079-11:2012	Eigensicherheit „i“
EN 60079-18:2015	Vergusskapselung „m“
EN 60079-31:2014	Schutz durch Gehäuse „t“
IEC 60079-0:2017, Ausg. 7.0	Allgemeine Anforderungen
IEC 60079-7:2017, Ausg. 5.1	Erhöhte Sicherheit „e“
IEC 60079-11:2011, Ausg. 6.0	Eigensicherheit „i“
IEC 60079-18:2017, Ausg. 4.1	Vergusskapselung „m“
IEC 60079-31:2013, Ausg. 2.0	Schutz durch Gehäuse „t“
FM3600 2011)	Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen – Allgemeine Anforderungen

FM3610 2010)	Eigensichere Geräte und zugehörige Geräte zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen der Klassen I, II & III, Division 1
FM3810 2005)	Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung für Mess-, Steuer- und Laborzwecke
ANSI/IEC 60529	Schutzarten durch Gehäuse IP -Code)
CSA C22.2 Nr. 157-1992 / 2006	Eigensichere und nicht zündgefährliche Geräte zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen
CSA C22.2 Nr. 142-1990 / 2004	Prozesssteuerungsgeräte
CSA C22.2 Nr. 61010.1-2004	Sicherheitsanforderungen an elektrische Betriebsmittel zur Verwendung für Mess-, Steuer- und Laborzwecke – Teil 1: Allgemeine Anforderungen
CAN/CSA 22.2 Nr. 60529-2005	Schutzarten durch Gehäuse IP -Code)

1.3.1. Spezielle Verwendungsbedingungen

1. Das Gerät muss vor UV-Licht geschützt werden.
2. Elektrostatische Aufladungen während des Betriebs und der Wartung sind auszuschließen. Das Terminal darf nur in Bereichen installiert werden, in denen keine betriebs- und prozessbezogenen elektrostatischen Ladungen vorhanden sind.
3. Für Ausführungen mit nichteigensicherer Gleichstromversorgung Typenschlüssel endet mit „44“ oder „46“): Es gibt keine galvanische Trennung zwischen dem nichteigensicheren Versorgungsstromkreis und den eigensicheren Ausgangsstromkreisen:

Der nichteigensichere Versorgungsstromkreis muss sicher mit der Erde verbunden sein. In diesem Fall sind auch die eigensicheren Stromkreise geerdet. Entlang der eigensicheren Stromkreise muss ein Potentialausgleich vorhanden sein.

oder

Der nichteigensichere Stromkreis muss sicher von der Erde getrennt sein z. B. SELV - Stromkreis).
4. Bei Terminals in Gleichstromausführung darf der Versorgungskreis maximal die Überspannungskategorie II gemäß IEC 60664-1 aufweisen.
5. Die Kabeldurchführungen der Baureihen HSK-M-Ex... und V-Ms-Ex... nach KEMA 99 ATEX 6971X bzw. IECEx BVS 07.0014X werden mit einer reduzierten Zugkraft (25 %) gemäß Punkt A.3.1, IEC 60079-0 geprüft und dürfen nur für die Festinstallation von Geräten der Gruppe II verwendet werden. Der Anwender hat für eine ausreichende Befestigung des Kabels zu sorgen.
6. Die WLAN-Antenne ist auf geringes mechanisches Gefährdungspotential geprüft (Aufprallhöhe 0,4 m bei 1 kg Masse) und gegen hohe Aufprallenergie geschützt.

1.4. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das neue Terminal in Betrieb nehmen.

Trotz seiner robusten Konstruktion ist das Terminal IND256x ein Präzisionsgerät. Gehen Sie daher bei der Handhabung und Installation sorgfältig mit dem Terminal um.

	 VORSICHT
	DIESES GERÄT DARF ERST DANN INSTALLIERT BZW. GEWARTET UND REPARIERT WERDEN, WENN DER BEREICH VOM ZUSTÄNDIGEN PERSONAL AM KUNDENSTANDORT ALS NICHT GEFÄHRLICHER ORT FREIGEgeben IST.
	 VORSICHT
	ES DÜRFEN NUR DIE IN DIESEM HANDBUCH AUFGEFÜHRTE KOMPONENTEN IN DIESEM TERMINAL VERWENDET WERDEN. ALLE GERÄTE MÜSSEN ENTSPRECHEND DEN INSTALLATIONSANWEISUNGEN IN DIESEM HANDBUCH INSTALLIERT WERDEN. BEI VERWENDUNG VON FALSCHEN TEILEN ODER ERSATZKOMPONENTEN UND/ODER BEI ABWEICHUNG VON DIESEN ANWEISUNGEN KANN DIE EIGENSICHERHEIT DES TERMINALS BEEINTRÄCHTIGT WERDEN, SODASS VERLETZUNGEN ODER BESCHÄDIGUNGEN MÖGLICH SIND.
	 VORSICHT
	NICHT UNTER SPANNUNG ÖFFNEN.
	 VORSICHT
	POTENZIELLE GEFAHR DURCH ELEKTROSTATISCHE AUFLADUNG – SIEHE ANWEISUNGEN.
	 VORSICHT
	NICHT IN EINER EXPLOSIONSGEFÄHRDETEN ATMOSPHÄRE ÖFFNEN.
	 VORSICHT
	DAS TERMINAL MIT EINER WLAN-ANTENNE IST SO ZU INSTALLIEREN, DASS DAS RISIKO EINER MECHANISCHEN BESCHÄDIGUNG GERING IST. EINE BESCHÄDIGTE WLAN-ANTENNE SOFORT ERSETZEN!

1.5. Lieferumfang und Prüfung der Teile

Prüfen Sie bei Erhalt des IND256x, ob die Verpackung unversehrt ist. Falls die Verpackung beschädigt ist, prüfen Sie, ob das IND256x ebenfalls beschädigt ist, und reichen Sie ggf. einen Schadensersatzanspruch beim Transportunternehmen ein. Wenn die Verpackung unversehrt ist, packen Sie das IND256x vorsichtig aus der Originalverpackung aus und prüfen Sie, dass nichts beschädigt ist.

- Für den sicheren Transport sollte das Gerät am besten ordnungsgemäß in der Originalverpackung verpackt werden.

In der Verpackung ist Folgendes enthalten:

Wägeterminal IND256x Dokumentations-CD mit Handbuch und Inspektionsurkunde)
Beutel mit Zubehör für die Installation

1.6. Konfiguration

1.6.1. Systemkonfiguration

Abbildung 1-1 zeigt die Konfigurationsoptionen für das Terminal.

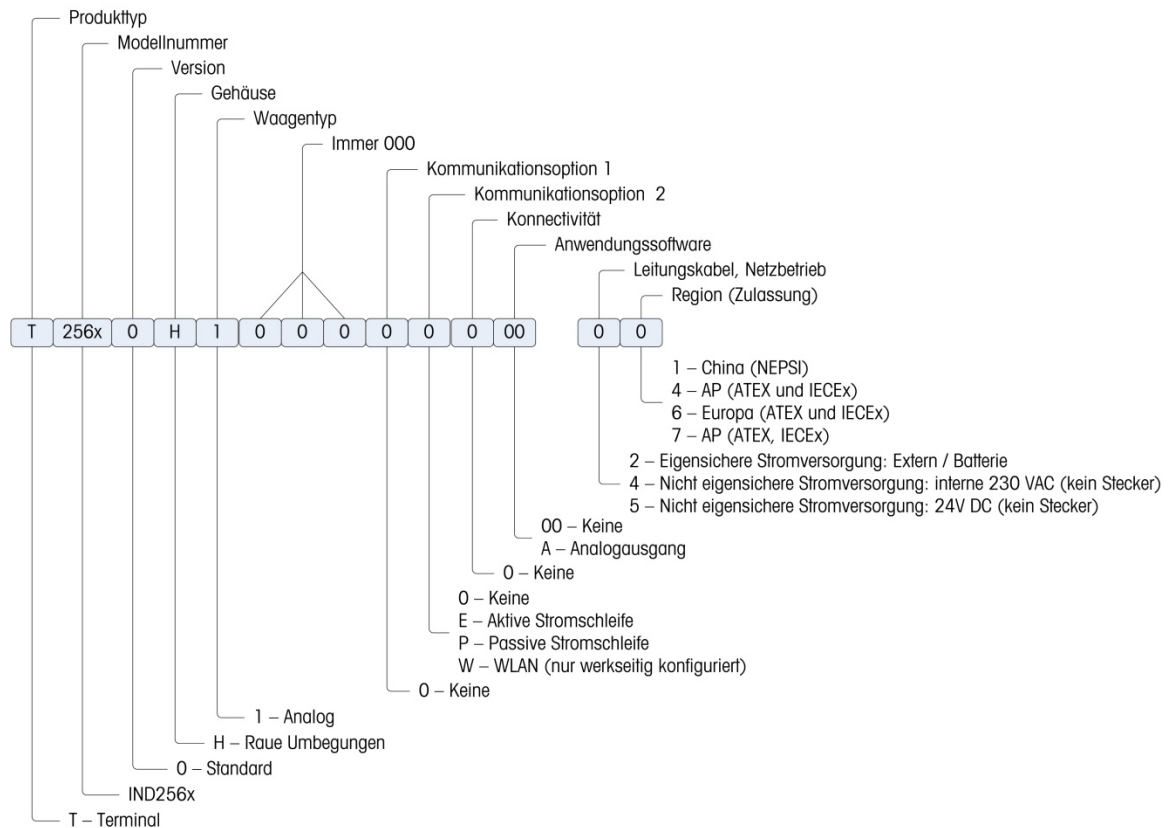


Abbildung 1-1: Konfigurationsübersicht des IND256x

	 ACHTUNG
	VOM WERK AUS MIT WIFI KONFIGURIERTE IND256X-TERMINALS SIND FÜR DIE VERWENDUNG IN NACH GERÄTEGRUPPE IIB KLASSIFIZIERTEN BEREICHEN DER ZONE 1 ZUGELASSEN. VOM WERK AUS MIT WIFI KONFIGURIERTE IND256X-TERMINALS DÜRFEN NICHT IN NACH GERÄTEGRUPPE IIC KLASSIFIZIERTEN BEREICHEN VERWENDET WERDEN. DIE VERWENDUNG DES VOM WERK AUS MIT WIFI KONFIGURIERTEN IND256X-TERMINALS IN EINEM KLASSIFIZIERTEN BEREICH, FÜR DEN KEINE GENEHMIGUNG VORLIEGT, KANN ZU VERLETZUNGEN UND/ODER SACHBESCHÄDIGUNG FÜHREN.

HINWEIS

DIE WLAN-FUNKTION IST NUR BEI TERMINALS IND256X VERFÜGBAR, DIE IM WERK ENTSPRECHEND KONFIGURIERT WURDEN.

1.6.2.

Produktdatencode

Das Herstellungsdatum bzw. der Datumscode für das Terminal befindet sich auf dem Typenschild oben auf dem Gehäuse).

Die Seriennummer beginnt mit einem Buchstaben und einer Zahl zum Beispiel B212000371). Der Buchstabe steht für die ersten drei Stellen des Jahres entsprechend dem Datumscode in Tabelle 1-3 der Buchstabe „B“ in unserem Beispiel steht für „201x“); die Zahl ist die Jahreszahl des Geräts in unserem Beispiel die Nummer „2“). „B4“ steht demzufolge für 2014.

Tabelle 1-3: Aktuelle und zukünftige Datumscodeformate

Datumscode	Jahr	Datumscode	Jahr
A	200x	F	205x
B	201x	G	206x
C	202x	H	207x
D	203x	J	208x
E	204x	K	209x

1.6.3.

Anschlüsse

Die folgende Abbildung zeigt die Anschlusspositionen auf der Rückseite des Gehäuses für raue Umgebungen.

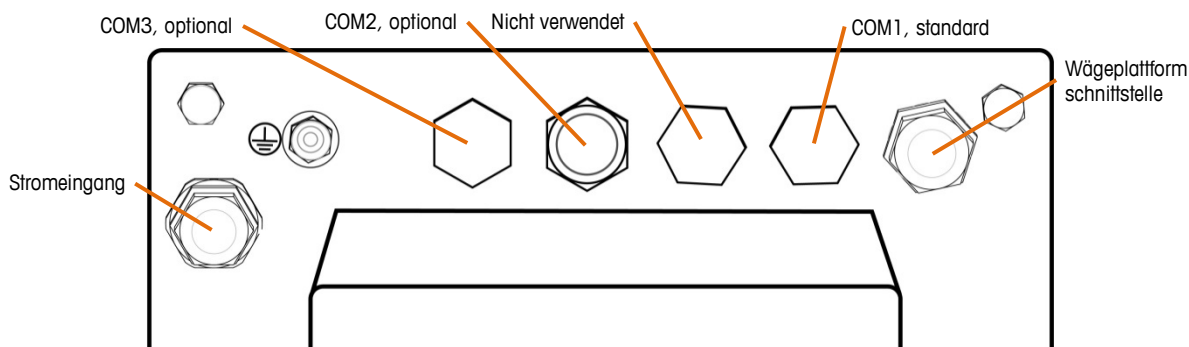


Abbildung 1-2: Anschlusspositionen des IND256x

Stromeingang	Netzspannung 220 V 187 –250 V, 50/60 Hz) ATEX - & IECEx-Version) oder Gleichspannung 24 V 18 V –30 V) ATEX - & IECEx-Version) oder externer Ex-Akku
COM1 Standard)	Eigensicherer RS232-Ausgang
COM2 optional)	Eigensicherer analoger 4–20 mA-Ausgang oder WLAN-

	Kommunikationsmodul nur werkseite konfiguriert)
COM3 optional)	Eigensichere aktive Stromschleife oder eigensichere passive Stromschleife
COM reserviert)	Nicht verwendet

1.6.4. Warnungen

1.6.4.1. CENELEC

PA-Anschluss entsprechend den landesspezifischen Vorschriften: Es muss sichergestellt werden, dass die Gehäuse über PA-Klemmen auf dem gleichen Potential liegen. Es darf kein Ausgleichsstrom über die Abschirmung der eigensicheren Kabel fließen.

1.6.4.2. cFMus

PA-Anschluss entsprechend ANSI/NFPA 70, Art. 504, und ANSI/IA RP 12.06.01 oder Canadian Electric Code C22.2: Es muss sichergestellt werden, dass die Gehäuse über PA-Klemmen auf dem gleichen Potential liegen. Es darf kein Ausgleichsstrom über die Abschirmung der eigensicheren Kabel fließen.

1.7. Potentialausgleich PA)

Der Potentialausgleich muss durch einen vom Betreiber autorisierten Elektriker installiert werden. Der METTLER TOLEDO-Service übernimmt hierbei nur eine Überwachungs- und Beratungsfunktion.

Der Potentialausgleich PA) aller Geräte Netzteil, Wägeterminal, Schnittstellenadapter und Wägeplattform) muss entsprechend dem Anschlussplan und den landesspezifischen Vorschriften und Normen angeschlossen werden. Dabei muss sichergestellt werden, dass:

- alle Gerätegehäuse über PA-Klemmen auf dem gleichen Potential liegen.
- über die Abschirmung der eigensicheren Kabel kein Ausgleichsstrom fließt.
- der Sternpunkt für den Potentialausgleich möglichst nah beim Wägesystem liegt.

1.8. Betriebsumgebung

Bei Auswahl eines Standorts:

- Wählen Sie für die Montage des Terminals eine stabile, vibrationsfreie Fläche.
- Das Gerät darf weder hohen Temperaturschwankungen noch **direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein**.
- Vermeiden Sie Zugluft in der Nähe der Wägeplattform beispielsweise durch offene Fenster oder Klimaanlage).
- Kalibrieren Sie das Terminal nach jeder größeren geografischen Umsetzung.

1.8.1.1. Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Das IND256x kann bei den Temperaturen und der relativen Luftfeuchtigkeit aufbewahrt und betrieben werden, die in Tabelle 1-1 angegeben sind.

1.8.1.2. Schutzart

Das IND256x besitzt die Schutzart, die in Tabelle 1-1 angegeben ist.

1.9. Abmessungen

Abbildung 1-3 und Abbildung 1-4 zeigen die Abmessungen des Terminals. Die Einheiten sind Zoll und [mm].

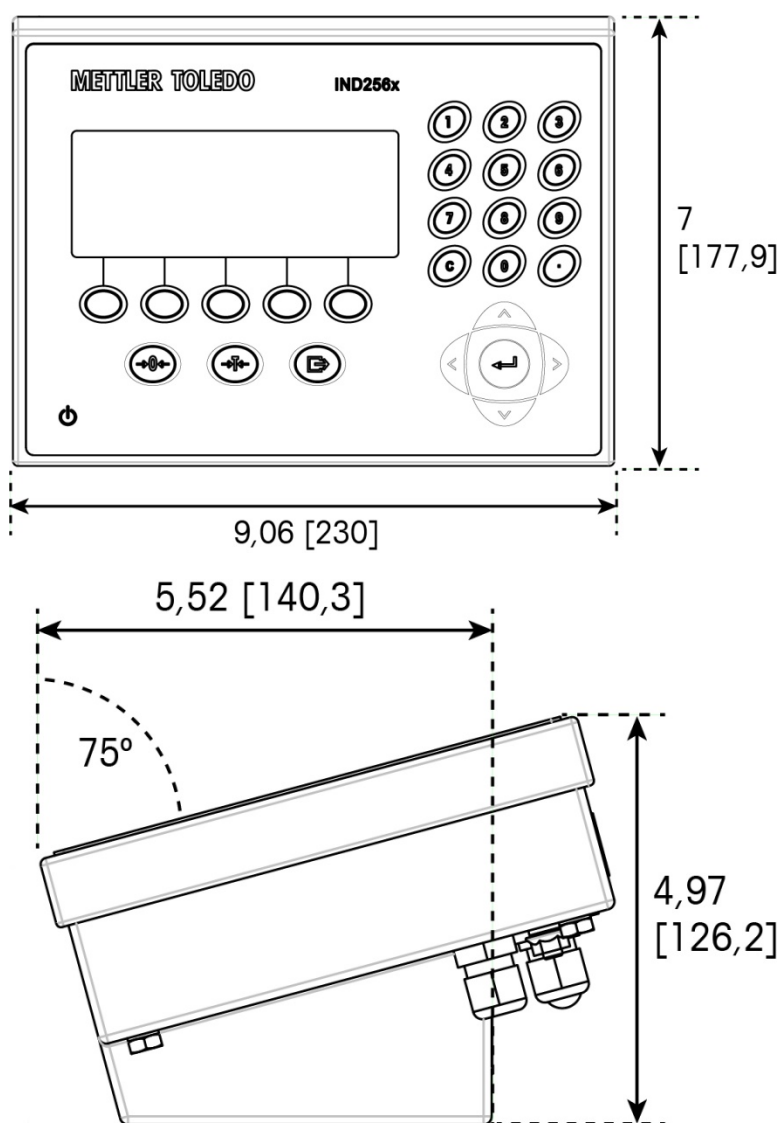


Abbildung 1-3: Abmessungen des IND256x, Tischinstallation

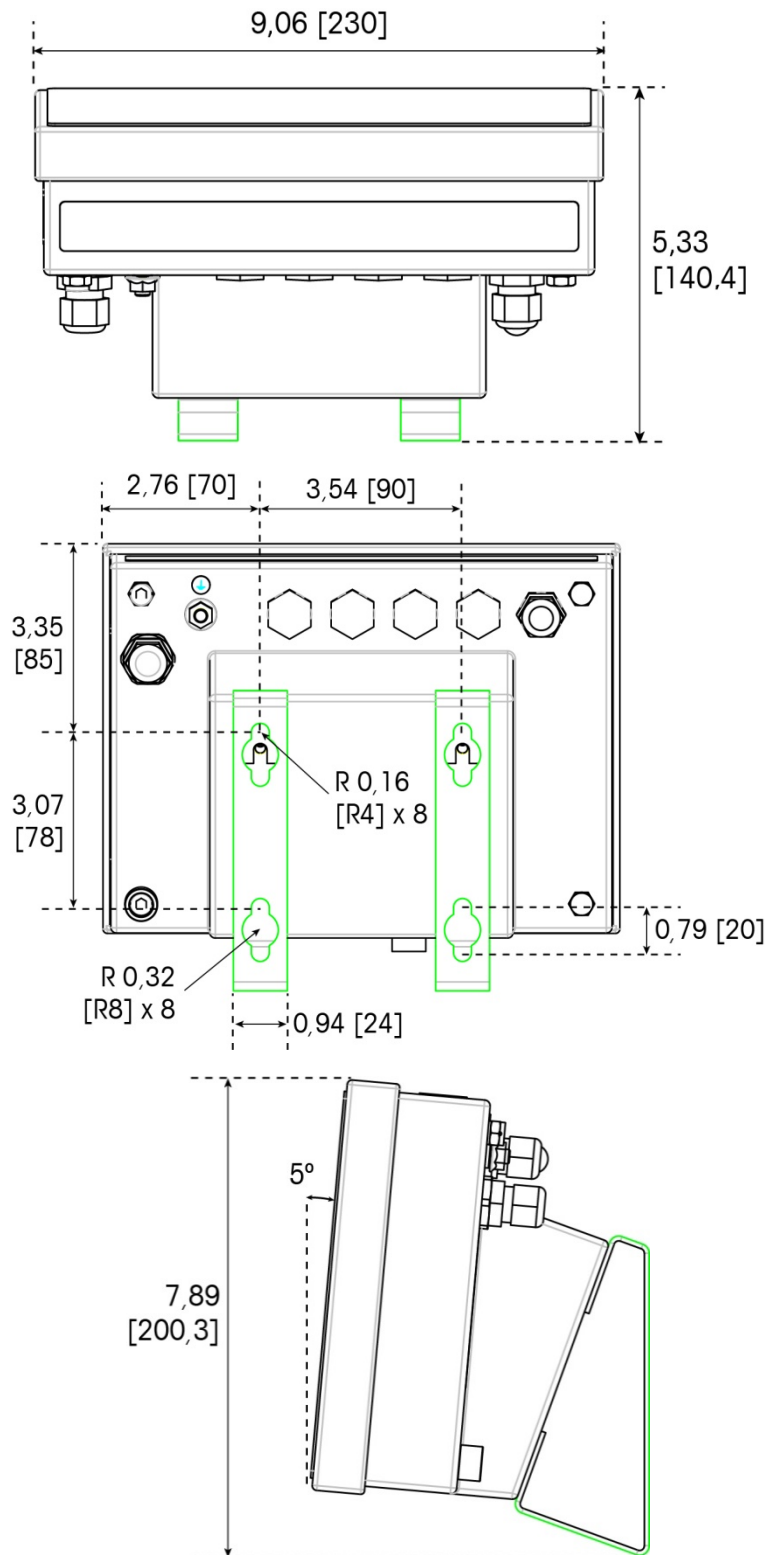


Abbildung 1-4: Abmessungen des IND256x mit fester Wandmontagehalterung

1.10. Hauptplatine

Die Hauptplatine des IND256x besitzt folgende Hauptanschlüsse, die in Abbildung 1-5 angegeben sind:

1. Schnittstelle für die analoge Wägezelle
2. Eigensicherer Stromeingang, Anschluss an das Strommodul
3. Flachbandkabelanschluss für die Anzeige
4. Eigensichere RS-232-Schnittstelle (COM1)
5. Zwei Anschlüsse für Kommunikationsoptionsplatten (COM2 und COM3)

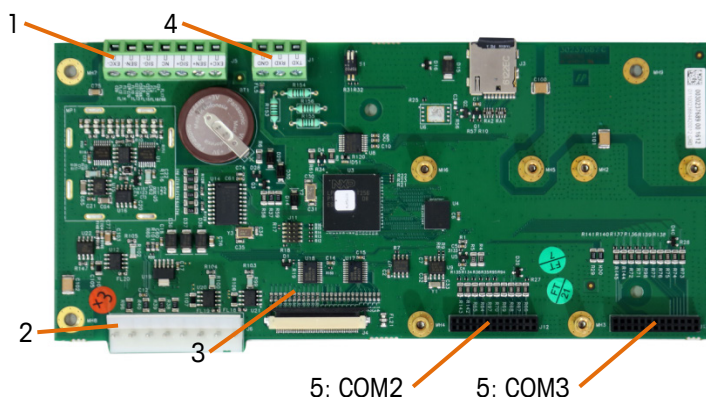


Abbildung 1-5: Die Hauptplatine des IND256x

1.11. Kommunikationsoptionsplatten

Das IND256x kann mit maximal zwei der drei Kommunikationsoptionsplatten im Gehäuse konfiguriert werden. Es gibt folgende Optionen:

- Eigensicherer 4-20 mA Analogausgangsmodul
- WiFi-Kommunikationsmodul nur in IND256x -Terminals verfügbar, die werkseitig mit WiFi konfiguriert wurden)
- Aktive Stromschleife Kommunikationsmodul ACM200, das mit einem sicheren Bereich verbunden werden kann)
- Passive Stromschleife Verwendung als zweite Anzeige für den Anschluss an ein weiteres IND256x mit aktiver Stromschleife)

2 Installation

2.1. Öffnen des Gehäuses

	 WARNUNG DIESES GERÄT DARF NICHT INSTALLIERT ODER GEWARTET WERDEN, BEVOR DER BEREICH, IN DEM SICH DAS IND245x BEFINDET, VON DER VERANTWÖRTLICHEN PERSON VOR ORT FÜR AUTORISIERTE MITARBEITERN GESICHERT WURDE.
	 VORSICHT BESTÄTIGEN SIE DIE EINHALTUNG DER GELTENDEN NATIONALEN UND LOKALEN WIFI-BESTIMMUNGEN, BEVOR SIE DAS MIT DEM WIFI-MODUL KONFIGURIERTE IND256x-TERMINAL INSTALLIEREN UND IN BETRIEB NEHMEN. METTLER TOLEDO ÜBERNIMMT IN LÄNDERN, IN DENEN WIFI-BESTIMMUNGEN NICHT ERFÜLLT WERDEN, KEINE VERANTWÖRTUNG FÜR TERMINALINSTALLATIONEN.
	 WARNUNG VERMEIDEN SIE DIE ENTZÜNDUNG VON GEFÄHRLICHEN GASEN. TRENNEN SIE DIE STROMVERSORUNG, BEVOR SIE DAS GEHÄUSE DES IND256X ÖFFNEN. NACH DEM EINSCHALTEN DES IND256X MUSS DAS GEHÄUSE UNBEDINGT VERSIEGELT BLEIBEN. ÖFFNEN SIE DAS GEHÄUSE NICHT IN DER NÄHE VON EXPLOSIVEM STAUB ODER EXPLOSIVEN GASEN.

Öffnen Sie das Terminal IND256x entsprechend den Schritten in den folgenden Abschnitten.

Die Frontplatte des Terminals IND256x ist mit 4 Schrauben befestigt. Öffnen Sie das Gehäuse wie folgt, um an die Hardware-Konfiguration im Gerät zu gelangen:

1. Legen Sie das Terminal mit der Vorderseite nach unten auf eine flache Oberfläche. Achten Sie darauf, dass Sie dabei das Bedienfeld nicht beschädigen.
2. Drehen Sie die vier unverlierbaren Schrauben in Abbildung 2-1 heraus.



Abbildung 2-1: Gehäuseschrauben

3. Heben Sie die hintere Abdeckung an und klappen Sie sie zur Seite, um an das Gehäuseinnere zu gelangen. Achten Sie auf die beiden Bänder, die die Frontplatte am Gehäuse halten.

2.2. Installation von Kabeln und Anschlüssen

Es gibt folgende Kabel und Anschlüsse am Terminal IND256x:

- Kabeldurchführungen für das Gehäuse für raue Umgebungen
- Verkabelung der Hauptplatine
- Stromanschluss

	! WARNUNG DIESES GERÄT DARF NUR VON QUALIFIZIERTEN SERVICEMITARBEITERN BEDIENT WERDEN. ARBEITEN SIE WÄHREND DER INSPEKTION, PRÜFUNG UND ANPASSUNG MIT SORGFALT. EINE FALSCH E HANDHABUNG KANN ZU VERLETZUNGEN FÜHREN.
--	---

Das Terminal IND256x ist für nasse und feuchte Umgebungen geeignet. Es ist jedoch notwendig, das Innere des Terminalgehäuses zu öffnen, um Kabel und Anschlüsse zu installieren. Jedes Kabel, das in das Gehäuse geführt wird, ist einer bestimmten Position zugeordnet.

2.2.1. Kabeldurchführungen für das Gehäuse für raue Umgebungen

So stellen Sie sicher, dass das Gehäuse wasserdicht und staubgeschützt ist:

1. Führen Sie ein Kabel der richtigen Stärke durch die dazugehörige Kabeldurchführung, bevor Sie die Adern verbinden. Je nach Größe der Kabeldurchführung, müssen Kabel mit einem bestimmten Durchmesser verwendet werden. Die erforderliche Kabelstärke ist in Tabelle 2-1 angegeben.

Tabelle 2-1: Kabeldurchmesser für Kabeldurchführungen

Kabeldurchführung	Kabeldurchmesser
Analoge Wägezelle	6–10 mm (0,24–0,39 in.)
COM1 (IS-RS232)	6–10 mm (0,24–0,39 in.)
Stromschleife (aktiv & passiv)	6–10 mm (0,24–0,39 in.)
Netz-/Gleichstromkabel	6–10 mm (0,24–0,39 in.)
Externer Akku	4–8 mm (0,16–0,3 in)

Wichtiger Hinweis

- Verwenden Sie im Terminal IND256x nur Kabeldurchführungen mit ATEX-Zertifizierung.
 - Die Kabeldurchführungen müssen vor Schlagbeschädigungen geschützt werden.
 - Achten Sie auf ausreichend Zugentlastung, damit keine Zugkräfte auf die Kabeldurchführungen wirken.
2. Achten Sie auf darauf, dass das im Gehäuse endende Kabel von der Klemmenleiste/vom Stecker bis zum Terminalgehäuse lang genug ist, damit die Steckerbaugruppe nicht durch Zug belastet wird, wenn das Gehäuse vollständig geöffnet ist.
 3. Die Abschirmung der Kabel muss wie in Abbildung 2-2 dargestellt an der Kabeldurchführung entfernt werden. Verteilen Sie die Abschirmungsadern gleichmäßig und stellen Sie sicher, dass die Abschirmungsadern Kontakt mit dem Metallelement der Kabeldurchführung haben.

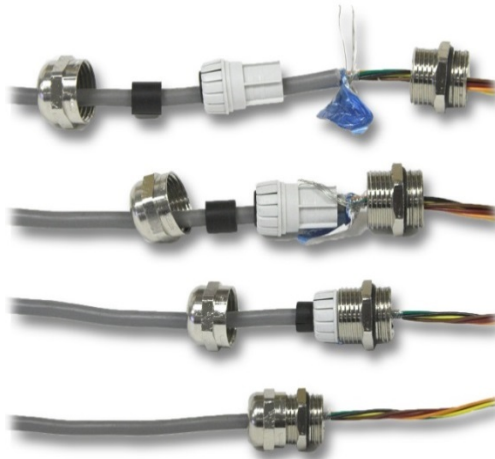


Abbildung 2-2: Abschirmungsabschluss an Kabeldurchführung

2.2.2.

Stromanschluss

	 WARNUNG
	DER ANSCHLUSS DER STROMVERSORGUNG MUSS VON EINEM VOM BETREIBER BEAUFTRAGTEN ELEKTRIKER UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DES ANSCHLUSSPLANS, DER BEILIEGENDEN INSTALLATIONSANWEISUNGEN SOWIE DER LANDESSPEZIFISCHEN VORSCHRIFTEN DURCHGEFÜHRT WERDEN.

Sofern IECEx & ATEX akzeptiert werden, kann das IND256x wie folgt mit Strom versorgt mit einer internen Stromversorgung an einem externen 230 VAC-Anschluss.

Der Stromanschluss erfolgt über einen Sicherheitsanschluss rechts im Gehäuse (Abbildung 2-3). Der Anschluss ist mit einer Kunststoffabdeckung geschützt.

Das Terminal mit einem Stromkabel mit einer Länge von 2,5 m ohne Stecker geliefert.

2.2.2.1.

Interner Netzstromanschluss (nur Terminals mit IECEx- & ATEX-Zulassung)

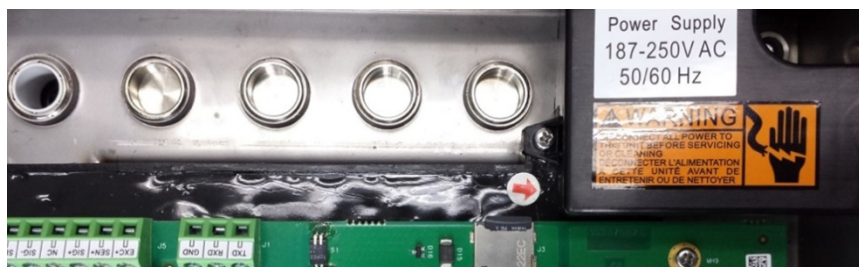


Abbildung 2-3: Netzstromanschluss mit Abdeckung

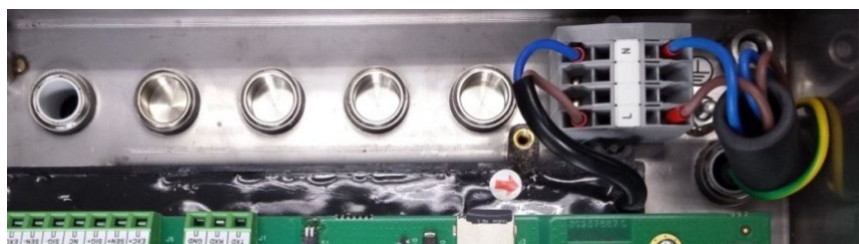


Abbildung 2-4: Netzstromanschluss ohne Abdeckung

Tabelle 2-2: Farbcode des Netzkabels

Stift	Stiftfarbe
L	Braun
N	Blau

2.2.2.2.

Interner Gleichstromanschluss (nur Terminals mit IECEx- & ATEX-Zulassung)

	WARNUNG
	DIE GLEICHSTROMVERSORGUNG MUSS MIT EINEM 18–30 VDC-EINGANG VERBUNDEN WERDEN. SCHLIESSEN SIE KEINE NETZSPANNUNG AN.
	WARNUNG
	BEI TERMINALS IND256x MIT GLEICHSTROMVERSORGUNG BESTEHT KEINE GALVANISCHE TRENNUNG ZWISCHEN DEM NICHT EIGENSICHEREN SPEISESTROMKREIS UND DEM EIGENSICHEREN AUSGANGSSTROMKREIS. DER NICHT EIGENSICHERE STROMKREIS MUSS SICHER GEERDET SEIN. AUSSERDEM IST EIN POTENZIALAUSGLEICH BEI EIGENSICHEREN STROMKREISEN ERFORDERLICH. ALTERNATIV MUSS DER NICHT EIGENSICHERE SPEISESTROMKREIS SEL V) SICHER GEGEN ERDE ISOLIERT WERDEN.





WARNUNG

DIE EXTERNE GLEICHSTROMVERSORGUNG DES KUNDEN DARF EINE MAXIMALE ÜBERSPANNUNG DER KATEGORIE II ENTSPRECHEND IEC 60664-1 HABEN.

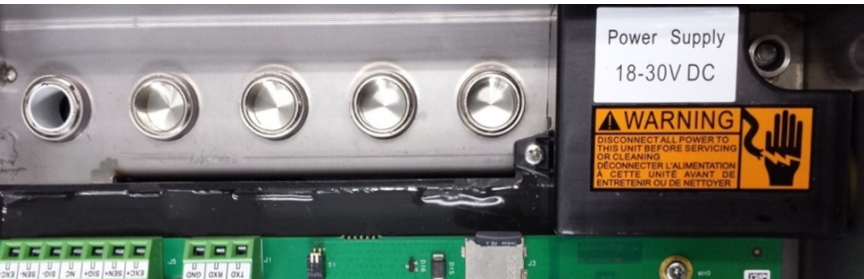


Abbildung 2-5: Gleichstromanschluss mit Abdeckung

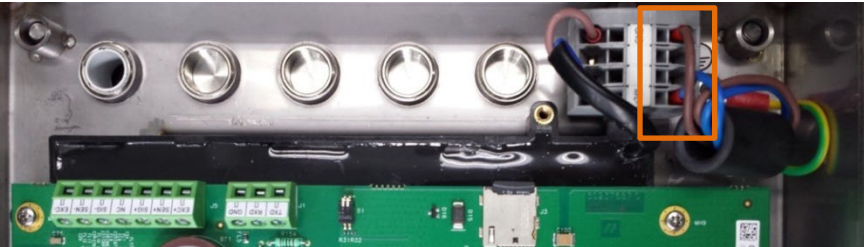


Abbildung 2-6: Gleichstromanschluss, Innenansicht

Tabelle 2-3: Farbcode des Gleichstromkabels

Stift	Stiftfarbe
GND	Braun
+24 V	Blau

2.2.2.3. Externe NiMH-Stromversorgung

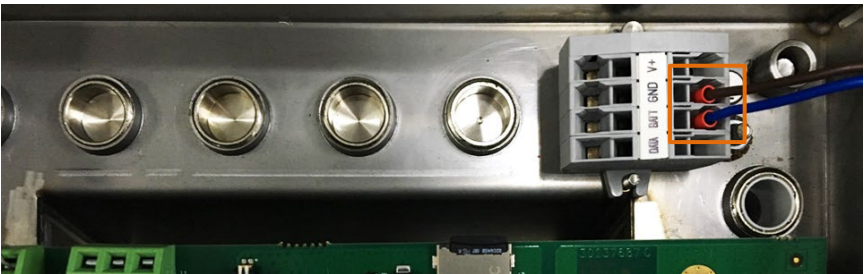


Abbildung 2-7: NiMH-Akkuanschluss, Innenansicht

Tabelle 2-3: NiMH-Akkuanschluss, Farbcode des Kabels

Stift	Stiftfarbe
DATA	Leer
BATT	Blau

Stift	Stiftfarbe
GND	Braun
V+	Leer

2.3. Potentialausgleich und Erdung

Alle Erdungs- und Potentialausgleichsverbindungen müssen den lokalen Vorschriften entsprechen, die im Land der Installation gelten. Weitere Informationen zur Erdung finden Sie in den lokalen Vorschriften und Kontrollzeichnungen.

In der Regel müssen alle angeschlossenen Teile eines Geräts im System entsprechend den lokalen Vorschriften einen gemeinsamen Potentialausgleich und Erdungspunkt verwenden. Eine spezielle externe Erdungsschraube für den gemeinsamen Potentialausgleich befindet sich am Terminal IND256x (Abbildung 2-8).



Abbildung 2-8: Erdungsschraube des Terminals IND256x

2.4. Potentialausgleich (PA)

Der Potentialausgleich muss durch einen vom Betreiber autorisierten Elektriker installiert werden. Der METTLER TOLEDO-Service übernimmt hierbei nur eine Überwachungs- und Beratungsfunktion.

Der Potentialausgleich aller Geräte (Netzteil, Wägeterminal, Schnittstellenadapter und Wägeplattform) muss entsprechend dem Anschlussplan und den landesspezifischen Vorschriften und Normen angeschlossen werden. Dabei muss sichergestellt werden, dass:

- alle Gerätegehäuse über PA-Klemmen auf dem gleichen Potential liegen.
- über die Abschirmung der eigensicheren Kabel kein Ausgleichsstrom fließt.
- der Sternpunkt für den Potentialausgleich möglichst nah beim Wägesystem liegt.

2.4.1. Warnungen

2.4.1.1. CENELEC

2.4.1.1.1. PA-Anschluss entsprechend den landesspezifischen Vorschriften

Es muss sichergestellt werden, dass die Gehäuse über PA-Klemmen auf dem gleichen Potential liegen. Es darf kein Ausgleichsstrom über die Abschirmung der eigensicheren Kabel fließen.

2.4.1.2. cFMus

2.4.1.2.1. PA-Anschluss entsprechend ANSI/NFPA 70, Art. 504, und ANSI/IA RP 12.06.01 oder Canadian Electric Code C22.2

Es muss sichergestellt werden, dass die Gehäuse über PA-Klemmen auf dem gleichen Potential liegen. Es darf kein Ausgleichsstrom über die Abschirmung der eigensicheren Kabel fließen.

2.5. Schließen des Gehäuses

So stellen Sie sicher, dass die Frontplatte ordnungsgemäß installiert ist:

- Legen Sie die Frontplatte auf einen flachen Untergrund.
- Achten Sie darauf, dass der Dichtring richtig sitzt.
- Bringen Sie die hintere Abdeckung in der richtigen Position an.
- Setzen Sie die Schrauben in ihren ursprünglichen Positionen ein.
- Ziehen Sie jede Schraube auf 3,0 Nm fest.

2.6. Anschluss für analoge Wägezelle

Analoge Wägezellen sind am Anschluss aus Kapitel 1, Einleitung, mit der Hauptplatine verbunden.

Das Terminal IND256x ist für maximal vier 350 Ohm-Wägezellen (oder einem Mindestwiderstand von ca. 87 Ohm) vorgesehen. Um zu überprüfen, ob die Wägezelle für diese Installation innerhalb der Grenzen liegt, muss der Waagengesamtwiderstand (TSR) berechnet werden.

So berechnen Sie den TSR:

$$\text{TSR} = \frac{\text{Eingangswiderstand der Wägezelle (Ohm)}}{\text{Anzahl der Zellen}}$$


Achten Sie vor Anschluss der Wägezellen darauf, dass der TSR des Wägezellennetzwerks, das mit dem IND256x verbunden ist, größer als 87 Ohm ist. Wenn der Widerstand kleiner als 87 Ohm ist, funktioniert das IND256x nicht richtig.

Außerdem muss der maximale Kabelabstand überprüft werden. Tabelle 2-4 enthält die empfohlenen maximalen Kabellängen entsprechend der Kabelstärke und der korrekten Funktion des Terminals. Beachten Sie, dass die Objektwerte für das Wägezellenkabel als Sicherheitsfaktor in der Installation berücksichtigt werden müssen.

Tabelle 2-4: Empfohlene maximale Kabellängen

TSR (Ohm)	24 G (Meter/Fuß)	20 G (Meter/Fuß)	16 G (Meter/Fuß)
1 bis 4 350 Ω Wägezellen	60/200	182/600	304/1000

Abbildung 2-9 zeigt die Verkabelung für analoge Wägezellen. Wenn eine Vierleiter-Wägezelle verwendet wird, muss +Exc mit +Sen und -Exc mit -Sen verbunden werden.

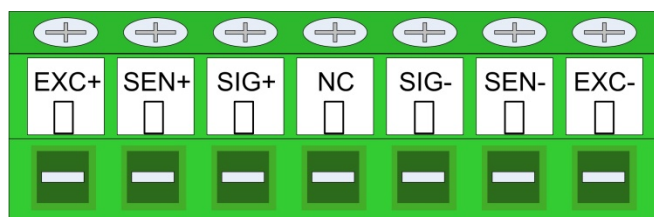

ANMERKUNG


1. DRAHTGRÖSSE: 18 AWG (0.823 mm²) MAX., 24 AWG (0.205 mm²) MIN.
2. ERDUNG AM CHASSIS: METAL KABELSTOPFBUCHSE

Abbildung 2-9: Wägezellenabschluss

2.7. Anschluss der Kommunikationsplatinen

2.7.1. Serieller Anschluss (COM1)

Der COM1-Port enthält Anschlüsse für ein eigensicheres seriellcs Gerät. Abbildung 2-10 zeigt den COM1-Port-Anschluss. Die Kabellänge dieser Verbindung ist auf 10 m begrenzt.



IND256x	Signal
J1-1	TxD – Daten senden
J1-2	RxD – Daten empfangen
J1-3	GND – Logische Masse

Abbildung 2-10: COM1-Port-Signale

Ein Beispiel für den Anschluss an ein RS232-Gerät im sicheren Bereich über eine Zenerdiodenbarriere ist in Abbildung 2-11 dargestellt. Berücksichtigen Sie bei Auswahl einer Barriere die Objektzulassungswerte für COM1. Beachten Sie, dass Dichtungen und andere Schutzvorrichtungen ebenfalls die Verdrahtungsvorschriften für Gefahrenbereiche erfüllen müssen.

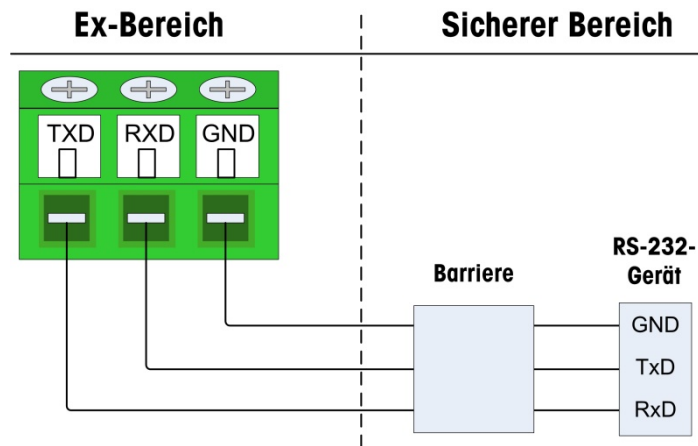


Abbildung 2-11: Beispiel für eine RS232-Verbindung

Folgende Barriere wurde für den korrekten Betrieb mit IND256x geprüft und kann direkt an COM1 angeschlossen werden:

- MTL7761Pac (IECEx- und ATEX-Zulassung)

2.7.2. Aktive Stromschleife


Die Optionsplatine für die aktive Stromschleife kann nur im COM3-Anschluss der Hauptplatine installiert werden. Wenn das IND256x mit einem ACM200-Gerät verbunden ist, muss das ACM200-Gerät über eine aktive Stromschleife angeschlossen werden, um die Kommunikation im sicheren Bereich zu ermöglichen.

Tabelle 2-5: Verbindung des ACM200 über eine aktive Stromschleife

IND256x COM3 (J2)	ACM200 COM (J3)
1	4
2	3
3	2
4	1

Kundenspezifische Kabel für eigensichere Stromkreise müssen wie folgt angepasst werden:

	IND256x – ACM200
Kabel	2 x 2 x 0,5 mm ²
Länge A (IND256x)	110 mm (2,4")
Länge B (ACM200)	70 mm (2,8")
Maximale Länge	300 m (1000 ft)

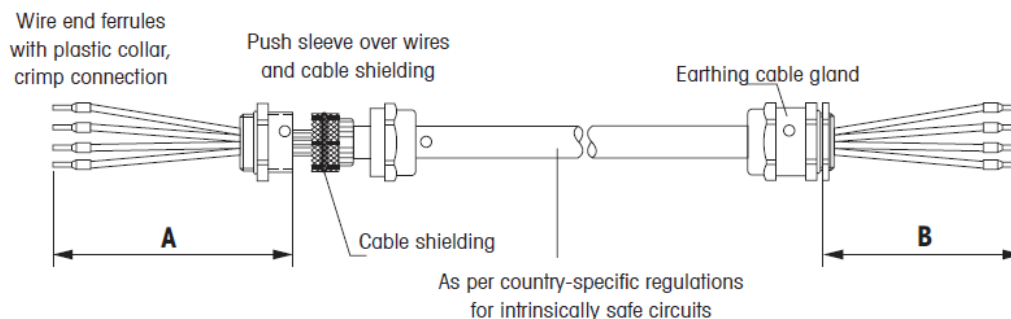

1. Schneiden Sie das Kabel auf die richtige Länge und entfernen Sie die Isolierung an den Kabelenden entsprechend Länge A/B.
2. Kürzen Sie die Kabelabschirmung auf beiden Seiten auf 10 mm.
3. Entfernen Sie die Isolierung an den Aderenden.
4. Quetschen Sie Aderendhülsen mit einer Crimpzange auf die Aderenden.
5. Schieben Sie den zweiten hinteren Teil der Erdungskabeldurchführung auf das Kabel.
6. Drücken Sie die Abschirmung nur auf das Ende von IND256x, indem Sie die Hülse über die Adern und die Kabelabschirmung schieben und dann über der Kabelabschirmung zusammendrücken.
7. Schieben Sie den vorderen Teil der Kabeldurchführung auf und verschrauben Sie ihn mit dem hinteren Teil.

2.7.3. Passive Stromschleife

Um das Terminal IND256x mit einem anderen IND256x-Wägesystem als Fernanzeige zu verbinden, muss die Schnittstelle für die passive Stromschleife mit der aktiven Stromschleife des anderen Terminals IND256x verbunden werden. Die passive Stromschleife kann nur am COM3-Anschluss der Hauptplatine angeschlossen werden.

Tabelle 2-6: Verbindung der Terminals über passive Stromschleife

IND256x COM3 (passive Stromschleife J4) (Fernanzeige)		IND256x COM3 (aktive Stromschleife J2) (Gerät für den Anschluss der Wägeplattform)
1	←→	1
2	←→	2
3	←→	3
4	←→	4

2.7.4. Eigensicherer analoger 4–20 mA-Ausgang

Die optionale eigensichere analoge 4–20 mA Kommunikationsplatine wird an den COM2-Port der Hauptplatine des IND256x angeschlossen. Sie liefert ein eigensicheres analoges Signal von 4–20 mA, proportional zum Gewicht der Waage oder zur Änderungsrate des Gewichts auf der Waage. Die maximale Kabellänge für den Anschluss an den Analogausgang beträgt 300 m. Das für das Analogausgangssignal verwendete Kabel muss abgeschirmt sein.

- Diese Option kann nicht zusammen mit der WLAN-Option verwendet werden.



Abbildung 2-12: Eigensichere Optionsplatine für analogen Ausgang

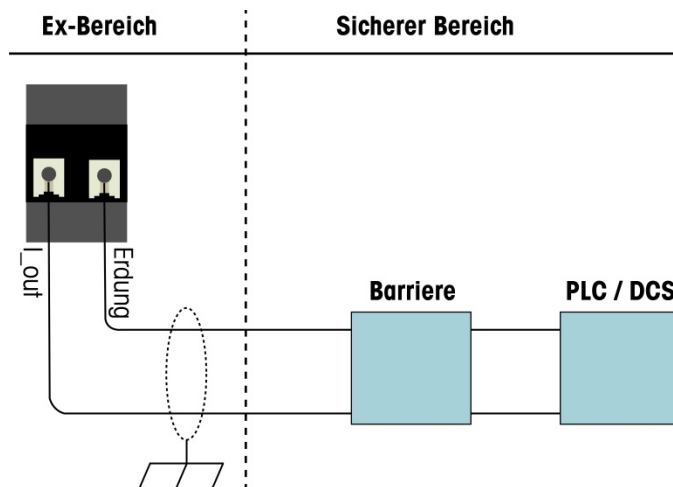


Abbildung 2-13: Verdrahtung des analogen Ausgangs

Die analoge isolierte Barriere KFD2-STC4-EX1 von P&F (Zertifikatsnummern: IECEx BAS 04.0016X; BAS 99 ATEX 7060X) wurde verifiziert und kann direkt mit der eigensicheren analogen 4–20 mA-Option des IND256x verbunden und dann an ein PLC- oder DCS-System im sicheren Bereich angeschlossen werden.

2.7.5. Drahtloskommunikation

Die Optionsplatine für Drahtloskommunikation des IND256x wird auf der Hauptplatine mit anderen Optionsplatinen installiert und ist nicht mit Peripheriegeräten verbunden. Die Option sollte wie in Kapitel 3, Abschnitt 3.8.4 beschrieben konfiguriert werden. Ein starkes WLAN-Signal ist erforderlich, um eine drahtlose Kommunikation mit Peripheriegeräten zu erreichen.

Das IND256x unterstützt eine WLAN-Option.

- Diese Option kann nicht zusammen mit der eigensicheren analogen 4–20 mA-Option verwendet werden.



Abbildung 2-14: WLAN-Option des IND256x und Antenne

2.8. Plombieren des Gehäuses

Wenn das IND256x im Modus „Zulassung“ verwendet wird, ist eine externe Verplombung notwendig.

Die Plombendetails für das IND256x sind in Abbildung 2-15 dargestellt. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Prüfen Sie, ob das richtige Gebiet unter **Waage > Typ > Zulassung** ausgewählt wurde und schalten Sie den Metrologieschalter SW1-1 ein (Position und Funktion des Schalters finden Sie in Kapitel 2, **Funktion**).
2. Führen Sie den Plombendraht durch zwei nebeneinanderliegende Plombierschrauben und befestigen Sie den Plombenhalter wie in Abbildung 2-15 dargestellt.
3. Schneiden Sie den überschüssigen Plombendraht ab.

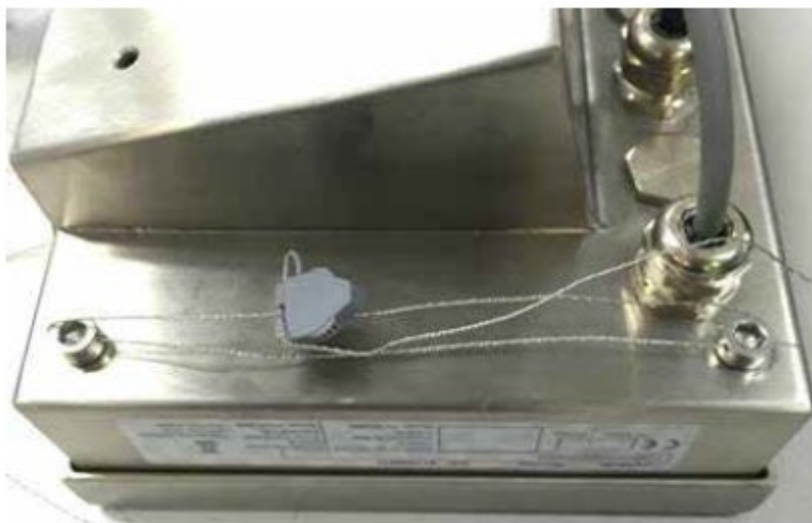


Abbildung 2-15: Plombierung

2.9. Schnittstellenparameter

2.9.1. Versorgungsstromkreis (Netzanschluss)

Versorgungsstromkreis	Parameter
Variante mit nichteigensicherer Wechselstromversorgung (Typenschlüssel endet mit „46“ oder „44“) (nur mit ATEX- & IECEx-Zulassung) Fest angeschlossenes Kabel mit Aderendhülse	Nennspannung: 187...250 V AC (50/60 Hz) Nennstrom: 125 mA Maximale Eingangsspannung: U_m 250 V AC
Variante mit nichteigensicherer Gleichstromversorgung (Typenschlüssel endet mit „56“ oder „54“) (nur mit ATEX- & IECEx-Zulassung) Fest angeschlossenes Kabel mit Aderendhülse: Blau: +24 V, Braun: GND, grün-gelb: PE	Nennspannung: 18...30 V DC Nennstrom: 250 mA Maximale Eingangsspannung an der zugehörigen Vorrichtung: U_m 250 V AC (Hinweis: Die Nennspannung ist niedriger.)
Varianten mit eigensicherer Gleichstromversorgung (Akku) (Typenschlüssel endet mit „25“ oder „27“) Anschlussklemmen: V+, GND, BATT, DATA	Nenneingangsspannung: 10 V DC Eingangsnennstrom: 350 mA
	Maximale Eingangsspannung: U_i 12,8 V DC Maximaler Eingangsstrom: I_i 3,03 A Maximale Eingangsleistung: P_i 6,83 W
	Effektive innere Induktivität: L_i vernachlässigbar Effektive innere Kapazität: C_i vernachlässigbar

2.9.2. Eigensichere RS232-Schnittstelle

Eigensichere RS232-Schnittstelle	Parameter
Klemmen J1.1 (TXD), J1.2 (RXD) – J1.3 (GND)	Maximale Eingangsspannung: $U_i \pm 10$ V DC Effektive innere Kapazität: C_i vernachlässigbar Effektive innere Induktivität: L_i vernachlässigbar
	Maximale Ausgangsspannung: U_o J1.1-GND bzw. J1.2-GND jeweils: $\pm 5,36$ V DC
	Maximaler Ausgangsstrom: I_o J1.1-GND bzw. J1.2-GND jeweils: $\pm 12,9$ mA
	Maximale Ausgangsleistung: P_o J1.1-GND bzw. J1.2-GND jeweils: 17,2 mW
	Maximale äußere Kapazität: C_o 100 nF Maximale äußere Induktivität: L_o 100 μ H

2.9.3. Eigensicherer Ausgang zum Anschluss an eine Wägezelle

Eigensicherer Ausgang zum Anschluss an eine Wägezelle	Parameter
Klemmen J5.1 (EXC+), J5.2 (SEN+), J5.3 (SIG+), J5.5 (SIG-), J5.6 (SEN-), J5.7 (EXC-)	Maximale Ausgangsspannung: U_o 5,88 V DC
	Maximaler Ausgangsstrom: I_o 171 mA
	Maximale Ausgangsleistung: P_o 940 mW
	Maximale äußere Kapazität: C_o 6,8 μ F
	Maximale äußere Induktivität: L_o 0,3 mH

2.9.4. Schnittstellen der optionalen Kommunikationsplatinen

Schnittstellen der optionalen Kommunikationsplatinen	Parameter
Eigensichere 4–20mA-Schnittstelle Nur für Varianten mit Optionsplatine für analogen Ausgang (Typenschlüssel „A“) Klemmen J2.1 (I_OUT) – J2.2 (GND)	Maximale Eingangsspannung: U_i 3,5 V DC
	Maximaler Eingangsstrom: I_i 115 mA
	Maximale innere Kapazität: C_i 110 nF
	Maximale innere Induktivität: $L_o=0$
	Maximale Ausgangsspannung: U_o 13,65 V DC
	Maximaler Ausgangsstrom: I_o 115 mA
	Maximale Ausgangsleistung: P_o 0,4 W
	Maximale äußere Kapazität: C_o 680 nF
	Maximale äußere Induktivität: L_o 400 μ H
WLAN-Antennenverbindung Nur für Varianten mit WLAN-Optionsplatine (Typenschlüssel „W“) IPEX-Stecker zum Anschluss an die externe Antenne Typ AC-Q24-50ZD	Maximale HF-Leistung: < 1,3 W
	Frequenz: 2400...2483 MHz
Schnittstelle für eigensichere aktive Stromschleife Nur für Varianten mit Optionsplatine für aktive Stromschleife (Typenschlüssel „E“) Klemmleiste J2, Klemmen J2.1...J2.4 (aktive Stromschleife)	Maximale Ausgangsspannung: U_o 5,36 V DC
	Maximaler Ausgangsstrom: I_o 131 mA
	Maximale Ausgangsleistung: P_o 176 mW
	Maximale äußere Kapazität: C_o 600 nF
Schnittstelle für eigensichere passive Stromschleife Nur für Varianten mit Optionsplatine für passive Stromschleife (Typenschlüssel „P“) Klemmleiste J4, Klemmen J4.1...J4.4 (passive Stromschleife)	Maximale äußere Induktivität: L_o 400 μ H
	Maximale Eingangsspannung: U_i 10 V DC
	Maximaler Eingangsstrom: I_i 300 mA
	Maximale Eingangsleistung: P_i 500 mW
	Effektive innere Kapazität: C_i 110 nF
	Effektive innere Induktivität: L_i vernachlässigbar

2.9.5. Umgebungstemperaturbereich

Parameter
Umgebungstemperaturbereich: T_a -10 °C...+40 °C

IND256x

Terminal de pesage



METTLER TOLEDO

Terminal de pesage IND256x

METTLER TOLEDO Service

Services essentiels à une performance fiable

Nous vous remercions d'avoir sélectionné la qualité et la précision de METTLER TOLEDO. Si vous respectez les instructions stipulées dans ce manuel pour votre nouvel équipement et confiez régulièrement l'étalonnage et la maintenance à notre équipe de service formée à l'usine, vous obtiendrez non seulement une exploitation fiable et précise, mais vous protégerez votre investissement. Consultez-nous pour discuter d'un contrat de service adapté à vos besoins et votre budget. Vous trouverez de plus amples informations à l'adresse suivante: www.mt.com/service.

Il existe plusieurs méthodes garantissant l'optimisation de la performance de votre investissement:

1. **Enregistrez votre produit:** Nous vous invitons à enregistrer votre produit à l'adresse www.mt.com/productregistration afin de nous permettre de vous avertir des améliorations, mises à jour et avis importants relatifs à votre produit.
2. **Contactez METTLER TOLEDO pour le service:** La valeur d'une mesure est proportionnelle à sa précision. Une balance hors spécification peut affecter la qualité, réduire les revenus et accroître les responsabilités. Le service ponctuel de METTLER TOLEDO garantit la précision et optimise la durée d'exploitation ainsi que la vie utile de l'équipement.
 - a. **Installation, Configuration, Intégration et Formation:** Nos représentants techniques sont des spécialistes des équipements de pesage, formés à l'usine. Nous veillons à ce que l'équipement de pesage soit prêt à la production de manière rentable et ponctuelle et que le personnel soit formé pour optimiser la réussite.
 - b. **Documentation d'étalonnage initial:** Les conditions relatives à l'application et l'environnement de l'installation sont différentes pour toutes les balances industrielles de sorte que la performance doit être testée et certifiée. Nos services d'étalonnage et les certificats documentent la précision afin de garantir la qualité de la production et fournir un enregistrement du système de qualité sur la performance.
 - c. **Maintenance périodique de l'étalonnage:** Un Accord de service d'étalonnage favorise la confiance continue dans votre processus de pesage et fournit la documentation de conformité aux normes. Nous offrons toute une gamme de programmes de service qui sont préparés pour satisfaire vos besoins et conçus pour correspondre à votre budget.
 - d. **Vérification GWP® :** Une approche fondée sur le risque de gestion des équipements de pesage permet de contrôler et d'améliorer le processus de mesurage dans son entier, ce qui assure une qualité reproductible du produit et minimise les coûts de traitement. GWP (Good Weighing Practice ou bonnes pratiques du pesage), la norme à vocation scientifique pour une gestion efficace du cycle de vie des équipements de pesage, offre des réponses claires sur la manière de spécifier, d'étalonner et d'assurer la précision des équipements de pesage indépendamment du fabricant ou de la marque.\

© METTLER TOLEDO 2019

Toute reproduction et tout transfert du présent manuel sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et l'enregistrement, pour quelque raison que ce soit, sont strictement interdits sans le consentement écrit exprès préalable de METTLER TOLEDO.

Droits limités par le gouvernement américain : cette documentation est fournie avec des droits limités.

Copyright 2019 METTLER TOLEDO. La présente documentation contient des informations exclusives à METTLER TOLEDO. Elle ne peut être recopiée ni intégralement ni partiellement sans le consentement exprès préalable écrit de METTLER TOLEDO.

METTLER TOLEDO se réserve le droit d'apporter des changements au produit ou au manuel sans préavis.

COPYRIGHT

METTLER TOLEDO® est une marque déposée de Mettler-Toledo, LLC. Toutes les autres marques et noms de produit sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

METTLER TOLEDO SE RÉSERVE LE DROIT D'APPORTER DES AMÉLIORATIONS OU DES MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS.

Avis de la FCC

Cet équipement est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC et aux règlements sur les brouillages radioélectriques édictés par le Ministère des Communications du Canada. Son utilisation est sujette aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences néfastes, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement non désiré.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de classe A, en vertu de la Section 15 des règles de la FCC (Commission fédérale des communications). Ces limites ont pour objectif de fournir une protection raisonnable contre toute interférence dangereuse lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner une énergie de radiofréquence et s'il n'est pas installé et utilisé conformément au guide d'utilisateur, il peut générer des brouillages préjudiciables aux communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle risque de générer des brouillages préjudiciables auquel cas, l'utilisateur se verra dans l'obligation de rectifier la situation à ses frais.

- La déclaration de conformité est disponible sur <http://glo.mt.com/global/en/home/search/compliance.html/compliance/>.

Mises en garde

- LIRE ce guide AVANT de faire fonctionner ou de réparer l'équipement et RESPECTER soigneusement toutes les instructions.
- CONSERVER ce manuel à titre de référence ultérieure.

	 AVERTISSEMENT
	NE PROCÉDEZ À AUCUNE INSTALLATION OU RÉPARATION DE L'APPAREIL TANT QUE LA ZONE OÙ SE TROUVE LE TERMINAL IND245x N'EST PAS SÉCURISÉE PAR DU PERSONNEL HABILITÉ À LE FAIRE PAR LE RESPONSABLE SUR LE SITE DU CLIENT.
	 MISE EN GARDE
	CONFIRMEZ LA CONFORMITÉ AUX RÉGLEMENTATIONS WIFI NATIONALES ET LOCALES EN VIGUEUR AVANT D'INSTALLER ET DE METTRE EN SERVICE LE TERMINAL IND256x CONFIGURÉ AVEC LE MODULE WIFI. METTLER TOLEDO DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES INSTALLATIONS DE TERMINAUX DANS DES PAYS OÙ LES RÉGLEMENTATIONS EN MATIÈRE DE WIFI NE SONT PAS RESPECTÉES.
	 AVERTISSEMENT
	EN CAS DE DOMMAGE DU CLAVIER, DE LA LENTILLE D'AFFICHAGE OU DE L'ENCEINTE DU TERMINAL IND245x, LE COMPOSANT DÉFECTUEUX DOIT ÊTRE IMMÉDIATEMENT REMPLACÉ. DÉBRANCHEZ IMMÉDIATEMENT L'ALIMENTATION CA OU CC ET NE LA RÉACTIVEZ PAS TANT QUE LA LENTILLE D'AFFICHAGE, LE CLAVIER OU L'ENCEINTE N'ONT PAS ÉTÉ REMPLACÉS PAR UN PERSONNEL DE MAINTENANCE QUALIFIÉ. LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS POURRAIT ENTRAÎNER UN PRÉJUDICE CORPOREL ET/OU ENDOMMAGER L'ÉQUIPEMENT.
	 AVERTISSEMENT
	ÉVITER LA CHARGE ÉLECTROSTATIQUE DURANT L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN.
	 AVERTISSEMENT
	L'UTILISATION EST SEULEMENT PERMIS QUE LES CHARGES ÉLECTROSTATIQUES FONCTIONNELLES ET RELATIVES AU PROCESSUS NE SONT PAS PRÉSENTES.
	 AVERTISSEMENT
	N'UTILISEZ LE TERMINAL DE PESAGE QUE LORSQUE LES PROCÉDÉS ENTRAÎNANT UNE PROPAGATION PAR AIGRETTE ÉLECTRIQUE NE PEUVENT PAS SE PRODUIRE.
	 AVERTISSEMENT
	ÉLOIGNEZ LE TERMINAL DES PROCÉDÉS GÉNÉRANT UN POTENTIEL DE CHARGE ÉLEVÉ, TELS QUE LE REVÊTEMENT ÉLECTROSTATIQUE, LE TRANSFERT RAPIDE DE MATÉRIAUX NON CONDUCTEURS, LES JETS D'AIR RAPIDES ET LES AÉROSOLS À HAUTE PRESSIION.
	 AVERTISSEMENT
	NE NETTOYEZ PAS LE TERMINAL À L'AIDE D'UN CHIFFON SEC. ESSUYEZ TOUJOURS LE TERMINAL DOUCEMENT À L'AIDE D'UN CHIFFON HUMIDE.

		AVERTISSEMENT
		PORTEZ DES VÊTEMENTS APPROPRIÉS. ÉVITEZ LE NYLON, LE POLYESTER OU TOUT AUTRE MATÉRIAU SYNTHÉTIQUE QUI GÉNÈRE ET RETIENT LA CHARGE. UTILISEZ DES CHAUSSURES ET UN SOL CONDUCTEUR.
		AVERTISSEMENT
		ÉVITEZ DE RECOUVRIR LE TERMINAL DE PLASTIQUE.
		AVERTISSEMENT
		ASSUREZ LA MISE À LA TERRE ÉQUIPOTENTIELLE DU TERMINAL, DES ACCESSOIRES DE MONTAGE ET DE LA BASE DE LA BALANCE.
		AVERTISSEMENT
		LE TERMINAL DOIT ÊTRE PROTÉGÉ CONTRE LES RAYONS UV.
		AVERTISSEMENT
		LA VERSION CC DU TERMINAL IND256X NE DISPOSE D'AUCUNE SÉPARATION ÉLECTRIQUE ENTRE LE CIRCUIT D'ALIMENTATION À SÉCURITÉ NON INTRINSÈQUE ET LES CIRCUITS DE SORTIE À SÉCURITÉ INTRINSÈQUE. LE CIRCUIT À SÉCURITÉ NON INTRINSÈQUE DOIT ÊTRE CORRECTEMENT RELIÉ À LA TERRE. UNE ÉGALISATION DES POTENTIELS DOIT ACCOMPAGNER LES CIRCUITS À SÉCURITÉ INTRINSÈQUE. SINON, LE CIRCUIT D'ALIMENTATION À SÉCURITÉ NON INTRINSÈQUE (TBTS) DOIT ÊTRE CORRECTEMENT ISOLÉ DE LA TERRE.
		AVERTISSEMENT
		L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE CC EXTERNE FOURNIE PAR LE CLIENT DOIT PRÉSENTER UNE SURTENSION MAXIMALE DE CATÉGORIE II CONFORMÉMENT À L'IEC 60664-1.
		AVERTISSEMENT
		UNE DÉCHARGE DE TRACTION SUFFISANTE DOIT ÊTRE ASSURÉE AFIN D'ÉVITER D'EXERCER TOUTE FORCE DE TRACTION SUR LES PRESSE-ÉTOUPES.
		AVERTISSEMENT
		LES PRESSE-ÉTOUPES DOIVENT ÊTRE PROTÉGÉS CONTRE LES DOMMAGES DUS AUX CHOCS.
		AVERTISSEMENT
		LE TERMINAL ASSEMBLÉ AVEC L'ANTENNE WIFI DOIT ÊTRE INSTALLÉ DANS UNE POSITION TELLE QUE LE RISQUE DE DOMMAGE MÉCANIQUE SOIT FAIBLE. REMPLACER IMMÉDIATEMENT L'ANTENNE WIFI SI ELLE EST ENDOMMAGÉE !

	 AVERTISSEMENT LES TERMINAUX IND256X CONFIGURÉS EN USINE AVEC WIFI SONT HOMOLOGUÉS POUR UNE UTILISATION DANS DES ZONES CLASSÉES ZONE 1 GROUPE D'ÉQUIPEMENT IIB. LES TERMINAUX IND256X CONFIGURÉS EN USINE AVEC WIFI NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS DANS DES ZONES CLASSÉES GROUPE D'ÉQUIPEMENT IIC. L'UTILISATION D'UN TERMINAL IND256X CONFIGURÉ EN USINE AVEC WIFI DANS UNE ZONE CLASSÉE POUR LAQUELLE IL N'EST PAS HOMOLOGUÉ EST SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER DES BLESSURES ET/OU D'ENDOMMAGER L'ÉQUIPEMENT.
	 AVERTISSEMENT L'ALIMENTATION EN COURANT CONTINU FOURNIE PAR LE CLIENT EXTERNE DOIT AVOIR UNE CATÉGORIE DE SURTENSION MAXIMALE II SELON LA NORME IEC 60664-1.
	 AVERTISSEMENT NE PAS OUVRIR LE TERMINAL EN CAS D'ATMOSPHÈRE EXPLOSIBLE DUE À LA PRÉSENCE DE POUSSIÈRE. AFIN D'ÉVITER L'INFLAMMATION D'ATMOSPHÈRES DANGEREUSES, DÉBRANCHER LE TERMINAL IND256X DE SA SOURCE D'ALIMENTATION AVANT D'OUVRIR LE BOÎTIER. MAINTENIR LE CAPOT CORRECTEMENT FERMÉ LORSQUE LE CIRCUIT EST SOUS TENSION. NE PAS OUVRIR EN CAS D'ATMOSPHÈRE EXPLOSIBLE DUE À LA PRÉSENCE DE POUSSIÈRE.
	 AVERTISSEMENT L'ENSEMBLE DE L'ÉQUIPEMENT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AU SCHÉMA DU FABRICANT NUMÉRO 30282892B ET AUX RÈGLEMENTATIONS LOCALE EN VIGUEUR.
	 AVERTISSEMENT SEULS LES COMPOSANTS SPÉCIFIÉS DANS LE MANUEL D'INSTALLATION INCLUS SUR LE CD DE LA DOCUMENTATION 30512916 PEUVENT ÊTRE UTILISÉS SUR CET APPAREIL. TOUS LES ÉQUIPEMENTS DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS D'INSTALLATION. DES COMPOSANTS INCORRECTS OU DE REMPLACEMENT ET/OU LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUVENT REMETTRE EN QUESTION LA SÉCURITÉ INTRINSÈQUE DU TERMINAL ET ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES ET/OU ENDOMMAGER L'ÉQUIPEMENT.
	 AVERTISSEMENT POUR ASSURER UNE PROTECTION SANS FAILLE CONTRE LES CHOCS ÉLECTRIQUES, BRANCHER UNIQUEMENT DANS UNE SOURCE D'ALIMENTATION CORRECTEMENT MISE À LA TERRE. NE PAS RETIRER LA CONNEXION DE MISE À LA TERRE.
	 AVERTISSEMENT LORSQUE CET ÉQUIPEMENT EST INCLUS EN TANT QUE PIÈCE D'UN SYSTÈME, LA CONCEPTION EN RÉSULTANT DOIT ÊTRE VÉRIFIÉE PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ QUI CONNAÎT LA CONSTRUCTION ET L'UTILISATION DE TOUS LES COMPOSANTS DU SYSTÈME, AINSI QUE LES DANGERS POTENTIELS QUI Y SONT ASSOCIÉS. LE NON-RESPECT DE CETTE PRÉCAUTION POURRAIT ENTRAÎNER UN PRÉJUDICE CORPOREL ET/OU ENDOMMAGER L'ÉQUIPEMENT.
	 AVERTISSEMENT N'AUTORISEZ QUE LE PERSONNEL QUALIFIÉ À RÉPARER LE TERMINAL IND245x. SOYEZ PRUDENT LORS DES VÉRIFICATIONS, TESTS ET RÉGLAGES EFFECTUÉS ALORS QUE L'APPAREIL EST SOUS TENSION. LE NON-RESPECT DE CES PRÉCAUTIONS POURRAIT ENTRAÎNER UN PRÉJUDICE CORPOREL ET/OU ENDOMMAGER L'ÉQUIPEMENT.

	AVERTISSEMENT
	AVANT DE RACCORDER OU DE DÉBRANCHER TOUT COMPOSANT ÉLECTRONIQUE INTERNE OU D'INTERCONNECTER DES CÂBLES ENTRE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES, COUPEZ TOUJOURS L'ALIMENTATION ET PATIENTEZ AU MOINS TRENTÉ (30) SECONDES AVANT DE PROCÉDER À TOUT RACCORDEMENT OU DÉBRANCHEMENT. LE NON-RESPECT DE CES PRÉCAUTIONS POURRAIT ENDOMMAGER OU DÉTRUIRE L'ÉQUIPEMENT.
	AVIS
	TOUJOURS MANIPULER LES APPAREILS SENSIBLES À DES CHARGES ÉLECTROSTATIQUES AVEC PRÉCAUTION.

Condition relative à une mise au rebut sécuritaire



Conformément à la directive européenne 2002/96/CE sur l'équipement électronique et électrique des déchets (WEEE), cet appareil ne peut pas être éliminé dans des déchets ménagers. Cette consigne est également valable pour les pays en dehors de l'UE, selon les conditions spécifiques aux pays. Prière d'éliminer ce produit conformément à la réglementation locale au point de collecte spécifié pour les équipements électriques et électroniques.

Pour de plus amples informations, contactez l'autorité responsable ou le distributeur auprès duquel vous avez acheté cet appareil.

Si cet appareil change de propriétaire (pour des raisons personnelles ou professionnelles), cette consigne doit être communiquée à l'autre partie.

Nous vous remercions de votre contribution à la protection de l'environnement.

Table des matières

1	Introduction.....	1-1
1.1.	Présentation générale de l'IND256x	1-1
1.2.	Spécifications du produit.....	1-2
1.3.	Normes d'essais	1-4
1.4.	Avertissements et précautions	1-6
1.5.	Inspection et liste de contrôle du contenu	1-6
1.6.	Configuration.....	1-7
1.7.	Continuité équipotentielle (EB)	1-9
1.8.	Environnement d'exploitation.....	1-9
1.9.	Dimensions.....	1-11
1.10.	Carte principale	1-13
1.11.	Cartes d'options de communication	1-13
2	Installation.....	2-1
2.1.	Ouverture de l'enceinte.....	2-1
2.2.	Installation des câbles et des connecteurs.....	2-2
2.3.	Continuité équipotentielle et mise à la masse.....	2-6
2.4.	Continuité équipotentielle (EB)	2-6
2.5.	Fermeture de l'enceinte	2-7
2.6.	Connexions aux capteurs analogiques.....	2-7
2.7.	Communication Connexion des cartes.....	2-8
2.8.	Plombage de l'enceinte.....	2-12
2.9.	Paramètres d'interface	2-13

1 Introduction

1.1. Présentation générale de l'IND256x

L'IND256x reflète la dernière technologie de pesage de METTLER TOLEDO. L'IND256x est certifié par des tiers pour le pesage en zone dangereuse et peut être utilisé directement dans les emplacements Zone 1/Zone 21.

L'IND256x est un terminal de pesage à hautes performances et à une ou plusieurs plages de pesage. Il utilise des capteurs analogiques pour obtenir un pesage fiable à faible coût, du gramme à la tonne. Il s'intègre facilement dans un système de pesage existant.

En connectant la barrière de sécurité appropriée ou la barrière isolée, l'IND256x peut fournir diverses interfaces de communication à sécurité intrinsèque pour communiquer avec les PC et les imprimantes dans la zone de sécurité. Ces caractéristiques permettent à l'IND256x de prendre en charge la majorité des applications de pesage dans la plupart des domaines industriels, notamment :

- Pharmacie
- Traitements poudrés
- Produits chimiques spéciaux
- Pétrochimie
- Agriculture
- Peintures et encres
- Génie chimique fin

1.1.1. Versions du terminal IND256x

L'IND256x est disponible selon trois choix d'alimentation différents :

- Entrée d'alimentation alternative, en utilisant une tension alternative externe 187 -250 V 50/60 Hz)
- Entrée d'alimentation continue, en utilisant une tension continue externe CC 18 -30 V)
- Entrée d'alimentation à sécurité intrinsèque, utilisant une batterie externe de type NiMH 64060627).

Chacune de ces versions a reçu les homologations ATEX et IECEx pour une utilisation dans les zones classées Zone 1 et Zone 21.

1.1.2. Caractéristiques du produit IND256x

- Pesage de base dans des zones dangereuses explosives), notamment les fonctions du zéro, de tare et d'impression
- Table de travail, enceinte murale ou sur colonne pour environnement difficile
- Se connecte à une seule plate-forme de pesée analogique

- ACL de rétroéclairage blanc de 240 x 96 pixels, chiffres de 25 mm de hauteur
- Horloge en temps réel éco nomie d'énergie)
- Inclut un port série à sécurité intrinsèque COM1) pour des communications asynchrones et bidirectionnelles ainsi qu'une sortie imprimante
- Prend en charge les cartes d'option internes suivantes :
 - Sortie analogique 4-20 mA à sécurité intrinsèque
 - Module de communication WiFi avec antenne uniquement pour les terminaux IND256x configurés en usine avec module WiFi)
 - Boucle de courant active – pour la connexion à un module de communication ACM200 situé en zone sûre, ou pour la connexion d'un deuxième terminal IND256x configuré avec option de boucle de courant passive
 - Boucle de courant passive utilisée comme deuxième écran pour connexion à un autre terminal avec une boucle de courant active)
- Prise en charge de trois entrées d'ID personnalisées
- Le tableau des valeurs cibles prend en charge 25 valeurs cibles prédéfinies pour le pesage de contrôle
- Le tableau des tares prend en charge 20 valeurs de tares prédéfinies
- Prend en charge g, kg, t, tonne, lb et once
- Enregistre les éléments de données de 60 000 transactions
- Prend en charge l'accumulation et le total cumulé
- Permet la personnalisation de cinq modèles d'impression différents
- Prend en charge l'étalonnage sans poids CalFREE™)

1.2. Spécifications du produit

Le Tableau 1-1 présente les spécifications de l'IND256x.

Tableau 1-1 : Spécifications de l'IND256x

Article	Spécifications
Enceinte	Acier inoxydable 304, pour montage mural ou sur poteau
Dimensions H × L × P)	173 mm × 230 mm × 127 mm 6,8 po × 9,1 po × 5 po)
Poids à l'expédition	3,5 kg 8 lb)
Qualité de la protection	IP66
Environnement de stockage	Plage de température de stockage : – 20 °C à 60 °C – 4 ° à 140 °F) Humidité relative : 10 à 95 % sans condensation

Article	Spécifications
Environnement de service	Plage de température d'exploitation : – 10 °C à 40 °C 14 ° à 104 °F) Humidité relative : 10 à 95 % sans condensation
Zones dangereuses	L'homologation de l'IND256x est utilisée pour les zones dangereuses Zone 1/Zone 21.
Alimentation	Alimentation CA 187 -253 V 50/60 Hz)
	Alimentation en courant continu CC 18 -30 V)
	Bloc de batteries NiMHEx externe 64060627)
Affichage	ACL de rétroéclairage blanc de 240 x 96 pixels, chiffres de 25 mm de hauteur Taux de mises à jour de l'affichage : 10 Hz
Affichage du poids	Maximum 100 000 divisions
Type de plate-forme de pesage	Capteur analogique
Quantité de capteurs	Maximum de quatre capteurs 350 ohms minimum 87 ohms), 2 mV/v ou 3 mV/v
Quantité de plate-forme de pesage	Prend en charge une plate-forme de pesage
Taux de rafraîchissement	>366 Hz
Tension d'excitation du capteur	4,5 V CC
Sensibilité minimum	0,6µV/e
Clavier	26 touches ; clavier avec membrane de 1,5 mm d'épaisseur
Mode de communication	Interface standard : La carte principale est dotée d'une interface de communication RS232 à sécurité intrinsèque Options d'interface : Sortie analogique 4-20 mA à sécurité intrinsèque, avec conversion N / A 16 bits et fréquence d'actualisation de 25 Hz vers l'API Ou module de communication WiFi uniquement pour les terminaux IND256x configurés en usine avec module WiFi) Ou boucle de courant active à sécurité intrinsèque Ou boucle de courant passive à sécurité intrinsèque Protocoles de communications : Entrée du port série : Commandes ASCII - CTPZ Effacement, Tare, Impression, Zéro), commandes SICS prend en charge les niveaux SICS 0 et 1) Sortie du port série : Sortie continue Toledo, sortie d'impression de commandes 5 modèles configurables), commandes SICS et impression de rapports
Approbation métrologique	L'Europe: OIML R76; Classe III, 6000e; TC10878 Global: OIML R76; Classe III, 6000e; R76-2006-A-NL1-18.27

Article	Spécifications
Approbations pour zones dangereuses, version configuré en usine avec module WiFi	avec une alimentation à sécurité non intrinsèque version CA et version CC) : II 2G Ex eb ib [ib] mb IIB T4 Gb II 2D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db avec batterie à sécurité intrinsèque : II 2G Ex ib IIB T4 Gb II 2D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
Approbations pour zones dangereuses, version sans WiFi	avec une alimentation à sécurité non intrinsèque version CA et version CC) : II 2G Ex eb ib [ib] mb IIC T4 Gb II 2D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db avec batterie à sécurité intrinsèque : II 2G Ex ib IIC T4 Gb II 2D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db

Tableau 1-2 : Spécifications du module WiFi uniquement pour les terminaux IND256x configurés en usine avec module WiFi)

Article	Spécifications
Standard	802.11 b/g/n
Puissance d'émission	14 dBm moyenne)
Plage des fréquences HF	2,4 GHz – 2,497 GHz
Chiffrement	WEP, WPA
WEP	64 bits, 128 bits
WPA	WPA-TKIP, WPA2-AES
Protocole	TCP/IP
Mode de travail	Serveur, Client
Distance d'émission	Maximum 50 mètres en plein air
Approbation	Chine : CSRR

1.3. Normes d'essais

Le terminal IND256x a été testé selon les normes suivantes :

EN 60079-0:2012 + A11:2013	Conditions générales
EN 60079-7:2015	Sécurité accrue « e »
EN 60079-11:2012	Sécurité intrinsèque « i »
EN 60079-18:2015	Encapsulage « m »
EN 60079-31:2014	Protection par enceinte « t »
IEC 60079-0:2017, Ed. 7.0	Conditions générales

IEC 60079-7:2017, Ed. 5.1	Sécurité accrue « e »
IEC 60079-11:2011, Ed. 6.0	Sécurité intrinsèque « i »
IEC 60079-18:2017, Ed. 4.1	Encapsulage « m »
IEC 60079-31:2013, Ed. 2.0	Protection par enceinte « t »
FM3600 2011)	Équipement électrique pour emploi dans des lieux dangereux classés comme tels) - Conditions générales
FM3610 2010)	Appareils à sécurité intrinsèque et appareils associés pour emploi dans des lieux dangereux classés comme tels) de Division 1 et de Classe I, II et III
FM3810 2005)	Appareil électrique pour mesure, contrôle et utilisation en laboratoire
ANSI/IEC 60529	Degrés de protection fournis par enceinte code IP)
CSA C22.2 N° 157-1992 / 2006	Équipement non incendiaire et à sécurité intrinsèque pour emploi dans des lieux dangereux
CSA C22.2 N° 142-1990 / 2004	Équipement de contrôle de procédé
CSA C22.2 N° 61010.1-2004	Conditions de sécurité pour équipement électrique pour mesure, contrôle et utilisation en laboratoire – Partie 1: Conditions générales
CAN/CSA 22.2 N° 60529-2005	Degrés de protection fournis par enceinte code IP)

1.3.1. Conditions particulières d'utilisation

1. L'appareil doit être protégé de la lumière UV.
2. La charge électrostatique pendant le fonctionnement et l'entretien doit être exclue. Le terminal ne doit être installé que dans les zones où il n'y a pas de charges électrostatiques liées à l'exploitation et au processus.
3. Pour les versions avec alimentation CC à sécurité non intrinsèque référence se terminant par « 44 » ou « 46 ») : Il n'y a pas de séparation galvanique entre les circuits d'alimentation à sécurité non intrinsèque et les circuits de sortie à sécurité intrinsèque :

Le circuit d'alimentation à sécurité non intrinsèque doit être relié à la terre en toute sécurité. Dans ce cas, les circuits à sécurité intrinsèque sont également mis à la terre. Le long des circuits à sécurité intrinsèque, il doit y avoir une compensation de potentiel.

ou

Le circuit à sécurité non intrinsèque doit être séparé de la terre en toute sécurité par ex., circuit SELV).
4. Pour le terminal en version CC, le circuit d'alimentation doit avoir une catégorie de surtension maximale II conformément à CEI 60664-1.
5. Les presse-étoupes série HSK-M-Ex.... et V-Ms-Ex... conformément à KEMA 99 ATEX 6971X resp. IECEx BVS 07.0014X sont testés avec une force de traction réduite 25 %) conformément à la clause A.3.1 si CEI 60079-0 et ne peuvent être utilisés que pour une installation fixe d'appareils du groupe II. L'utilisateur doit s'assurer que le câble est correctement serré.
6. L'antenne WiFi est testée pour un faible risque de danger mécanique hauteur d'impact de 0, 4 m avec une masse de 1 kg) et doit être protégée contre les niveaux d'énergie d'impact élevés.

1.4. Avertissements et précautions

Veuillez lire attentivement ces instructions avant de mettre le nouveau terminal en service.

Bien que l'IND256x soit robuste, il reste néanmoins un instrument de précision. Installez et manipulez le terminal avec soin.

	 AVERTISSEMENT
	N'INSTALLEZ PAS ET N'EFFECTUEZ AUCUN ENTRETIEN SUR CET ÉQUIPEMENT AVANT QUE LA ZONE N'AIT ÉTÉ SÉCURISÉE COMME NON DANGEREUSE PAR LE PERSONNEL AUTORISÉ À LE FAIRE ET PAR LA PERSONNE RESPONSABLE SUR LE SITE DU CLIENT.
	 AVERTISSEMENT
	SEULS LES COMPOSANTS INDICUÉS DANS CE MANUEL PEUVENT ÊTRE UTILISÉS DANS CE TERMINAL. LES ÉQUIPEMENTS DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES DU MANUEL. DES COMPOSANTS INCORRECTS OU DE REMPLACEMENT ET/OU DES ÉCARTS PAR RAPPORT À CES INSTRUCTIONS PEUVENT COMPROMETTRE LA SÉCURITÉ INTRINSÈQUE DU TERMINAL ET ÊTRE À L'ORIGINE D'ACCIDENTS ET/OU DE DOMMAGES MATÉRIELS.
	 AVERTISSEMENT
	NE PAS OUVRIR LORSQUE L'APPAREIL EST SOUS TENSION.
	 AVERTISSEMENT
	DANGER POTENTIEL DE CHARGE ÉLECTROSTATIQUE - VOIR INSTRUCTIONS.
	 AVERTISSEMENT
	NE PAS OUVRIR EN PRÉSENCE D'UNE ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE.
	 AVERTISSEMENT
	LE TERMINAL ASSEMBLÉ AVEC L'ANTENNE WIFI DOIT ÊTRE INSTALLÉ DANS UNE POSITION TELLE QUE LE RISQUE DE DOMMAGE MÉCANIQUE SOIT FAIBLE. REMPLACER IMMÉDIATEMENT L'ANTENNE WIFI SI ELLE EST ENDOMMAGÉE !

1.5. Inspection et liste de contrôle du contenu

Dès la réception de l'IND256x, vérifiez que l'emballage est intact. Si l'emballage est endommagé, vérifiez si l'IND256x a subi des dommages et, si nécessaire, déposez une réclamation de fret auprès du transporteur. Si l'emballage n'est pas endommagé, déballez l'IND256x, en prêtant attention à son emballage d'origine et vérifiez que rien n'est endommagé.

- Pour assurer un transport sûr, il est préférable d'utiliser l'emballage d'origine et la méthode d'emballage correcte.

L'emballage contient :

- Terminal de pesage IND256x
- CD de documentation (notamment le manuel et le certificat d'inspection)
- Sac d'accessoires pour utilisation lors de l'installation

1.6. Configuration

1.6.1. Configuration des systèmes

Figure 1-1 présente les options de configuration du terminal.

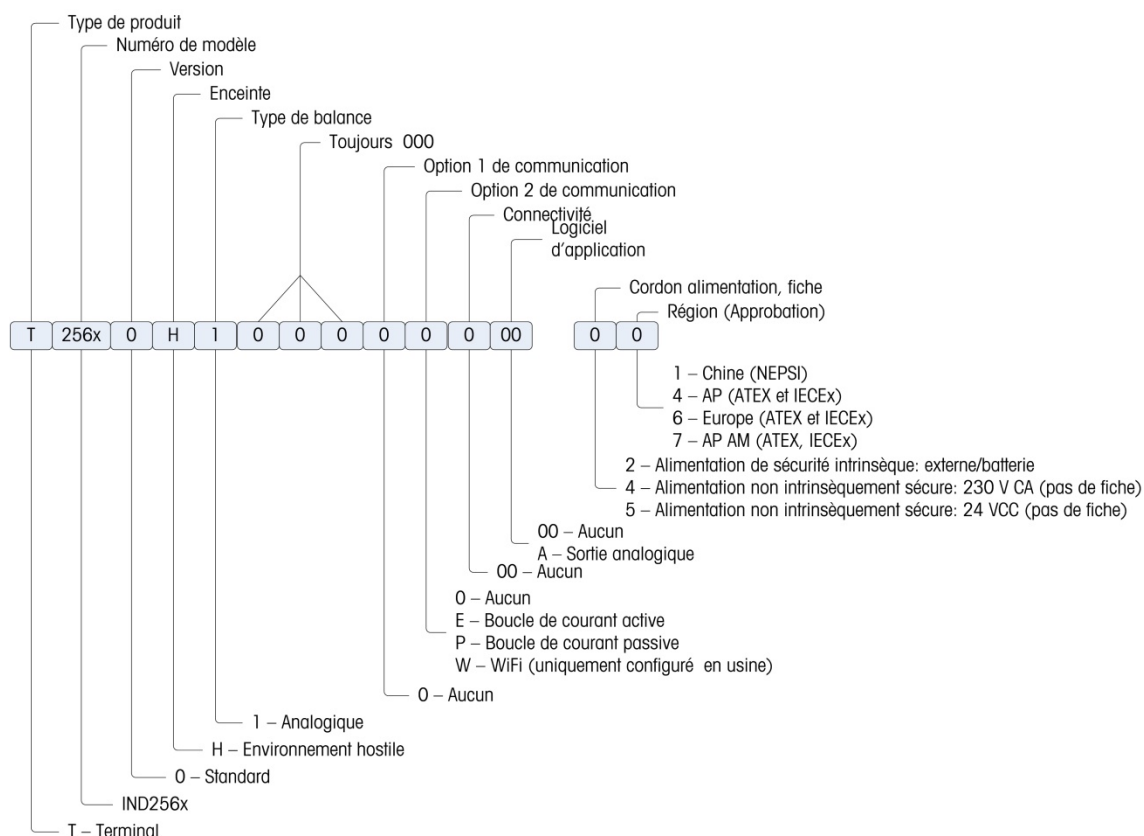


Figure 1-1 : Schéma de configuration de l'IND256x

	AVERTISSEMENT
	LES TERMINAUX IND256X CONFIGURÉS EN USINE AVEC WIFI SONT HOMOLOGUÉS POUR UNE UTILISATION DANS DES ZONES CLASSÉES ZONE 1 GROUPE D'ÉQUIPEMENT IIB. LES TERMINAUX IND256X CONFIGURÉS EN USINE AVEC WIFI NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS DANS DES ZONES CLASSÉES GROUPE D'ÉQUIPEMENT IIC. L'UTILISATION D'UN TERMINAL IND256X CONFIGURÉ EN USINE AVEC WIFI DANS UNE ZONE CLASSÉE POUR LAQUELLE IL N'EST PAS HOMOLOGUÉ EST SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER DES BLESSURES ET/OU D'ENDOMMAGER L'ÉQUIPEMENT.

AVIS

LA CAPACITÉ WIFI EST UNIQUEMENT DISPONIBLE DANS LES TERMINAUX IND256x CONFIGURÉS AINSI À L'USINE.

1.6.2. Code date du produit

La date de fabrication du produit ou le code de date du terminal se trouve sur la plaque du numéro de série en partie supérieure de l'enceinte).

Le numéro de série commence par une lettre et un numéro par exemple, B212000371). La lettre représente les trois premiers chiffres de l'année conformément au Tableau 1-3 la lettre B dans notre exemple représente 201x) et le numéro correspond au chiffre des unités de l'année le chiffre 2 dans notre exemple). C'est pourquoi B4 signifie l'année 2014.

Tableau 1-3 : Formats de code date actuels et anciens

Code Date	Année	Code de date	Année
A	200x	F	205x
B	201x	G	206x
C	202x	H	207x
D	203x	J	208x
E	204x	K	209x

1.6.3. Connexions

La figure suivante présente les emplacements de connexion à l'arrière de l'enceinte pour environnement difficile.

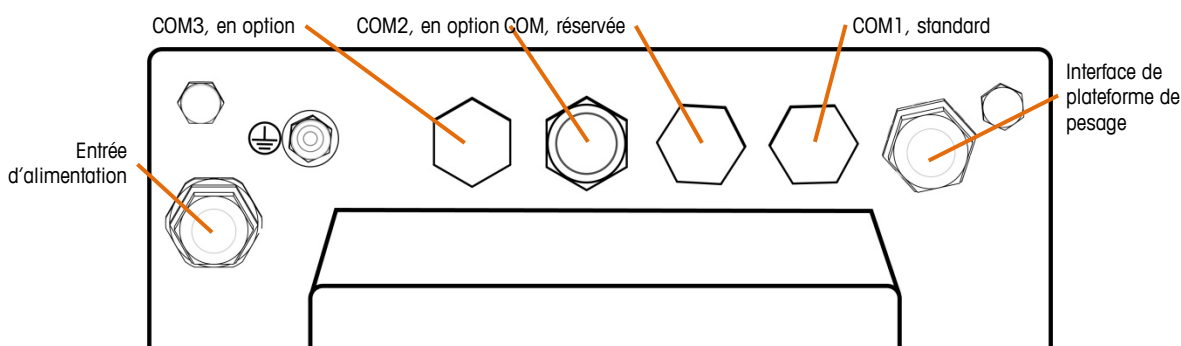


Figure 1-2 : Emplacements des ports de connexion de l'IND256x

Entrée d'alimentation	Alimentation 220 V CA 187 -250 V 50/60 Hz) version ATEX et IECEx) ou alimentation CC 24 V 18 -30 V) version ATEX et IECEx) ou batterie Ex externe
COM1 standard)	RS232 à sécurité intrinsèque
COM2 en option)	sortie analogique 4-20 mA à sécurité intrinsèque ou module de

	communication WiFi uniquement configurés en usine)
COM3 en option)	boucle de courant active à sécurité intrinsèque ou boucle de courant passive à sécurité intrinsèque
COM réservé	Non utilisé

1.6.4. Avertissements

1.6.4.1. CENELEC

Connexion de l'EB selon les réglementations spécifiques à chaque pays : Vous devez vous assurer que les enceintes de tous les dispositifs sont connectées au même potentiel au moyen des bornes EB de continuité. Aucun courant de circulation ne peut s'écouler par le blindage des câbles à sécurité intrinsèque.

1.6.4.2. cFMus

Connexion de l'EB selon ANSI/NFPA 70, Article 504, et ANSI/IA RP 12.06.01 ou selon le Code électrique canadien C22.2 : Vous devez vous assurer que les enceintes de tous les dispositifs sont connectées au même potentiel au moyen des bornes EB de continuité. Aucun courant de circulation ne peut s'écouler par le blindage des câbles à sécurité intrinsèque.

1.7. Continuité équipotentielle EB)

Une continuité équipotentielle doit être installée par un électricien agréé par le propriétaire. METTLER TOLEDO Service offre seulement une fonction de surveillance et de consultation pour cette procédure.

Connectez la continuité équipotentielle de tous les dispositifs alimentation, terminal de pesage, convertisseur d'interface et plate-forme de pesage) conformément au schéma du terminal et aux normes et réglementations spécifiques à chaque pays. Au cours de ce processus, assurez-vous que :

- Toutes les enceintes des dispositifs sont connectées au même potentiel au moyen des terminaux EB.
- Aucun courant de circulation ne s'écoule par le blindage des câbles à sécurité intrinsèque.
- Le point neutre de la continuité équipotentielle est aussi proche que possible du système de pesage.

1.8. Environnement d'exploitation

Lors de la sélection d'un emplacement :

- Choisissez une surface stable, sans vibration, pour assembler le terminal
- Assurez-vous de l'absence de variations excessives de température et de l'absence d'une exposition directe à la lumière du soleil

- Évitez les courants d'air sur la plate-forme de pesage tels que l'air provenant de fenêtres ouvertes ou de la climatisation)
- Calibrez le terminal après tout changement important d'emplacement géographique

1.8.1.1. Température et humidité

L'IND256x peut être entreposé et exploité à des températures et à des conditions d'humidité relative telles qu'énumérées au Tableau 1-1.

1.8.1.2. Protection de l'environnement

Le terminal IND256x a une protection de l'environnement comme indiqué au Tableau 1-1.

1.9. Dimensions

Les Figure 1-3 et Figure 1-4 présentent les dimensions du terminal. Les unités sont en pouces et [mm].

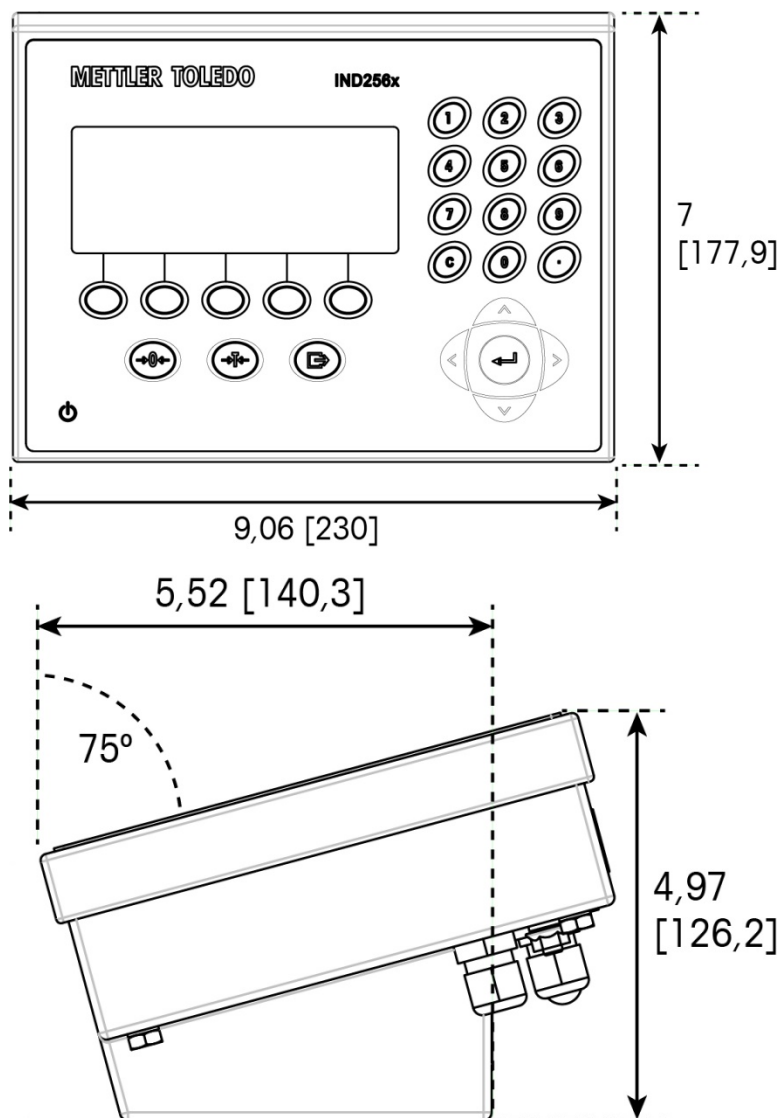


Figure 1-3 : Dimensions de l'IND256x, installation de bureau

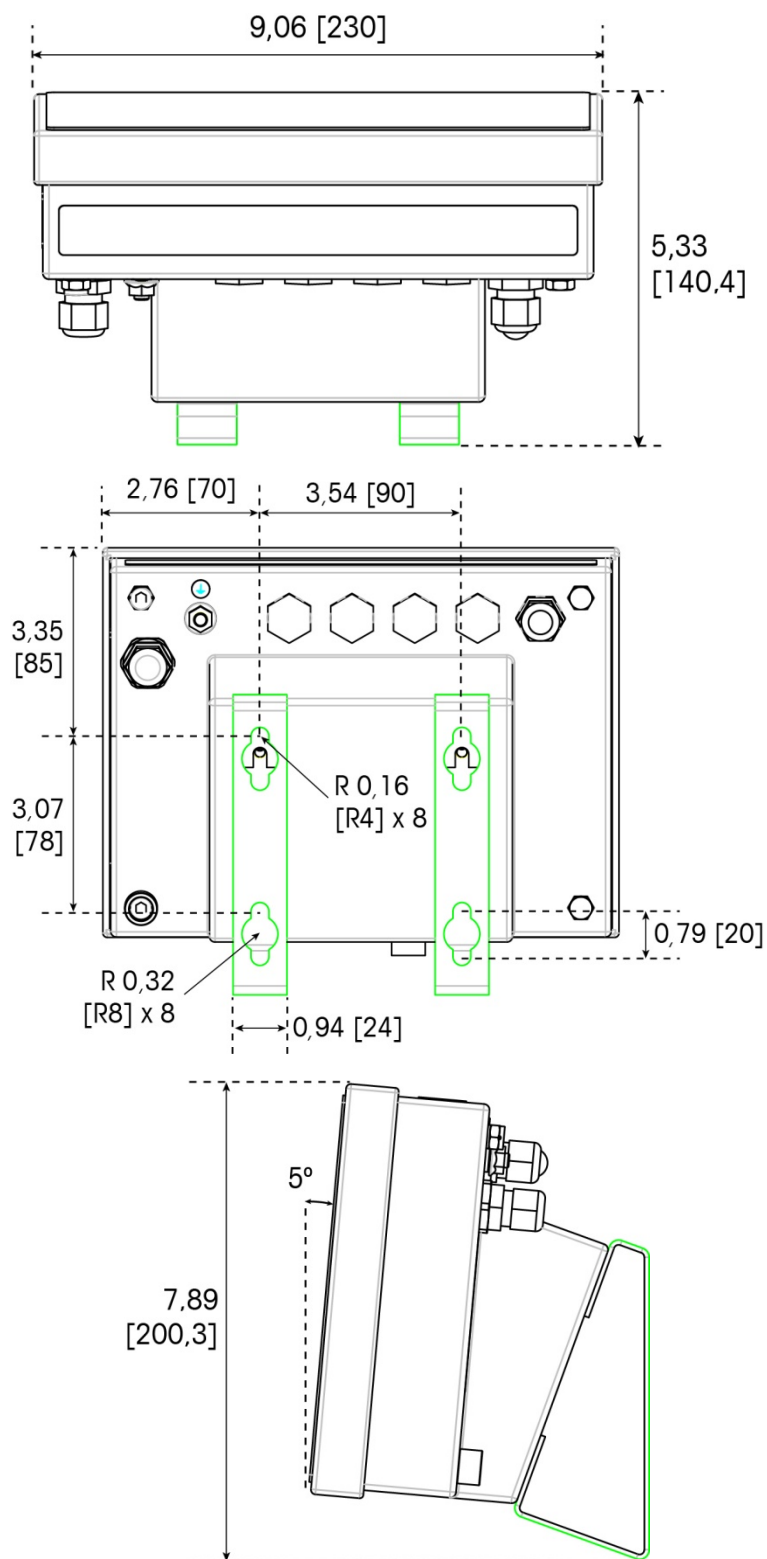


Figure 1-4 : Dimensions de l'IND256x, avec support mural fixe

1.10. Carte principale

La carte principale de l'IND256x possède les connexions principales suivantes, indiquées sur la Figure 1-5 :

1. Interface de pesage de capteur analogique
2. Interface d'alimentation à sécurité intrinsèque, connexion du module d'alimentation
3. Interface avec limande utilisée pour la connexion à l'affichage
4. Interface RS232 à sécurité intrinsèque COM1)
5. Deux interfaces de carte d'options de communication COM2 et COM3)

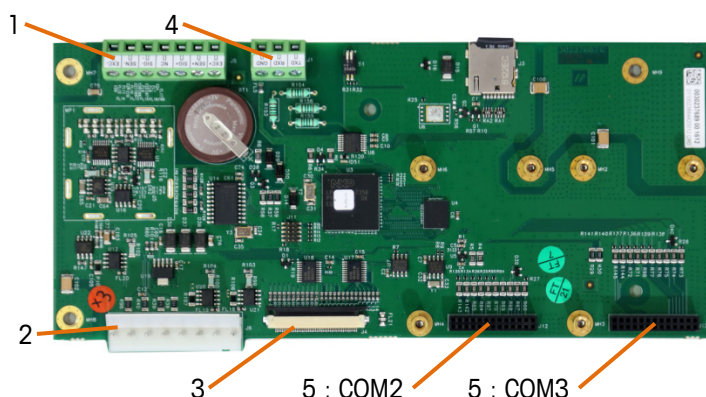


Figure 1-5 : Carte principale de l'IND256x

1.11. Cartes d'options de communication

L'IND256x peut être configuré avec un maximum de deux des trois cartes d'options de communication installées à l'intérieur de son enceinte. Les options sont les suivantes :

- Module de communication WiFi disponible uniquement dans les terminaux IND256x configurés en usine avec WiFi)
- Sortie analogique 4-20 mA à sécurité intrinsèque
- Boucle de courant active pour la connexion au module de communication ACM200 situé en zone sûre, ou pour la connexion d'un deuxième terminal IND256x configuré avec option de boucle de courant passive
- Boucle de courant passive utilisée comme deuxième écran pour connecter un autre IND256x avec une boucle de courant active)

2 Installation

2.1. Ouverture de l'enceinte

	 AVERTISSEMENT
	N'INSTALLEZ PAS ET N'EFFECTUEZ AUCUN ENTRETIEN SUR CET ÉQUIPEMENT AVANT QUE LA ZONE N'AIT ÉTÉ SÉCURISÉE COMME NON DANGEREUSE PAR LE PERSONNEL AUTORISÉ À LE FAIRE ET PAR LA PERSONNE RESPONSABLE SUR LE SITE DU CLIENT.
	 MISE EN GARDE
	CONFIRMEZ LA CONFORMITÉ AUX RÉGLEMENTATIONS WIFI NATIONALES ET LOCALES EN VIGUEUR AVANT D'INSTALLER ET DE METTRE EN SERVICE LE TERMINAL IND256x CONFIGURÉ AVEC LE MODULE WIFI. METTLER TOLEDO DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES INSTALLATIONS DE TERMINAUX DANS DES PAYS OÙ LES RÉGLEMENTATIONS EN MATIÈRE DE WIFI NE SONT PAS RESPECTÉES.
	 AVERTISSEMENT
	PRÉVENTION DE L'INFLAMMATION DE GAZ DANGEREUX. ASSUREZ-VOUS DE COUPER L'ALIMENTATION AVANT D'OUVRIR L'ENCEINTE DE L'IND256X. APRÈS AVOIR MIS L'IND256X SOUS TENSION, MAINTENEZ L'ENCEINTE STRICTEMENT SCELLÉE. N'OUVREZ PAS L'ENCEINTE EN PRÉSENCE DE POUSSIÈRES OU DE GAZ EXPLOSIFS.

Ouvrez le terminal IND256x conformément aux étapes décrites dans les sections suivantes.

Le capot avant du terminal IND256x est fixé par 4 vis. Pour la configuration matérielle à l'intérieur de l'instrument, ouvrez-le comme indiqué ci-dessous

1. Placez le terminal avec la face avant vers le bas sur une surface plane, en prenant soin de ne pas endommager le bandeau.
2. Dévissez les quatre vis imperdables comme indiqué sur la Figure 2-1.



Figure 2-1 : Vis de l'enceinte

3. Soulevez le capot arrière et retournez-le pour en exposer l'intérieur. Veuillez noter la présence de deux courroies qui fixent le panneau avant à l'enceinte.

2.2. Installation des câbles et des connecteurs

Les câbles et les connecteurs du terminal IND256x sont les suivants

- Presse-étoupe des câbles de l'enceinte pour environnement difficile
- Connexions de câblage de la carte principale
- Connexion d'alimentation

	AVERTISSEMENT
	SEUL UN PERSONNEL PROFESSIONNEL DE MAINTENANCE EST AUTORISÉ À FAIRE FONCTIONNER CET INSTRUMENT. SOYEZ PRUDENT PENDANT L'INSPECTION, LES TESTS ET LES RÉGLAGES. UN FONCTIONNEMENT INCORRECT PEUT ÊTRE À L'ORIGINE D'UN ACCIDENT.

Le terminal IND256x convient aux environnements de lavage à grande eau et de dépoussiérage. Toutefois, il est nécessaire d'accéder à l'intérieur de l'enceinte du terminal lors de l'installation de câbles et/ou de connecteurs. Un emplacement spécifique est attribué à chaque câble pénétrant dans l'enceinte.

2.2.1. Presse-étoupe des câbles de l'enceinte pour environnement difficile

Pour assurer l'étanchéité à l'eau et à la poussière

1. Faites passer les câbles de taille appropriée à travers le presse-étoupe correct avant de connecter les fils. Selon la taille du presse-étoupe, utilisez des câbles d'un diamètre spécifique. La dimension requise des câbles est présentée sur le Tableau 2-1.

Tableau 2-1 : Diamètres des câbles pour presse-étoupe

Presse-étoupe	Diamètre des câbles
Capteur analogique	6 – 10 mm (0,24 – 0,39 po)
COM1 (IS-RS232)	6 – 10 mm (0,24 – 0,39 po)
Boucle de courant (active et passive)	6 – 10 mm (0,24 – 0,39 po)
Câble d'alimentation CA/CC	6 – 10 mm (0,24 – 0,39 po)
Sortie analogique 4-20 mA	6 – 10 mm (0,24 – 0,39 po)
Batterie externe	4-8 mm (0,16 – 0,3 po)

Notes importantes

- Utilisez uniquement des presse-étoupe et des préformes certifiés ATEX avec le terminal IND256x
 - Les presse-étoupes doivent être protégés contre les dommages dus aux chocs.
 - Une décharge de traction suffisante doit être assurée pour éviter des forces de traction sur les presse-étoupes.
2. Lorsque vous effectuez des raccordements de câbles à l'intérieur d'une enceinte pour environnement difficile, assurez-vous que la longueur du câble entre le bornier/le connecteur et l'enceinte du terminal est suffisante pour qu'aucune traction ne soit exercée sur le connecteur lorsque l'enceinte est en position totalement ouverte.
 3. Le blindage des câbles blindés doit se terminer sur le presse-étoupe comme indiqué sur la Figure 2-2. Séparez les câbles et leur blindage, et assurez-vous que la quantité de blindage est suffisante pour assurer un bon contact avec la partie métallique du presse-étoupe.

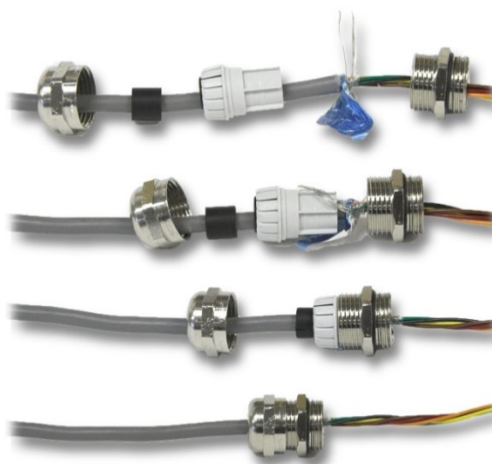


Figure 2-2 : Terminaison de la gaine au niveau du presse-étoupe

2.2.2. Connexion d'alimentation

	 AVERTISSEMENT
	LA CONNEXION AU SECTEUR DE L'ALIMENTATION DOIT ÊTRE RÉALISÉE PAR UN ÉLECTRICIEN PROFESSIONNEL AGRÉÉ PAR LE PROPRIÉTAIRE ET CONFORMÉMENT AU SCHÉMA DU TERMINAL CORRESPONDANT, AUX INSTRUCTIONS D'INSTALLATION AINSI QU' AUX RÉGLEMENTATIONS SPÉCIFIQUES DU PAYS.

Lorsque IECEx et ATEX sont acceptés, l'IND256x peut être alimenté par

- Une alimentation interne connectée à une alimentation externe sous 230 V AC ou 24 V CC, ou
- Une batterie NiMH externe (réf 64060625).

L'IND256x peut utiliser l'une des trois cartes d'alimentation encapsulées, chacune prenant en charge une entrée d'alimentation différente. L'alimentation s'effectue au moyen d'un connecteur à sécurité renforcé situé dans le coin droit à l'intérieur de l'enceinte (Figure 2-3). Le connecteur est protégé par un couvercle en plastique.

Pour la version avec une alimentation en alternatif ou en continu, le terminal reçoit un câble d'alimentation de 5 m sans prise. Les terminaux avec alimentation à sécurité intrinsèque sont livrés sans câble d'alimentation.

2.2.2.1. Alimentation interne CA (terminaux approuvés IECEx et ATEX uniquement)

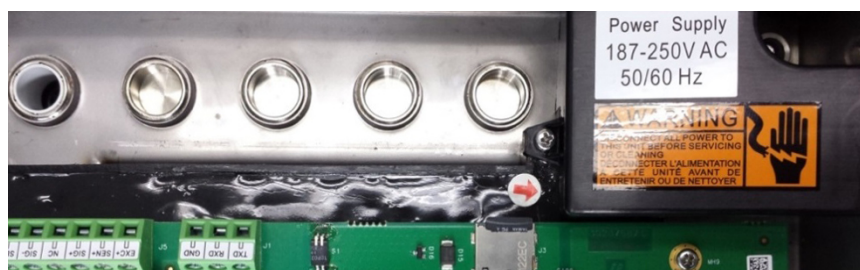


Figure 2-3 : Connecteur de l'alimentation CA avec couvercle



Figure 2-4 : Connecteur de l'alimentation CA sans couvercle

Tableau 2-2 : Code couleur du câble d'alimentation CA

Broche	Couleur de la broche
L	Marron
N	Bleu

2.2.2.2. Alimentation interne CC (terminaux approuvés IECEx et ATEX uniquement)

	 AVERTISSEMENT
	L'ALIMENTATION CC DOIT ÊTRE CONNECTÉE À UNE SOURCE CC DE 18 À 30 V. NE BRANCHEZ PAS LE TERMINAL À UNE SOURCE D'ALIMENTATION CA
	 AVERTISSEMENT
	POUR LES TERMINAUX IND256x VERSION CC, IL N'Y A PAS DE SÉPARATION GALVANIQUE ENTRE LE CIRCUIT D'ALIMENTATION À SÉCURITÉ NON INTRINSÈQUE ET LES CIRCUITS DE SORTIE À SÉCURITÉ INTRINSÈQUE. LE CIRCUIT À SÉCURITÉ NON INTRINSÈQUE DOIT ÊTRE RELIÉ À LA TERRE EN TOUTE SÉCURITÉ. ET L'ÉGALISATION DE POTENTIEL DOIT EXISTER LE LONG DES CIRCUITS À SÉCURITÉ INTRINSÈQUE. LE CIRCUIT D'ALIMENTATION À SÉCURITÉ NON INTRINSÈQUE (SELV) DOIT ÉGALEMENT ÊTRE SÉPARÉ DE LA TERRE EN TOUTE SÉCURITÉ.
	 AVERTISSEMENT
	L'ALIMENTATION EN COURANT CONTINU FOURNIE PAR LE CLIENT EXTERNE DOIT AVOIR UNE CATÉGORIE DE SURTENSION MAXIMALE II SELON LA NORME IEC 60664-1.

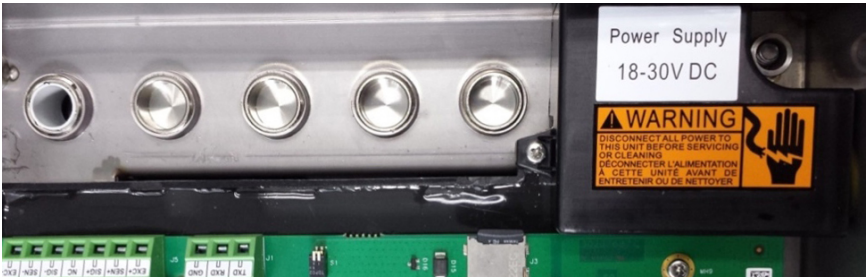


Figure 2-5 : Connecteur d'entrée d'alimentation CC avec bouchon de protection

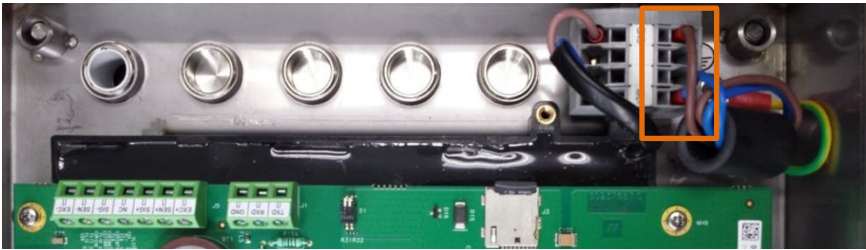


Figure 2-6 : Connexions d'entrée d'alimentation CC, vue interne

Tableau 2-3 : Code couleur du câble d'entrée de l'alimentation CC

Broche	Couleur de la broche
MASSE	Marron
+24 V	Bleu

2.2.2.3.

Source d'alimentation externe NiMH

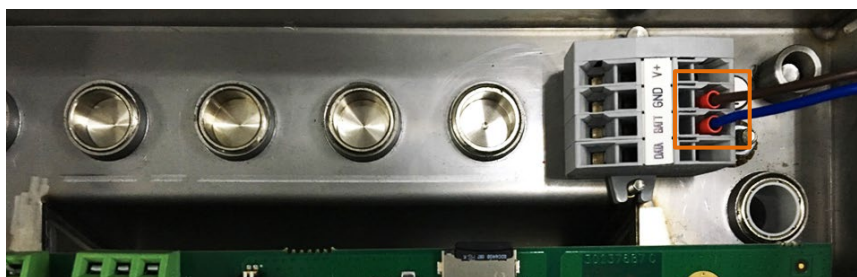


Figure 2-7 : Connexions de la batterie d'alimentation NiMH, vue interne

Tableau 2-3 : Code couleur du câble de la batterie NiMH

Broche	Couleur de la broche
DONNÉES	Vide
BATT	Bleu
MASSE	Marron
V+	Vide

2.3. Continuité équipotentielle et mise à la masse

Toutes les connexions de mise à la masse et de continuité équipotentielle doivent être effectuées selon la réglementation locale en fonction du pays d'installation. Reportez-vous aux règlements locaux et aux schémas de contrôle pour plus d'informations spécifiques sur la mise à la masse.

En principe, les règlements locaux exigent que toutes les pièces connectées de l'équipement d'un système soient reliées ensemble pour la continuité et la mise à la masse en un seul point. Le terminal IND256x dispose d'une vis de masse externe spécialement conçue pour la continuité équipotentielle (Figure 2-8).



Figure 2-8 : Vis de masse du terminal IND256x

2.4. Continuité équipotentielle (EB)

La continuité équipotentielle doit être installée par un électricien agréé par le propriétaire. La maintenance de METTLER TOLEDO offre seulement une fonction de surveillance et de consultation pour cette procédure.

Connectez la continuité équipotentielle de tous les dispositifs (alimentation, terminal de pesage, convertisseur d'interface et plate-forme de pesage) conformément au schéma du terminal et aux normes et réglementations spécifiques à chaque pays. Au cours de ce processus, assurez-vous que

- Toutes les enceintes des dispositifs sont connectées au même potentiel au moyen des bornes EB de continuité.
- Aucun courant de circulation ne s'écoule par le blindage des câbles des circuits à sécurité intrinsèque.
- Le neutre de la liaison de continuité équipotentielle est aussi proche que possible du système de pesage.

2.4.1. Avertissements

2.4.1.1. CENELEC

2.4.1.1.1. Connexion de la continuité équipotentielle selon les réglementations spécifiques à chaque pays

Vous devez vous assurer que les enceintes de tous les dispositifs sont connectées au même potentiel au moyen des bornes EB de continuité. Aucun courant de circulation ne peut s'écouler par le blindage des câbles à sécurité intrinsèque.

2.4.1.2. cFMus

2.4.1.2.1. Connexion de la continuité EB conformément à ANSI/NFPA 70, Article 504, et à ANSI/IA RP 12.06.01 ou conformément à la Réglementation électrique canadienne C22.2

Vous devez vous assurer que les enceintes de tous les dispositifs sont connectées au même potentiel au moyen des bornes EB de continuité. Aucun courant de circulation ne peut s'écouler par le blindage des câbles à sécurité intrinsèque.

2.5. Fermeture de l'enceinte

Assurez-vous que le capot avant est correctement installé

- Placez le capot avant sur une surface plane
- Assurez-vous que le joint d'étanchéité est correctement positionné
- Installez le capot arrière et assurez-vous qu'il est correctement positionné
- Installez les vis dans leurs positions d'origine
- Serrez chaque vis à 3 Nm

2.6. Connexions aux capteurs analogiques

Les capteurs analogiques sont connectés à la carte principale au moyen du connecteur présenté au Chapitre 1, Introduction.

Le terminal IND256x est conçu pour alimenter 4 capteurs de 350 ohms (ou une résistance minimum d'environ 87 ohms). Afin de confirmer que la charge du capteur pour l'installation se trouve dans les limites, la résistance totale de la bascule (TSR) doit être calculée.

Calcul de la TSR

$$\text{TSR} = \frac{\text{Résistance d'entrée des capteurs (}\Omega\text{hms)}}{\text{Nombre de capteurs}}$$


Assurez-vous que la TSR du réseau de capteurs devant être connecté à l'IND256x présente une résistance supérieure à 87 ohms avant de connecter les capteurs. Si la résistance est inférieure à 87 ohms, l'IND256x ne fonctionnera pas correctement.

De plus, la longueur maximum du câble doit être reconsidérée. Le Tableau 2-4 fournit les longueurs maximales recommandées du câble en fonction de son calibre et du fonctionnement correct du terminal. Veuillez noter que les valeurs d'entité du câble du capteur doivent être considérées en tant que facteur de sécurité dans l'installation.

Tableau 2-4 : Longueurs maximales recommandées des câbles

TSR (Ohms)	Calibre 24 (m/pi)	Calibre 20 (m/pi)	Calibre 16 (m/pi)
De un à quatre-350 Ω capteurs	60/200	182/600	304/1000

La Figure 2-9 présente le câblage des capteurs analogiques. Lorsqu'un capteur à quatre conducteurs est utilisé, +Exc doit être connecté à +Sen et -Exc doit être connecté à -Sen.

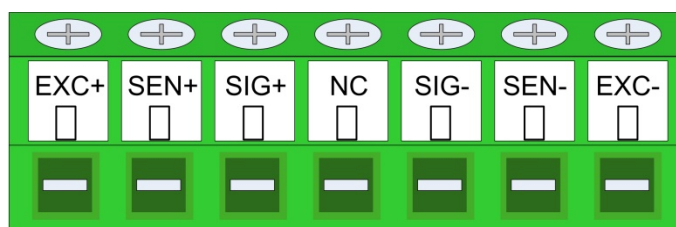

REMARQUES

1. TAILLE FIL: 18 AWG (0.823 mm²) MAX., 24 AWG (0.205 mm²) MIN.
2. MASSE DU CHÂSSIS: PRESS-ÉTOUPE METALLIQUE

Figure 2-9 : Terminaison du capteur

2.7. Communication Connexion des cartes

2.7.1. Port série (COM1)

Le port COM1 comprend des connexions pour un dispositif série à sécurité intrinsèque. La Figure 2-10 indique le connecteur de port COM1. La longueur du câble de cette connexion est limitée à 10 m (33 pi).

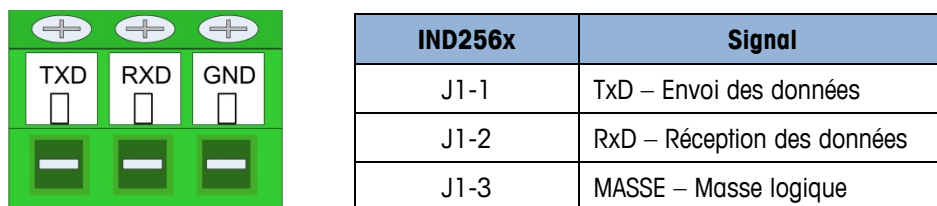


Figure 2-10 : Signaux du port COM1

Un exemple de connexion à un dispositif RS-232 dans la zone de sécurité utilisant une barrière de diodes Zener est présenté sur la Figure 2-11. Reportez-vous aux valeurs d'homologation de l'entité du COM1 lors de la sélection d'une barrière. Veuillez noter que des joints et d'autres dispositifs de protection seront également requis pour respecter les réglementations sur le câblage dans des zones dangereuses.

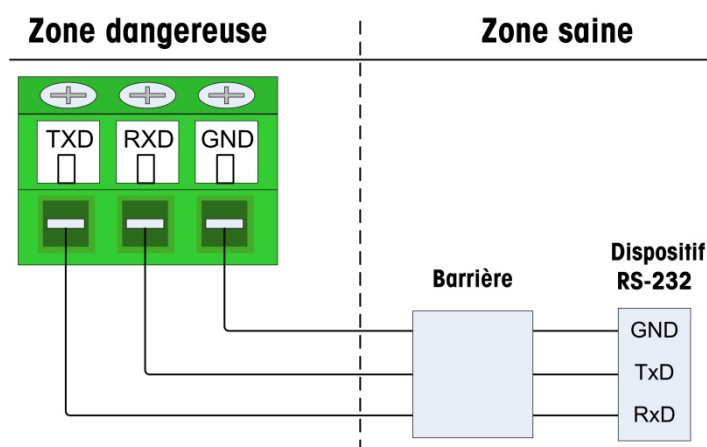


Figure 2-11 : Exemple de connexion RS-232

Une barrière ayant été testée pour un fonctionnement correct avec l'IND256x et pouvant être connectée directement au COM1, est :

- MTL7761Pac (homologations IECEx et ATEX)

2.7.2. Boucle de courant active


La carte d'option de boucle de courant active ne peut être installée que dans la prise COM3 de la carte principale. Lorsque l'IND256x est connecté à l'ACM200, vous devez connecter l'ACM200 avec la boucle de courant active pour assurer la communication dans la zone de sécurité.

Tableau 2-5 : Connexion de la boucle de courant active sur l'ACM200

IND256x COM3 (J2)	ACM200 COM (J3)
1	4
2	3
3	2
4	1

Les câbles spécifiques du client pour les circuits à sécurité intrinsèque doivent être adaptés comme suit

	IND256x – ACM200
Câble	2 x 2 x 0,5 mm ²
Dimension A (IND256x)	110 mm (2,4 po)
Dimension B (ACM200)	70 mm (2,8 po)
Longueur maxi.	300 m (1000 pieds)

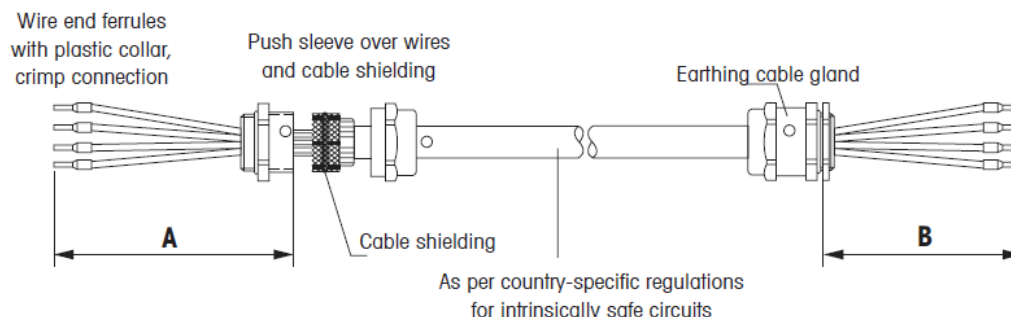

- Coupez le câble à la longueur et dénudez-en les extrémités selon la dimension A/B.
- Raccourcissez le blindage du câble aux deux extrémités de 10 mm (0,4 po).
- Dénudez l'extrémité des câbles.
- Sertissez les bagues sur les extrémités des câbles avec un outil de sertissage.
- Poussez la deuxième section arrière du presse-étoupe de masse sur le câble.
- Appliquez le blindage du câble uniquement sur l'extrémité destinée à l'IND256x en poussant le manchon sur les conducteurs et le blindage du câble, et en le repliant sur le blindage.
- Poussez la partie avant du presse-étoupe et vissez-la sur la section arrière.

2.7.3. Boucle de courant passive

Si le terminal IND256x est connecté à un autre système de pesage IND256x en tant qu'affichage à distance, l'interface de la boucle de courant passive doit être connectée à la boucle de courant active d'un autre terminal IND256x. La boucle de courant passive ne peut être installée que dans la prise COM3 de la carte principale.

Tableau 2-6 : Connexion d'une boucle de courant passive entre terminaux

IND256x COM3 (boucle de courant passive J4) (Affichage distant)		IND256x COM3 (boucle de courant active J2) (Instrument se connectant à la plate-forme de pesage)
1	←→	1
2	←→	2
3	←→	3
4	←→	4

2.7.4. Sortie analogique 4-20 mA à sécurité intrinsèque

La carte de communication analogique 4-20 mA à sécurité intrinsèque en option se connecte au port COM2 de la carte mère de l'IND256x. Elle fournit un signal analogique 4-20 mA à sécurité intrinsèque, proportionnel au poids appliqué sur la balance ou au taux de variation du poids sur la balance. La longueur de câble maximale pour la connexion de sortie analogique est de 300 m / 980 pi. Le câble utilisé pour le signal de sortie analogique doit être blindé.

■ Cette option ne peut pas être utilisée avec l'option WiFi.



Figure 2-12 : Carte d'option de sortie analogique à sécurité intrinsèque

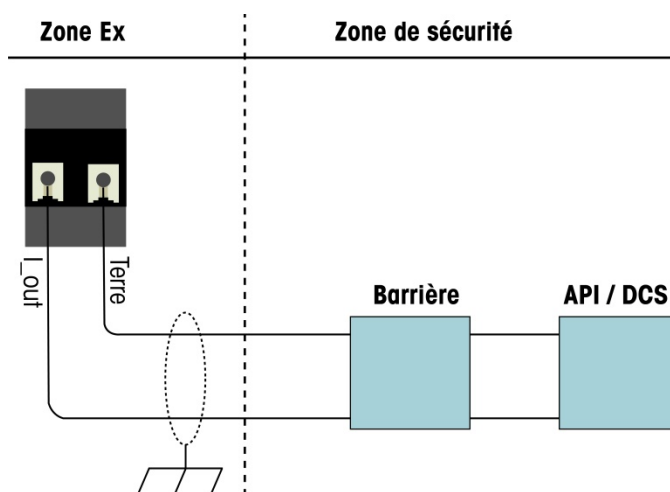


Figure 2-13 : Câblage de sortie analogique

La barrière isolée analogique KFD2-STC4-EX1 produite par P&F (numéros de certificat : IECEx BAS 04.0016X; BAS 99 ATEX 7060X) a été vérifiée et peut être raccordée directement avec l'option analogique 4-20 mA à sécurité intrinsèque de l'IND256x, puis raccordée à un système PLC ou DCS dans la zone sans danger.

2.7.5. Communication sans fil

La carte de communication sans fil en option de l'IND256x est installée sur la carte mère avec d'autres cartes en option et n'est pas connectée aux périphériques. L'option doit être configurée comme décrit au Chapitre 3, section 3.8.4. Un signal WiFi puissant est nécessaire pour obtenir une communication sans fil avec les périphériques.

L'IND256x prend en charge une seule option WiFi.

- Cette option ne peut pas être utilisée avec l'option de sortie analogique 4-20 mA à sécurité intrinsèque.

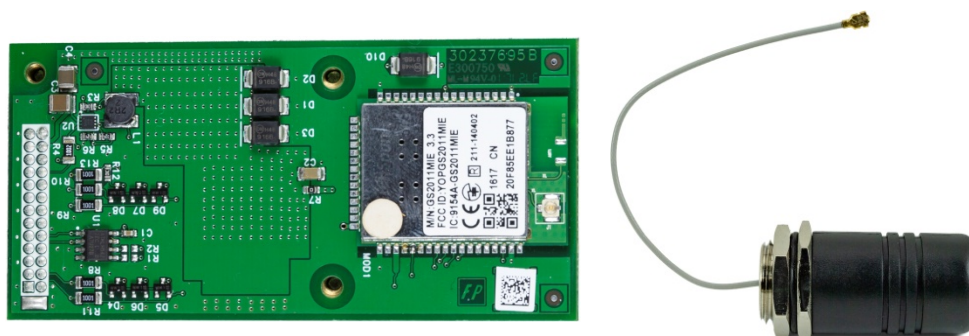


Figure 2-14 : Carte d'option WiFi IND256x et antenne

2.8. Plombage de l'enceinte

Lorsque le terminal IND256x est utilisé dans une application métrologiquement « approuvée », il doit être protégé contre les altérations par des sceaux. Les versions IND256x comprennent le kit de sceaux en option.

La méthode utilisée pour apposer les sceaux varie en fonction des exigences locales. L'IND256x prend en charge l'apposition de sceaux externes.

2.8.1. Sceau externe de l'enceinte, États-Unis

Les détails du joint au plomb de l'IND256x sont présentés sur la REF _Ref497387340 \h * MERGEFORMAT Figure A - 13. La procédure est la suivante

11. Déterminez si la zone correcte a été sélectionnée sous **Bascule > Type > Homologation** et réglez le commutateur métrologique SW1-1 sur MARCHE (reportez-vous au chapitre 2, **Fonctionnement**, pour l'emplacement et la fonction de ce commutateur).
12. Passez le fil de plombage à travers les deux boulons de plombage adjacents, puis fixez la retenue du plomb comme indiqué sur la Figure 2-15.
13. Coupez l'excès du fil de plombage.

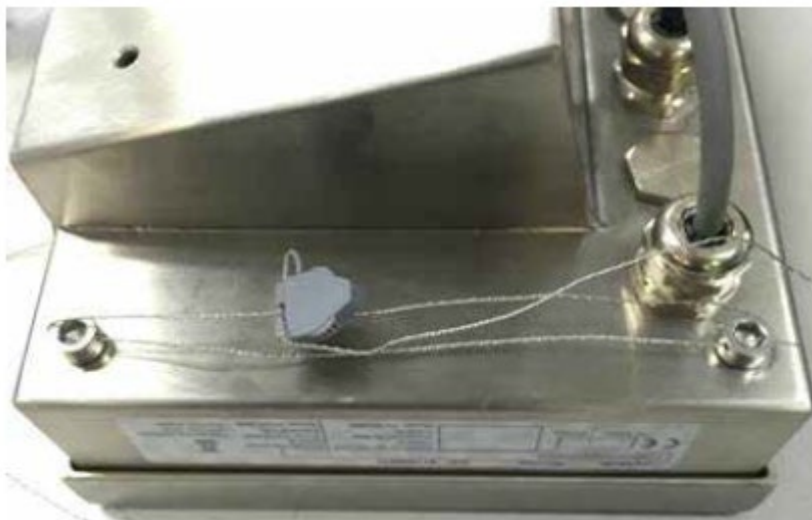


Figure 2-15 : Méthode de plombage

2.9. Paramètres d'interface

2.9.1. Circuit d'alimentation (port d'alimentation)

Circuit d'alimentation	Paramètres
Version avec alimentation CA sans sécurité intrinsèque (référence se terminant par « 46 » ou « 44 ») (uniquement homologuée ATEX et IECEx) Câble connecté en permanence avec embout	Tension nominale : CA 187...250 V (50/60 Hz) Courant nominal : 125 mA Tension d'entrée maximale : Um CA 250 V
Version avec alimentation CC sans sécurité intrinsèque (référence se terminant par « 56 » ou « 54 ») (uniquement homologuée ATEX et IECEx) Câble connecté en permanence avec embout : Bleu : +24 V, marron : masse, vert-jaune : PE	Tension nominale : CC 18...30 V Courant nominal : 250 mA Tension d'entrée maximale sur l'appareil associé : Um CA 250 V (Remarque : la tension nominale est inférieure)
Versions avec alimentation CC à sécurité intrinsèque (batterie) (référence se terminant par « 25 » ou « 27 ») Bornes de raccordement : V+, MASSE, BATT, DONNÉES	Tension d'entrée nominale : CC 10 V Courant d'entrée nominal : 350 mA
	Tension d'entrée maximale : Ui CC 12,8 V Courant d'entrée maximal : Ii 3,03 A Puissance d'entrée maximale : Pi 6,83 W
	Inductance efficace interne : Li négligeable Capacité efficace interne : Ci négligeable

2.9.2. Interface RS232 à sécurité intrinsèque

Interface RS232 à sécurité intrinsèque	Paramètres
Bornes J1.1 (TXD), J1.2(RXD) - J1.3 (MASSE)	Tension d'entrée maximale : U_i CC ± 10 V
	Capacité efficace interne : C_i négligeable
	Inductance efficace interne : L_i négligeable
	Tension de sortie maximale : U_o CC
	J1.1-MASSE resp. J1.2-MASSE chacune : $\pm 5,36$ V
	Courant de sortie maximum : I_o
	J1.1-MASSE resp. J1.2-MASSE chacune : $\pm 12,9$ mA
	Puissance de sortie maximale : P_o
	J1.1-MASSE resp. J1.2-MASSE chacune : $17,2$ mW
	Capacité externe maximale : C_o 100 nF
	Inductance externe maximale : L_o 100 μ H

2.9.3. Sortie à sécurité intrinsèque pour la connexion à un capteur

Sortie à sécurité intrinsèque pour la connexion à un capteur	Paramètres
Bornes J5.1 (EXC+), J5.2 (SEN+), J5.3 (SIG+), J5.5 (SIG-), J5.6 (SEN-), J5.7 (EXC-)	Tension de sortie maximale : U_o CC 5,88 V
	Courant de sortie maximal : I_o 171 mA
	Puissance de sortie maximale : P_o 940 mW
	Capacité externe maximale : C_o 6,8 μ F
	Inductance externe maximale : L_o 0,3 mH

2.9.4. Interfaces de carte de communication en option

Interfaces des cartes de communication en option	Paramètres
Interface 4-20 mA à sécurité intrinsèque Uniquement pour les versions avec carte d'option de sortie analogique (référence « A ») Bornes J2.1 (I_OUT) - J2.2 (MASSE)	Tension d'entrée maximale : U_i CC 3,5 V
	Courant d'entrée maximal : I_i 115 mA
	Capacité interne maximale : C_i 110 nF
	Inductance interne maximale : $L_o=0$
	Tension de sortie maximale : U_o CC 13,65 V
	Courant de sortie maximal : I_o 115 mA
	Puissance de sortie maximale : P_o 0,4 W
	Capacité externe maximale : C_o 680 nF
	Inductance externe maximale : L_o 400 μ H
Connexion-antenne-WiFi Uniquement pour les versions avec carte d'option WiFi (référence « W ») Connecteur IPEX pour le raccordement à l'antenne externe type AC-Q24-50ZD	Puissance RF maximale : $< 1,3$ W
	Fréquence : 2400...2483 MHz
Interface de boucle de courant active à sécurité intrinsèque Uniquement pour les versions avec carte	Tension de sortie maximale : U_o CC 5,36 V
	Courant de sortie maximal : I_o 131 mA
	Puissance de sortie maximale : P_o 176 mW

Interfaces des cartes de communication en option	Paramètres
d'option de boucle de courant active (référence « E ») Bornier J2, bornes J2.1...J2.4 (BC active)	Capacité externe maximale : Co 600 nF Inductance externe maximale : Lo 400 µH
Interface de boucle de courant passive à sécurité intrinsèque Uniquement pour les versions avec carte d'option de boucle de courant passive (référence « P ») Bornier J4, bornes J4.1...J4.4 (BC passive)	Tension d'entrée maximale : Ui CC 10 V Courant d'entrée maximal : Ii 300 mA Puissance d'entrée maximale : Pi 500 mW
	Capacité efficace interne : Ci 110 nF Inductance efficace interne : Li négligeable

2.9.5. Plage de température ambiante

Paramètres
Plage de température ambiante : Ta -10 °C...+40 °C

IND256x

Terminale di pesata



METTLER TOLEDO

Terminale di pesata IND256x

METTLER TOLEDO Service

Manutenzione necessario per prestazioni affidabili

Grazie per aver scelto la qualità e la precisione di METTLER TOLEDO. Utilizzando questo nuovo dispositivo in modo appropriato, nel rispetto delle istruzioni del manuale e della regolazione e della manutenzione regolare offerti dal nostro team di assistenza addestrato in fabbrica, il funzionamento rimarrà affidabile e preciso, proteggendo l'investimento. Non esiti a contattarci per un contratto di servizio personalizzato per le sue esigenze e il suo budget. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito Web www.mt.com/service.

I metodi che consentono di massimizzare le prestazioni dell'investimento sono svariati:

1. **Registri il prodotto:** la invitiamo a registrare il prodotto sul sito www.mt.com/productregistration e sarà contattato in caso di miglioramenti, aggiornamenti e notifiche importanti.
2. **Per assistenza contatti METTLER TOLEDO:** il valore della misurazione è proporzionale alla sua precisione – una bilancia non regolata può diminuire la qualità, ridurre i profitti e aumentare la responsabilità Assistenza tempestiva da parte di METTLER TOLEDO garantisce precisione, ottimizzano il funzionamento e la durata del dispositivo.
 - a. **Installazione, configurazione, integrazione e addestramento:** I nostri addetti all'assistenza sono esperti addestrati in fabbrica sui dispositivi di pesatura. Ci accertiamo che il dispositivo di pesatura sia pronto per la produzione, tempestivamente e in modo conveniente e che il personale sia opportunamente addestrato.
 - b. **Documentazione della regolazione iniziale:** I requisiti ambientali e applicativi di installazione sono unici per ogni bilancia industriale e le prestazioni devono essere testate e certificate. I nostri servizi di calibrazione e l'accuratezza dei documenti certificati garantiscono la qualità di produzione e un sistema di qualità con record delle prestazioni.
 - c. **Manutenzione periodica di regolazione:** Il contratto del Servizio di regolazione offre una garanzia costante nel processo di pesatura e la documentazione di conformità ai requisiti. Offriamo una serie di piani di assistenza programmati per soddisfare le esigenze e determinati in base al budget.
 - d. **Verifica GWP®:** approccio basato sulla valutazione dei rischi per la gestione degli strumenti di pesatura, che permette il controllo e il miglioramento dell'intero processo di misurazione, garantendo quindi una qualità costante dei prodotti e la riduzione dei costi di processo. GWP (Good Weighing Practice) è lo standard con basi scientifiche per un'efficiente gestione del ciclo di vita delle apparecchiature di pesatura, che fornisce risposte chiare su come specificare, calibrare e garantire la precisione delle apparecchiature di pesatura, indipendentemente dalla marca.

© METTLER TOLEDO 2019

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta o trasmessa in alcuna forma o mediante alcun mezzo, elettronico o meccanico, incluse fotocopie o registrazione, per nessuno scopo senza espresso consenso scritto della METTLER TOLEDO.

Diritti limitati del governo USA: questa documentazione è fornita con diritti limitati.

Copyright 2019 METTLER TOLEDO. Questa documentazione contiene informazioni proprietarie della METTLER TOLEDO. Non può essere copiata interamente o in parte senza il consenso scritto della METTLER TOLEDO.

La METTLER TOLEDO si riserva il diritto di apportare miglioramenti o modifiche al prodotto o al manuale senza preavviso.

COPYRIGHT

METTLER TOLEDO® è un marchio registrato di Mettler-Toledo, LLC. Tutti gli altri marchi o nomi di prodotto sono marchi delle rispettive società.

LA METTLER TOLEDO SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MIGLIORAMENTI O MODIFICHE SENZA PREAVVISO

Avviso su FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC e ai requisiti di interferenza radio del Canadian Department of Communications. Il funzionamento è soggetto alle seguenti condizioni: (1) questo dispositivo potrebbe non causare interferenze dannose e (2) deve accettare qualunque interferenza, incluse quelle che potrebbero causare effetti indesiderati.

Questa apparecchiatura è stata collaudata e ritenuta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe A, in conformità con la Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono previsti per fornire una protezione adeguata contro le interferenze dannose quando l'apparecchiatura viene azionata in un ambiente commerciale. Quest'apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità con il manuale di istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose con le comunicazioni radio. Il funzionamento di quest'apparecchiatura in un'area residenziale potrebbe causare interferenze dannose, nel qual caso all'utente sarà richiesto di correggere le interferenze a sue spese.

- La dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo
<http://glo.mt.com/global/en/home/search/compliance.html/compliance/>.

Precauzioni

- PRIMA di utilizzare o sottoporre a manutenzione questa apparecchiatura, LEGGERE questo manuale e SEGUIRE attentamente le istruzioni.
- CONSERVARE questo manuale per utilizzo futuro.

	 AVVERTENZA È NECESSARIO CHE TUTTE LE OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEL PRESENTE STRUMENTO VENGANO ESEGUITE A SEGUITO DELL'ESCLUSIONE DEL RISCHIO DI ESPLOSIONE NELL'AREA IN CUI SI TROVA IL TERMINALE IND245x DA PARTE DEL PERSONALE AUTORIZZATO DAL RESPONSABILE DELLA SEDE DEL CLIENTE.
	 ATTENZIONE CONFERMARE LA CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE LOCALI E NAZIONALI APPLICABILI IN MATERIA DI RETE WI-FI PRIMA DI INSTALLARE E METTERE IN SERVIZIO IL TERMINALE IND256x CONFIGURATO CON IL MODULO WI-FI. METTLER TOLEDO NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER I TERMINALI INSTALLATI IN PAESI IN CUI LE NORMATIVE IN MATERIA DI WI-FI NON SONO OSSERVATE.
	 AVVERTENZA NEL CASO IN CUI LA TASTIERA, LA LENTE DELLO SCHERMO O L'ALLOGGIAMENTO DEL TERMINALE IND245x SIANO STATI DANNEGGIATI, È NECESSARIO SOSTITUIRE IMMEDIATAMENTE IL COMPONENTE DIFETTOSO. DISCONNETTERE IMMEDIATAMENTE L'ALIMENTAZIONE E NON RICOLLEGARLA PRIMA CHE LA LENTE DELLO SCHERMO, LA TASTIERA O L'ALLOGGIAMENTO SIANO STATI SOSTITUITI DA PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO. LA MANCATA OSSERVANZA DELLE PRECEDENTI INDICAZIONI PUÒ PROVOCARE LESIONI ALLE PERSONE E/O DANNI ALLE COSE.
	 AVVERTENZA EVITARE CARICHE ELETTROSTATICHE DURANTE IL FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE.
	 AVVERTENZA OPERAZIONE E 'SOLO CONSENTITA QUANDO CARICHE ELETTROSTATICHE OPERATIVE E DI PROCESSO SONO ELIMINATE.
	 AVVERTENZA UTILIZZARE IL TERMINALE DI PESATURA SOLO IN ASSENZA DI PROCESSI ELETTROSTATICI IN GRADO DI GENERARE SCARICHE A SPAZZOLA PROPAGANTI.
	 AVVERTENZA TENERE IL TERMINALE LONTANO DA PROCESSI IN GRADO DI GENERARE UN POTENZIALE DI CARICA ELEVATO, AD ESEMPIO RIVESTIMENTO ELETTROSTATICO, TRASFERIMENTO RAPIDO DI MATERIALI NON CONDUTTIVI, AIR JET RAPIDI E AEROSOL AD ALTA PRESSIONE.
	 AVVERTENZA NON UTILIZZARE UN PANNINO BAGNATO PER PULIRE IL TERMINALE DI PESATURA. UTILIZZARE UN PANNINO UMIDO ED ESEGUIRE LA PULIZIA CON DELICATEZZA.

	 AVVERTENZA
	INDOSSARE UN ABBIGLIAMENTO IDONEO. EVITARE INDUMENTI IN NYLON, POLIESTERE O ALTRO MATERIALE SINTETICO IN GRADO DI GENERARE O TRATTENERE LA CARICA. UTILIZZARE CALZATURE E PAVIMENTAZIONE CONDUTTIVE.
	 AVVERTENZA
	EVITARE DI COPRIRE IL TERMINALE CON ELEMENTI IN PLASTICA.
	 AVVERTENZA
	ACCERTARSI CHE TERMINALE, ACCESSORI DI MONTAGGIO E BASE SIANO DOTATI DI UN'ADEGUATA MESSA A TERRA EQUIPOTENZIALE.
	 AVVERTENZA
	IL TERMINALE DEVE ESSERE PROTETTO DALLA LUCE UV.
	 AVVERTENZA
	PER LA VERSIONE CC DEL TERMINALE IND256x, NON ESISTE SEPARAZIONE GALVANICA TRA IL CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE NON A SICUREZZA INTRINSECA E I CIRCUITI DI USCITA A SICUREZZA INTRINSECA. IL CIRCUITO NON A SICUREZZA INTRINSECA DEVE ESSERE CORRETTAMENTE COLLEGATO A TERRA E I CIRCUITI A SICUREZZA INTRINSECA DEVONO ESSERE DOTATI DI COMPENSAZIONE DEL POTENZIALE. IN ALTERNATIVA, È NECESSARIO CHE IL CIRCUITO NON A SICUREZZA INTRINSECA (SELV) SIA CORRETTAMENTE SEPARATO DA TERRA.
	 AVVERTENZA
	L'ALIMENTAZIONE CC ESTERNA FORNITA DAL CLIENTE DEVE POTER GESTIRE UNA SOVRATENSIONE DI CATEGORIA II AL MASSIMO, IN CONFORMITÀ A IEC 60664-1.
	 AVVERTENZA
	È NECESSARIO LASCIARE GIOCO SUFFICIENTE PER EVITARE FORZE DI TRAZIONE SUI PRESSACAVI.
	 AVVERTENZA
	I PRESSACAVI DEVONO ESSERE PROTETTI DA DANNI DOVUTI A URTO.
	 AVVERTENZA
	IL TERMINALE ASSEMBLATO CON L'ANTENNA WIFI DEVE ESSERE INSTALLATO IN UNA POSIZIONE TALE CHE IL RISCHIO DI DANNI MECCANICI SIA BASSO. SOSTITUIRE IMMEDIATAMENTE L'ANTENNA WIFI SE DANNEGGIATA!

	 AVVERTENZA I TERMINALI IND256X CONFIGURATI IN FABBRICA CON WI-FI SONO OMOLOGATI PER L'UTILIZZO IN ZONE CLASSIFICATE COME ZONA 1 PER GRUPPI DI STRUMENTI IIB. I TERMINALI IND256X CONFIGURATI IN FABBRICA CON WI-FI NON DEVONO ESSERE UTILIZZATI IN ZONE CLASSIFICATE PER GRUPPI DI STRUMENTI IIC. UTILIZZARE IL TERMINALE IND256X CONFIGURATO IN FABBRICA CON WI-FI IN UNA ZONA PER LA QUALE NON È OMOLOGATO PUÒ CAUSARE LESIONI PERSONALI E/O DANNI ALLA PROPRIETÀ.
	 AVVERTENZA L'ALIMENTAZIONE DI POTENZA CC ESTERNO FORNITO DAL CLIENTE DEVE AVERE UNA SOVRATENSIONE MASSIMA DI CATEGORIA II, CONFORMEMENTE ALLA IEC 60664-1.
	 AVVERTENZA NON APRIRE IL TERMINALE SE L'ATMOSFERA È ESPLOSIVA PER LA PRESENZA DI POLVERI. PER IMPEDIRE L'IGNIZIONE DI ATMOSFERE A RISCHIO DI ESPLOSIONE, SCOLLEGARE IL TERMINALE IND256x DALLA FONTE DI ALIMENTAZIONE PRIMA DI APRIRE L'ALLOGGIAMENTO. TENERE IL COPERCHIO COMPLETAMENTE CHIUSO QUANDO IL CIRCUITO È SOTTO TENSIONE. NON APRIRE SE NELL'ATMOSFERA SONO PRESENTI POLVERI ESPLOSIVE.
	 AVVERTENZA TUTTI GLI STRUMENTI DEVONO ESSERE INSTALLATI SECONDO IL DISEGNO NUMERO 30282892B DEL DOCUMENTO DEL PRODUTTORE E SECONDO I CODICI LOCALI APPLICABILI.
	 AVVERTENZA IN QUESTO STRUMENTO POSSONO ESSERE UTILIZZATI SOLO I COMPONENTI SPECIFICATI NEL MANUALE DI INSTALLAZIONE INCLUSO SUL CD-ROM DELLA DOCUMENTAZIONE 30512916. TUTTI GLI STRUMENTI DEVONO ESSERE INSTALLATI IN CONFORMITÀ ALLE ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE. L'UTILIZZO DI COMPONENTI NON IDONEI O SOSTITUTIVI E/O LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI POSSONO COMPROMETTERE LA SICUREZZA INTRINSECA DEL TERMINALE E PROVOCARE LESIONI ALLE PERSONE E/O DANNI ALLE COSE.
	 AVVERTENZA PER UNA PROTEZIONE CONTINUA CONTRO IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, COLLEGARE SOLO A UNA PRESA CORRETTAMENTE MESSA A TERRA. NON RIMUOVERE IL POLO DI TERRA.
	 AVVERTENZA QUALORA QUESTO STRUMENTO VENGA INCLUSO COME COMPONENTE IN UN SISTEMA, L'INSIEME RISULTANTE DOVRÀ ESSERE VERIFICATO DA PERSONALE QUALIFICATO CHE ABBA FAMILIARITÀ CON LA COSTRUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I COMPONENTI DEL SISTEMA E CON I POTENZIALI RISCHI CORRELATI. LA MANCATA OSSERVANZA DI TALI PRECAUZIONI PUÒ PROVOCARE LESIONI ALLE PERSONE E/O DANNI ALLE COSE.
	 AVVERTENZA LA MANUTENZIONE DEL TERMINALE IND245x DEVE ESSERE AFFIDATA SOLO A PERSONALE QUALIFICATO. PRESTARE ATTENZIONE DURANTE CONTROLLI, TEST E REGOLAZIONI DA ESEGUIRE AD ALIMENTAZIONE ATTIVA. LA MANCATA OSSERVANZA DI TALI PRECAUZIONI PUÒ PROVOCARE LESIONI ALLE PERSONE E/O DANNI ALLE COSE.
	 AVVERTENZA PRIMA DI COLLEGARE O SCOLLEGARE QUALSIASI COMPONENTE ELETTRONICO INTERNO O DI CABLARE FRA LORO GLI STRUMENTI ELETTRONICI, STACCARE SEMPRE L'ALIMENTAZIONE E ATTENDERE ALMENO TRENTA (30) SECONDI PRIMA DI ESEGUIRE CONNESSIONI E DISCONNESSIONI. IGNORARE QUESTE PRECAUZIONI POTREBBE CAUSARE DANNI MATERIALI O PORTARE AL GUASTO IRREPARABILE DELLO STRUMENTO.

**AVVISO****RISPETTARE LE PRECAUZIONI PER LA GESTIONE DEI DISPOSITIVI SENSIBILI ALLE CARICHE ELETTROSTATICHE.****Normative per lo smaltimento sicuro**

In conformità alla Direttiva Europea 2002/96/CE sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment), l'apparecchiatura non deve essere smaltita assieme ad altri rifiuti domestici. La direttiva è applicabile anche a paesi non facenti parte dell'Unione Europea, in base ai requisiti specifici del paese di appartenenza.

Il prodotto deve essere smaltito in base a quanto stabilito dalle normative locali presso il punto di raccolta specifico per apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per eventuali domande, contattare l'autorità responsabile o il distributore da cui è stato acquistato l'apparecchio.

Qualora l'apparecchio venga trasferito a terzi (per uso privato o professionale), il contenuto della presente normativa deve ritenersi valido anche per terzi.

Grazie per il contributo alla salvaguardia dell'ambiente.

Indice

1	Introduzione	1-1
1.1.	Panoramica dell'IND256x	1-1
1.2.	Specifiche del prodotto	1-2
1.3.	Standard per i test	1-4
1.4.	Avvertenze e precauzioni	1-6
1.5.	Ispezione e lista di controllo dei contenuti	1-6
1.6.	Configurazione	1-7
1.7.	Collegamento equipotenziale (EB)	1-9
1.8.	Ambiente operativo	1-10
1.9.	Dimensioni	1-11
1.10.	Scheda madre	1-13
1.11.	Schede opzionali di comunicazione	1-13
2	Installazione	2-1
2.1.	Apertura dell'armadietto	2-1
2.2.	Installazione dei cavi e dei connettori	2-2
2.3.	Collegamento e messa a terra	2-6
2.4.	Collegamento equipotenziale (EB)	2-7
2.5.	Chiusura dell'armadietto	2-7
2.6.	Collegamento per cella di carico analogica	2-7
2.7.	Collegamento schede di comunicazione	2-8
2.8.	Sigillatura dell'armadietto	2-12
2.9.	Parametri di interfaccia	2-13

1 Introduzione

1.1. Panoramica dell'IND256x

IND256x rappresenta l'ultima novità della tecnologia di pesata METTLER TOLEDO. L'IND256x ha ottenuto la certificazione da parte di terzi per la pesatura in aree a rischio di esplosione e può essere utilizzata in ambienti che corrispondono alla zona 1/21.

Terminale di pesa a campo singolo o multicampo e ad elevate prestazioni, IND256x utilizza celle di carico analogiche per ottenere una pesatura affidabile a basso costo, dai grammi alle tonnellate. È facilmente integrabile in un sistema di pesatura esistente.

Collegando la barriera di sicurezza o isolata appropriata, IND256x è in grado di fornire diverse interfacce di comunicazione a sicurezza intrinseca per comunicare con PC e stampanti nell'area sicura. Queste caratteristiche consentono all'IND256x di supportare la maggior parte delle applicazioni di pesatura in gran parte dei settori industriali, tra cui:

- Farmaceutico
- Processi con utilizzo di polveri
- Sostanze chimiche speciali
- Petrolchimica
- Agricoltura
- Vernici e inchiostri
- Ingegneria dei prodotti di chimica fine

1.1.1. Versione del terminale IND256x

IND256x è disponibile con tre diverse opzioni di alimentazione:

- alimentazione CA con tensione alternata esterna 187 -250 V 50/60 Hz)
- alimentazione CC con tensione diretta esterna CC 18 -30 V)
- alimentazione intrinsecamente sicura che utilizza un pacco batteria NiMH Ex esterno 64060627)

Ciascuna di queste versioni ha ottenuto l'omologazione ATEX e IECEx per l'utilizzo nelle aree classificate come Zona 1 e Zona 21.

1.1.2. Caratteristiche del prodotto IND256x

- Funzioni di pesa di base in aree pericolose incluso lo zero, la tara e le funzioni di stampa
- Armadietto del tipo con montaggio a banco, parete o colonna per ambienti difficili
- Collegamento a una singola piattaforma di pesatura analogica
- LCD bianco retroilluminato da 240 x 96 pixel, cifre grandi 25 mm
- Orologio in tempo reale spegnimento)

- Una porta seriale a sicurezza intrinseca COM1) per uscita di stampa e comunicazione asincrona e bidirezionale
- Supporto per le seguenti schede interne opzionali:
 - Uscita analogica 4-20 mA a sicurezza intrinseca
 - Modulo comunicazione Wi-Fi con antenna solo per terminali IND256x configurati di fabbrica con modulo Wi-Fi)
 - Circuito di corrente attivo – per collegamento a un modulo di comunicazione ACM200 posizionato nell'area di sicurezza o per collegare un secondo terminale IND256x configurato con l'opzione dell'anello di corrente passiva
 - Circuito di corrente passivo utilizzato come secondo display per collegare un altro terminale tramite un circuito di corrente attivo)
- Tre ingressi ID personalizzati supportati
- La tabella target supporta 25 target preimpostati per il controllo del peso
- La tabella tare supporta 20 valori preimpostati per la tara
- Unità di misura supportate: g, kg, t, ton, lb e oz
- Salvataggio di 60.000 dati relativi alle transazioni
- Supporto dell'accumulazione e del totale cumulativo
- Possibilità di personalizzazione di cinque diversi modelli di stampa
- Supporto della taratura senza pesi CalFREE™)

1.2. Specifiche del prodotto

Nella Tabella 1-1 sono riportate le specifiche dell'IND256x.

Tabella 1-1: Specifiche IND256x

Elemento	Specifiche tecniche
Armadietto	Staffa in acciaio inossidabile 304 con montaggio a parete o su asta
Dimensioni lunghezza × larghezza × profondità)	173 mm × 230 mm × 127 mm 6,8 in × 9,1 in × 5,0 in)
Peso di trasporto	3,5 kg 8 libbre)
Grado di protezione	IP66.
Ambiente di conservazione	Intervallo temperatura di conservazione: da -20 °C a 60 °C da -4° a 140 °F) Umidità relativa: Dal 10 al 95% senza condensa

Elemento	Specifiche tecniche
Condizioni di servizio	Intervallo temperatura operativa: da -10 °C a 40 °C da 14° a 104 °F) Umidità relativa: Dal 10 al 95% senza condensa
Area pericolosa	IND256x viene utilizzata nelle aree a rischio di esplosione zona 1/21.
Alimentazione	Alimentatore CA 187 -253V 50/60Hz)
	Alimentatore CC CC 18 -30V)
	Pacco batteria esterna NiMHEx 64060627)
Display	LCD bianco retroilluminato da 240 x 96 pixel, cifre grandi 25 mm Frequenza di aggiornamento display: 10 Hz
Visualizzazione del peso	Massimo 100.000 divisioni
Tipo di piattaforma di pesatura	Cella di carico analogica
Quantità sensore	Un massimo di quattro celle di carico da 350 ohm minimo 87 ohm), 2 mv/V o 3 mv/V
Quantità piattaforma di pesatura	Supporta un'unica piattaforma di pesatura
Frequenza di aggiornamento	>366 Hz
Tensione di eccitazione sensore	4,5 VCC
Sensibilità minima	0,6µV/e
Tastiera	26 tasti; tastiera a membrana spessa 1,5 mm
Modalità di comunicazione	Interfaccia standard: La scheda madre è dotata di un'interfaccia di comunicazione RS232 a sicurezza intrinseca Opzioni interfaccia: Uscita analogica 4-20 mA a sicurezza intrinseca, con conversione D / A a 16 bit e frequenza di aggiornamento 25 Hz al PLC o modulo comunicazione Wi-Fi solo per terminali IND256x configurati di fabbrica con modulo Wi-Fi); o circuito di corrente attivo a sicurezza intrinseca o circuito di corrente passivo a sicurezza intrinseca Protocolli di comunicazione: Ingresso porta seriale: Comandi ASCII per CTPZ cancellazione, tara, stampa, zero), comandi SICS supporta SICS di livello 0 e livello 1) Uscita porta seriale: Uscita continua Toledo, uscita stampa a comando 5 modelli configurabili), comando SICS e stampa report
Omologazione metrologica	Europa: OIML R76; Classe III, 6000e; TC10878 Globale: OIML R76; Classe III, 6000e; R76-2006-A-NL1-18.27

Elemento	Specifiche tecniche
Omologazioni per ambienti a rischio, versione di Wi-Fi con configurazione di fabbrica	con alimentazione a sicurezza non intrinseca versione CA e CC): II 2G Ex eb ib [ib] mb IIB T4 Gb II 2D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db con alimentazione a sicurezza intrinseca Batteria/APS50x): II 2G Ex ib IIB T4 Gb II 2D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db
Omologazioni per ambienti a rischio, versione senza Wi-Fi	con alimentazione a sicurezza non intrinseca versione CA e CC): II 2G Ex eb ib [ib] mb IIC T4 Gb II 2D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db con alimentazione a sicurezza intrinseca Batteria/APS50x): II 2G Ex ib IIC T4 Gb II 2D Ex tb [ib] IIIC T60°C Db

Tabella 1-2: Specifiche del modulo Wi-Fi solo per terminali IND256x configurati di fabbrica con modulo Wi-Fi)

Elemento	Specifiche tecniche
Standard	802,11 b/g/n
Potenza di trasmissione	14dBm media)
Intervallo di frequenza RF	2,4GHz – 2,497GHz
Crittografia	WEP, WPA
WEP	64 bit, 128 bit
WPA	WPA-TKIP, WPA2-AES
Protocollo	TCP/IP
Modalità operativa	Server, Client
Distanza di trasmissione	Massimo 50 metri all'aria aperta
Omologazione	Cina: SRRC

1.3. Standard per i test

Il terminale IND256x è stato testato secondo i seguenti standard.

EN 60079-0:2012 + A11:2013	Requisiti generali
EN 60079-7:2015	Sicurezza aumentata "e"
EN 60079-11:2012	Sicurezza intrinseca "i"
EN 60079-18:2015	Incapsulamento "m"

EN 60079-31:2014	Protezione tramite involucro "t"
EN 60079-0:2017 Ed. 7.0	Requisiti generali
IEC 60079-7:2017, Ed. 5.1	Sicurezza aumentata "e"
IEC 60079-11:2011, Ed. 6.0	Sicurezza intrinseca "i"
IEC 60079-18:2017, Ed. 4.1	Incapsulamento "m"
IEC 60079-31:2013, Ed. 2.0	Protezione tramite involucro "t"
FM3600 2011)	Apparecchiatura elettrica da utilizzare in luoghi classificati come pericolosi, requisiti generali
FM3610 2010)	Apparecchio intrinsecamente sicuro e Apparecchio associato da utilizzare in aree a rischio Classe I, II e III, Divisione 1
FM3810 2005)	Attrezzatura elettrica per misurazioni, controlli e uso in laboratorio
ANSI/IEC 60529	Gradi di protezione forniti dall'involucro Codice IP)
CSA C22.2 N. 157-1992 / 2006	Attrezzatura intrinsecamente sicura e ignifuga da utilizzare in zone pericolose
CSA C22.2 N. 142-1990 / 2004	Attrezzatura per il controllo del processo
CSA C22.2 N. 61010.1-2004	Direttive di sicurezza per l'attrezzatura elettrica per misurazioni, controlli e uso in laboratorio – parte 1: Requisiti generali
CAN/CSA 22.2 N. 60529-2005	Gradi di protezione forniti dall'involucro Codice IP)

1.3.1. Condizioni speciali per un utilizzo sicuro

1. L'apparecchio deve essere protetto dai raggi UV
2. Cariche elettrostatiche durante il funzionamento e la manutenzione devono essere escluse. Il terminale deve essere installato solo in aree in cui non sono presenti cariche elettrostatiche operative e collegate al processo.
3. Per le versioni con alimentazione CC non intrinsecamente sicura la chiave del tipo termina con "44" o "46"): Non esiste separazione galvanica tra il circuito di alimentazione a sicurezza intrinseca e i circuiti di uscita a sicurezza intrinseca:

Il circuito a sicurezza non intrinseca deve essere messo correttamente a terra. In questo caso, anche i circuiti a sicurezza intrinseca sono messi a terra. Lungo i circuiti a sicurezza intrinseca, deve esistere la compensazione di potenziale.

o

Il circuito a sicurezza non intrinseca deve essere separato in sicurezza dalla terra ad es. il circuito SELV).

4. Per il terminale nella versione CC, il circuito di alimentazione deve avere una sovratensione massima di categoria II, conformemente alla IEC 60664-1.
5. I pressacavi Serie HSK-M-Ex... e V-Ms-Ex... secondo KEMA 99 ATEX 6971X rispettivamente IECEx BVS 07.0014X sono testati con una forza di trazione ridotta 25%) secondo la clausola A.3.1 se IEC 60079-0 e possono essere utilizzati solo per l'installazione fissa di apparecchi del gruppo II. L'utente deve garantire il bloccaggio del cavo adeguato.

6. L'antenna WiFi è testata per il basso rischio di pericolo meccanico altezza di impatto 0,4 m con massa di 1 kg) e deve essere protetta da elevati livelli di energia di impatto.

1.4. Avvertenze e precauzioni

Prima di azionare il nuovo terminale, leggere attentamente queste istruzioni.

Sebbene l'IND256x sia costruito in materiale resistente, è comunque uno strumento di precisione. Prestare attenzione nel maneggiare e installare il terminale.

	AVVERTENZA
	NON INSTALLARE O ESEGUIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRIMA CHE L'AREA SIA STATA DEFINITA NON PERICOLOSA DAL PERSONALE AUTORIZZATO INCARICATO DAL RESPONSABILE IN LOCO.
	AVVERTENZA
	CON IL TERMINALE È POSSIBILE UTILIZZARE SOLO I COMPONENTI SPECIFICATI NEL PRESENTE MANUALE. È NECESSARIO INSTALLARE TUTTI I DISPOSITIVI CONFORMEMENTE ALLE ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE RIPORTATE NEL PRESENTE MANUALE. L'UTILIZZO DI COMPONENTI NON CORRETTI O SOSTITUTIVI E/O LA MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESENTI ISTRUZIONI POSSONO COMPROMETTERE LA SICUREZZA INTRINSECA DEL TERMINALE E CAUSARE LESIONI ALLE PERSONE E/O DANNI MATERIALI.
	AVVERTENZA
	NON APRIRE SE SOTTO TENSIONE.
	AVVERTENZA
	POTENZIALE PERICOLO DI SCARICHE ELETTROSTATICHE, VEDERE ISTRUZIONI.
	AVVERTENZA
	NON APRIRE IN PRESENZA DI ATMOSFERE ESPLOSIVE.
	AVVERTENZA
	IL TERMINALE ASSEMBLATO CON L'ANTENNA WIFI DEVE ESSERE INSTALLATO IN UNA POSIZIONE TALE CHE IL RISCHIO DI DANNI MECCANICI SIA BASSO. SOSTITUIRE IMMEDIATAMENTE L'ANTENNA WIFI SE DANNEGGIATA!

1.5. Ispezione e lista di controllo dei contenuti

Al momento della consegna dell'IND256x, verificare che la confezione sia integra. Se la scatola risulta danneggiata, verificare eventuali danni riportati anche dall'IND256x e, se necessario, inoltrare un reclamo relativo al trasporto al corriere. Se l'imballaggio non risulta danneggiato,

	 AVVERTENZA
	I TERMINALI IND256X CONFIGURATI IN FABBRICA CON WI-FI SONO OMOLOGATI PER L'UTILIZZO IN ZONE CLASSIFICATE COME ZONA 1 PER GRUPPI DI STRUMENTI IIB. I TERMINALI IND256X CONFIGURATI IN FABBRICA CON WI-FI NON DEVONO ESSERE UTILIZZATI IN ZONE CLASSIFICATE PER GRUPPI DI STRUMENTI IIC. UTILIZZARE IL TERMINALE IND256X CONFIGURATO IN FABBRICA CON WI-FI IN UNA ZONA PER LA QUALE NON È OMOLOGATO PUÒ CAUSARE LESIONI PERSONALI E/O DANNI ALLA PROPRIETÀ.
	AVISO
FUNZIONALITÀ WI-FI DISPONIBILE SOLO NEI TERMINALI IND256X COSÌ CONFIGURATI IN FABBRICA.	

1.6.2. Codice di data del prodotto

La data di produzione o il codice di data del terminale sono reperibili sulla targhetta di serie sulla parte superiore dell'armadietto).

Il numero di serie comincia con una lettera e un numero per esempio B212000371). La lettera rappresenta le prime tre cifre dell'anno, come indicato nel grafico dei codici di data nella Tabella 1-3 la lettera "B" nell'esempio riportato rappresenta "201x") e il numero rappresenta la cifra dell'unità dell'anno "2" nell'esempio). Pertanto "B4" indica l'anno 20 14.

Tabella 1-3: Formati dei codici di data attuali e più recenti

Codici di data	Anno	Codici di data	Anno
A	200x	F	205x
B	201x	G	206x
C	202x	H	207x
D	203x	J	208x
E	204x	K	209x

1.6.3. Collegamenti

Nella figura sottostante sono illustrate le posizioni delle connessioni sul retro dell'armadietto per ambienti difficili.

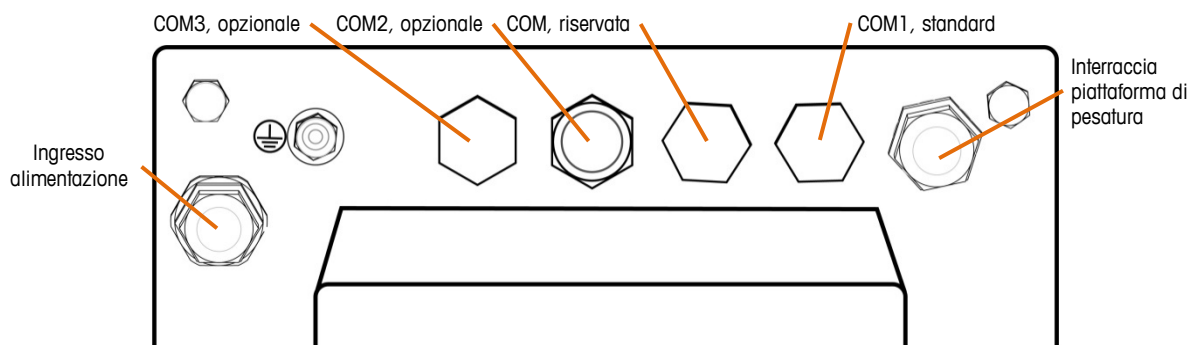


Figura 1-2: Posizioni porta di collegamento IND256x

Ingresso alimentazione	Ingresso alimentazione in CA 220 V 187 -250 V 50/60 Hz) versione ATEX e IECEx) o ingresso alimentazione in CC 24V 18 V -30 V) versione ATEX e IECEx) o batteria esterna Ex
COM1 standard)	RS232 intrinsecamente sicura
COM2 Opzionale)	uscita analogica 4-20 mA intrinsecamente sicura o modulo di comunicazione WiFi solo configurato in fabbrica)
COM3 Opzionale)	circuito di corrente intrinsecamente sicuro o circuito di corrente passivo intrinsecamente sicuro
COM riservata	Non utilizzata

1.6.4. Avvertenze

1.6.4.1. CENELEC

Connessione di EB in base alla normativa specifica del paese: Assicurarsi che gli alloggiamenti di tutti i dispositivi siano collegati allo stesso potenziale tramite i terminali EB. Nessuna corrente in circolazione può fluire tramite la schermatura del cavo per i cavi intrinsecamente sicuri.

1.6.4.2. cFMus

Connessione di EB per ANSI/NFPA 70, Articolo 504 e ANSI/IA RP 12.06.01 o Canadian Electric Code C22.2: Assicurarsi che gli alloggiamenti di tutti i dispositivi siano collegati allo stesso potenziale tramite i terminali EB. Nessuna corrente in circolazione può fluire tramite la schermatura del cavo per i cavi intrinsecamente sicuri.

1.7. Collegamento equipotenziale EB)

Il collegamento equipotenziale deve essere installato da un elettricista autorizzato dal proprietario. L'assistenza METTLER TOLEDO si occupa esclusivamente del monitoraggio e della consultazione per questa procedura.

Collegare il collegamento equipotenziale di tutti i dispositivi alimentatore, terminale di pesa, convertitore interfaccia e piattaforma di pesatura) seguendo lo schema del terminale e tutte le norme e gli standard specifici del paese. Durante il processo, assicurarsi che:

- Tutti gli alloggiamenti dei dispositivi siano collegati allo stesso potenziale tramite i terminali EB.
- Nessuna corrente in circolazione fluisca tramite la schermatura del cavo per i circuiti intrinsecamente sicuri.
- Il punto neutro per il collegamento equipotenziale sia il più vicino possibile al sistema di pesa.

1.8. Ambiente operativo

Scelta dell'ubicazione:

- Scegliere una superficie stabile e non soggetta a vibrazioni per montare il terminale
- Accertarsi che non ci siano fluttuazioni eccessive della temperatura e che il terminale **non venga esposto alla luce diretta del sole**
- Evitare correnti d'aria sulla piattaforma di pesatura per esempio quelle provenienti da finestre aperte o aria condizionata)
- Regolare il terminale in seguito a un cambiamento sostanziale della posizione geografica

1.8.1.1. Temperatura e umidità

È possibile conservare e utilizzare l'IND256x a condizioni di temperatura e umidità relativa riportate nella Tabella 1-1.

1.8.1.2. Protezione ambientale

Il terminale IND256x è conforme alle norme di protezione ambientale come elencato nella Tabella 1-1.

1.9. Dimensioni

Nella Figura 1-3 e nella Figura 1-4 sono riportate le dimensioni del terminale. Le unità di misura sono espresse in pollici e [mm].

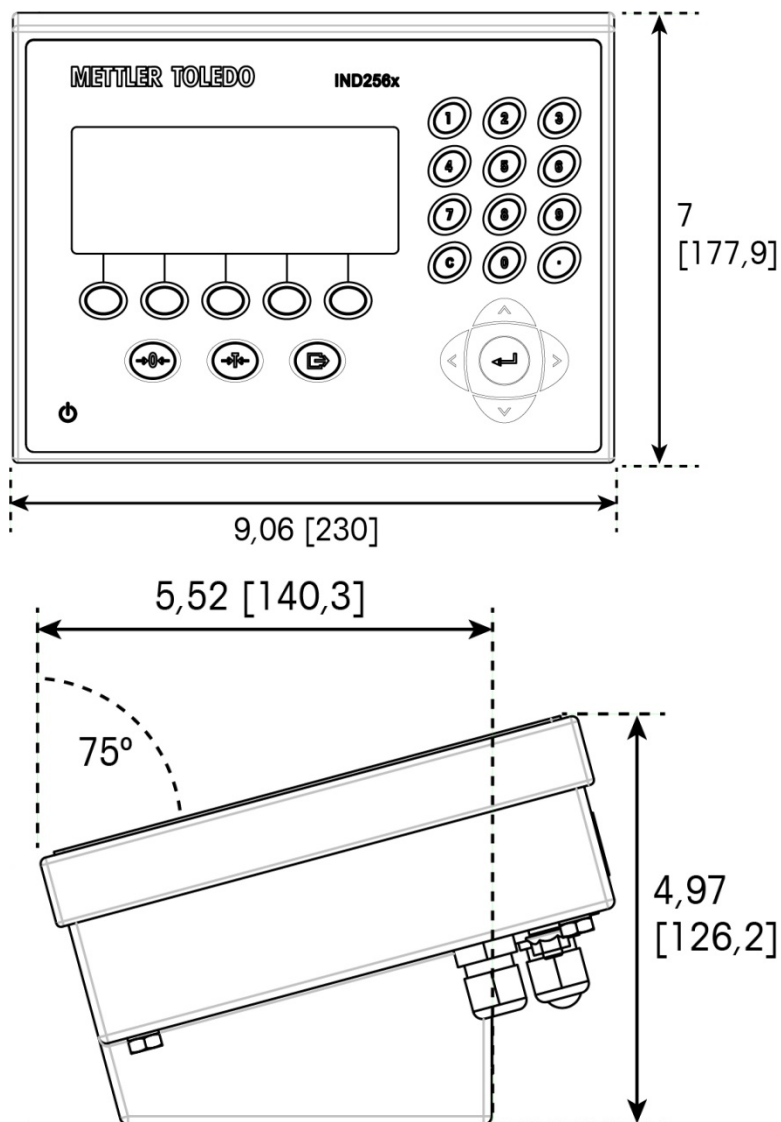


Figura 1-3: Dimensioni IND256x, installazione desktop

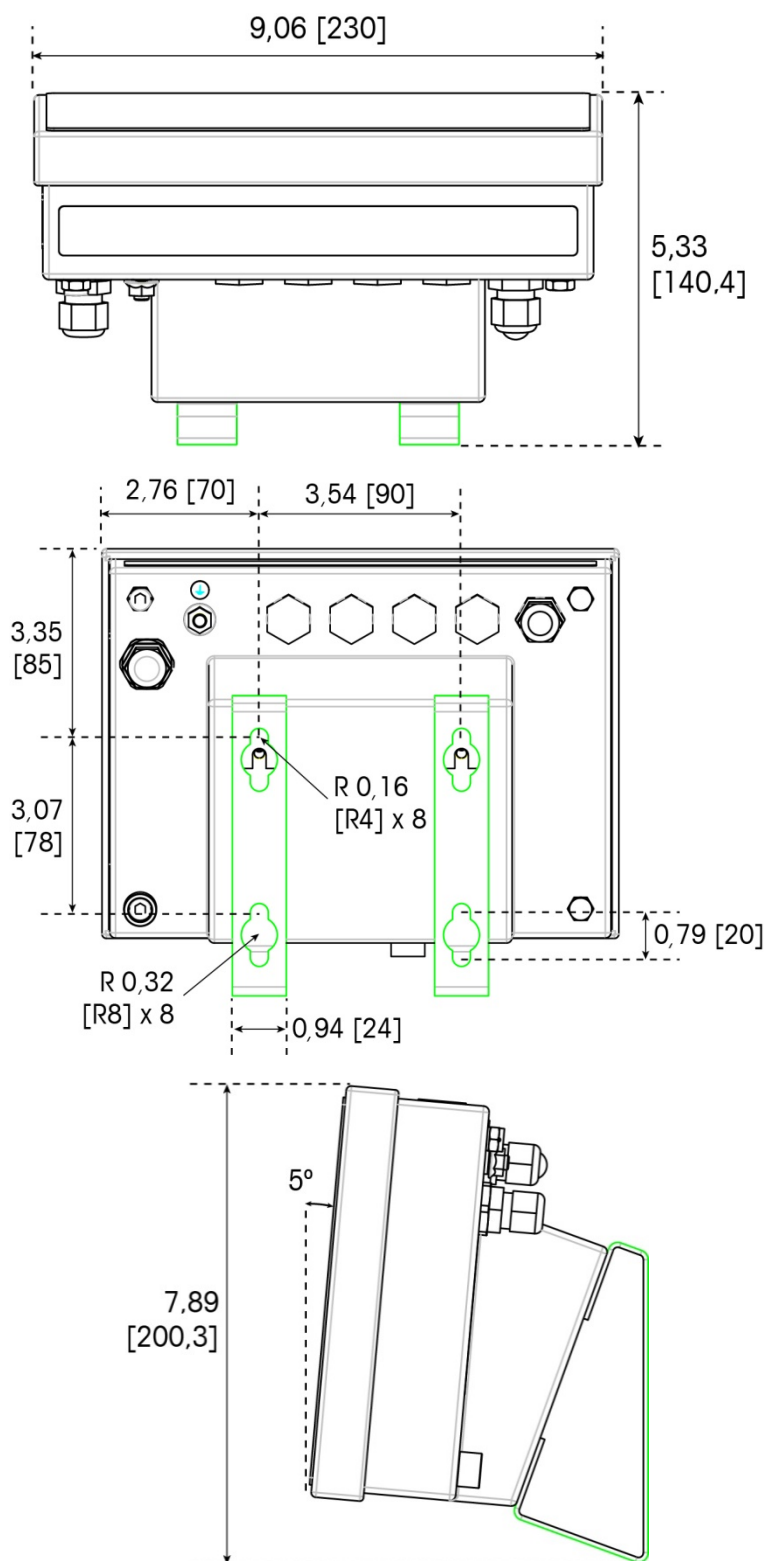


Figura 1-4: Dimensioni IND245x, con staffa fissa per montaggio a muro

1.10. Scheda madre

La scheda madre dell'IND256x presenta i seguenti collegamenti principali riportati nella Figura 1-5:

1. Interfaccia di pesatura della cella di carico analogica
2. Interfaccia di alimentazione a sicurezza intrinseca con collegamento al modulo di alimentazione
3. Interfaccia cablaggio piatta utilizzata per collegare il display
4. Interfaccia RS232 a sicurezza intrinseca COM1)
5. Interfacce scheda con due opzioni di comunicazione COM2 e COM3)

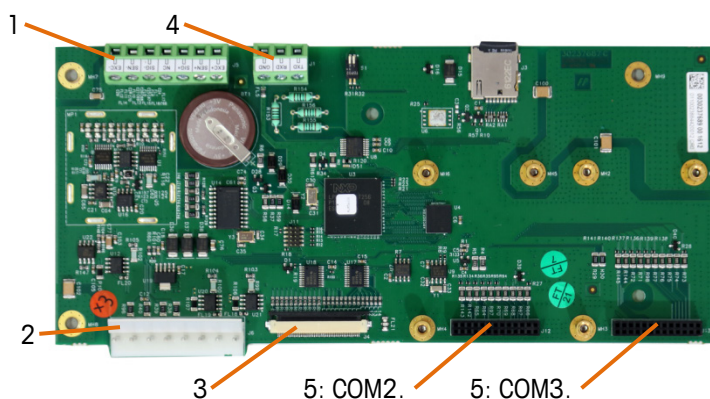


Figura 1-5: Scheda madre IND256x

1.11. Schede opzionali di comunicazione

È possibile configurare l'IND256x con un massimo di due delle tre schede opzionali di comunicazione installate all'interno dell'armadietto. Le opzioni sono:

- Modulo comunicazione Wi-Fi disponibile solo per terminali IND256x configurati di fabbrica con modulo Wi-Fi)
- Uscita analogica 4-20 mA a sicurezza intrinseca
- Anello di corrente attiva per collegamento a un modulo di comunicazione ACM200 posizionato nell'area di sicurezza o per collegare un secondo terminale IND256x configurato con l'opzione dell'anello di corrente passiva
- Circuito di corrente passiva utilizzato come secondo display per collegare un altro IND256x a un circuito di corrente attivo)

2 Installazione

2.1. Apertura dell'armadietto

	 AVVERTENZA
	L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE DEL TERMINALE IND256X DEVONO ESSERE EFFETTUATE SOLO PREVIA CONFERMA DA PARTE DELLA PERSONA QUALIFICATA RESPONSABILE DELLA MANCANZA DI CONDIZIONI DI PERICOLO NELL'AREA DI INSTALLAZIONE DELLO STESSO.
	 ATTENZIONE
	CONFERMARE LA CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE LOCALI E NAZIONALI APPLICABILI IN MATERIA DI RETE WI-FI PRIMA DI INSTALLARE E METTERE IN SERVIZIO IL TERMINALE IND256x CONFIGURATO CON IL MODULO WI-FI. METTLER TOLEDO NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER I TERMINALI INSTALLATI IN PAESI IN CUI LE NORMATIVE IN MATERIA DI WI-FI NON SONO OSSERVATE.
	 AVVERTENZA
	PREVENIRE L'IGNIZIONE DI GAS PERICOLOSI. ASSICURARSI DI AVER TOLTO LA CORRENTE PRIMA DI APRIRE L'ARMADIETTO DELL' IND256X . DOPO AVER ACCESO IND256X, LASCIARE L'ARMADIETTO RIGOROSAMENTE SIGILLATO. NON APRIRE LA SCATOLA IN PRESENZA DI POLVERI O GAS ESPLOSIVI.

Aprire il terminale IND256x seguendo i passaggi descritti nelle sezioni seguenti.

Il coperchio anteriore del terminale IND256x è fissato con 4 viti. Aprire lo strumento come indicato di seguito per la configurazione dell'hardware all'interno dello stesso:

1. Posizionare il terminale con la copertura anteriore rivolta verso il basso su una superficie piana prestando attenzione a non danneggiare l'involucro.
2. Svitare le quattro viti del coperchio indicate nella Figura 2-1.



Figura 2-1: Viti armadietto

3. Sollevare il coperchio posteriore e ruotarlo per mostrarne l'interno. Notare le due cinghie che fissano il pannello frontale all'armadietto.

2.2. Installazione dei cavi e dei connettori

Il terminale IND256x prevede i cavi e i connettori elencati di seguito:

- Premistoppa del cavo dell'armadietto per ambienti difficili
- Connessioni per il cablaggio della scheda madre
- Connessione di alimentazione

	⚠ AVVERTENZA L'UTILIZZO DEL PRESENTE STRUMENTO È CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE A PERSONALE QUALIFICATO. PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE DURANTE LE OPERAZIONI DI ISPEZIONE, TEST E REGOLAZIONE. UN UTILIZZO ERRATO POTREBBE CAUSARE LESIONI.
--	--

Il terminale IND256x è adatto agli ambienti difficili polverosi e di lavaggio. Tuttavia, durante l'installazione di cavi e/o connettori, è necessario accedere all'interno dell'armadietto del terminale. A tutti i cavi all'interno dell'armadietto viene assegnata una posizione specifica.

2.2.1. Premistoppa del cavo dell'armadietto per ambienti difficili

Per garantire resistenza all'acqua e alla polvere:

1. Prima di collegare i fili, far passare il cavo di misura opportuna attraverso il pressacavo corretto. Utilizzare cavi di diametro adeguato alle dimensioni del pressacavo. Le dimensioni richieste per i cavi sono illustrate nella Tabella 2-1.

Tabella 2-1: Diametri dei cavi per i pressacavi

Pressacavo	Diametro cavo
Cella di carico analogica	6–10 mm (0,24–0,39")

Pressacavo	Diametro cavo
COM1 (IS-RS232)	6–10 mm (0,24–0,39")
Circuito di corrente (attivo e passivo)	6–10 mm (0,24–0,39")
Cavo di alimentazione CA/CC	6–10 mm (0,24–0,39")
Batteria esterna	4-8 mm (0,16–0,3")

Avvisi importanti

- Utilizzare solo pressacavi e viti certificati ATEX con il terminale IND256x
 - I serracavi devono essere protetti da danni provocati da urti.
 - È necessario garantire un gioco al fine di evitare forze di trazione sui serracavi.
2. Quando si effettuano le terminazioni del cavo all'interno dell'armadietto per ambienti difficili, accertarsi che la lunghezza del cavo dal connettore/morsettiera del terminale all'alloggio del terminale sia sufficiente così da evitare tensioni meccaniche sul gruppo connettore quando l'alloggiamento è completamente aperto.
 3. I cavi che includono gli schermi dovrebbero prevedere la terminazione dello schermo al pressacavo come mostrato nella in Figura 2-2. Distribuire i fili dello schermo all'esterno ed assicurarsi che sia presente sufficiente filo dello schermo per creare un buon contatto con la parte in metallo del pressacavo.

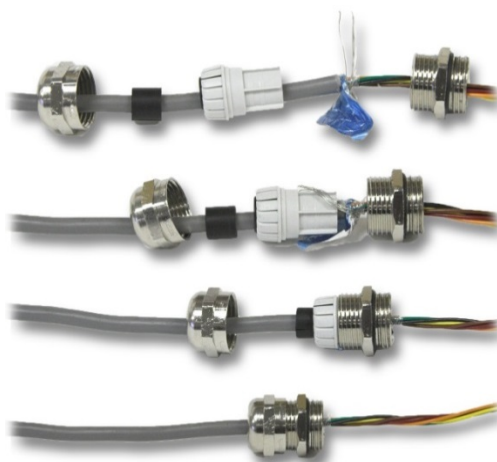


Figura 2-2: Terminazione dello schermo al pressacavo

2.2.2. Connessione per l'alimentazione

	 AVVERTENZA
	IL COLLEGAMENTO DI RETE DELL'ALIMENTATORE DEVE ESSERE ESEGUITO DA UN ELETTRICISTA ESPERTO AUTORIZZATO DAL PROPRIETARIO E IN CONFORMITÀ AL RELATIVO SCHEMA DEI TERMINALI, ALLE ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE DI CUI SONO CORREDATI E ALLE NORMATIVE NAZIONALI VIGENTI.

Nei Paesi in cui vengono accettate le certificazioni IECEx e ATEX, il terminale IND256x può essere alimentato utilizzando un alimentatore interno collegato a un ingresso di alimentazione esterno CA230V.

L'alimentazione è collegata tramite un connettore a sicurezza aumentata nell'angolo a destra all'interno dell'armadietto (Figura 2-3). Il connettore è protetto da un coperchio in plastica.

Il terminale è dotato di un cavo di alimentazione lungo 5 metri, senza spina.

2.2.2.1. Ingresso alimentazione CA interno (solo per terminali con certificazioni IECEx e ATEX)

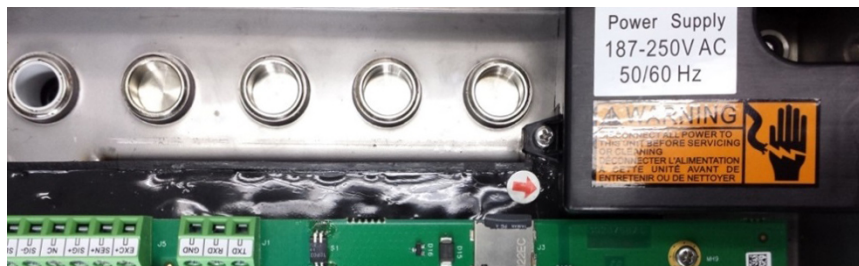


Figura 2-3: Connettore di ingresso alimentazione CA con coperchio



Figura 2-4: Connettore alimentazione CA con coperchio rimosso

Tabella 2-2: Codice colore del cavo di ingresso alimentazione CA

Pin	Colore Pin
L	Marrone
N	Blu

2.2.2.2. Ingresso alimentazione CC interno (solo per terminali con certificazioni IECEx e ATEX)

	AVVERTENZA
	L'ALIMENTATORE CC DEVE ESSERE COLLEGATO A UN INGRESSO CC DA 18-30V NON COLLEGARE AD ALIMENTAZIONE CA.

	⚠ AVVERTENZA PER I TERMINALI IND256X NELLA VERSIONE CC NON ESISTE SEPARAZIONE GALVANICA TRA IL CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE A SICUREZZA NON INTRINSECA E I CIRCUITI DI USCITA A SICUREZZA INTRINSECA. IL CIRCUITO A SICUREZZA NON INTRINSECA DEVE ESSERE MESSO CORRETTAMENTE A TERRA. E LA COMPENSAZIONE DEL POTENZIALE DEVE ESSERE PRESENTE SU TUTTI I CIRCUITI A SICUREZZA INTRINSECA. IN ALTERNATIVA, IL CIRCUITO A SICUREZZA NON INTRINSECA SELV) DEVE ESSERE SEPARATO IN SICUREZZA DALLA TERRA.
	⚠ AVVERTENZA L'ALIMENTAZIONE DI POTENZA CC ESTERNO FORNITO DAL CLIENTE DEVE AVERE UNA SOVRATENSIONE MASSIMA DI CATEGORIA II, CONFORMEMENTE ALLA IEC 60664-1.

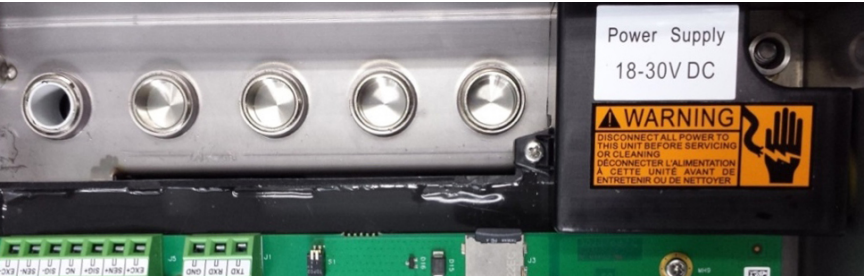


Figura 2-5: Connettore di ingresso alimentazione CC con coperchio

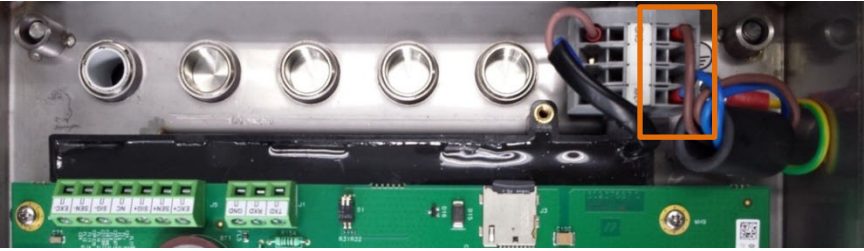


Figura 2-6: Collegamenti di ingresso alimentazione CC, vista interna

Tabella 2-3: Codice colore del cavo ingresso alimentazione CC

Pin	Colore Pin
GND	Marrone
+24V	Blu

2.2.2.3. Ingresso alimentatore NiMH esterna

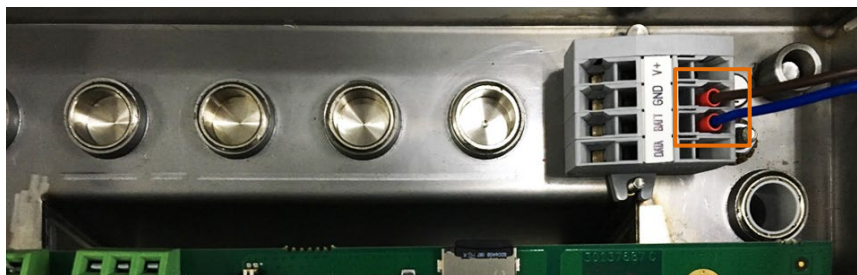


Figura 2-7: Collegamenti ingresso batteria NiMH, vista interna

Tabella 2-3: Codice colore del cavo di ingresso batteria NiMH

Pin	Colore Pin
DATI	Vuoto
BATT	Blu
GND	Marrone
V+	Vuoto

2.3. Collegamento e messa a terra

La messa a terra e le connessioni di collegamenti con potenziale simile devono essere effettuate tenendo conto delle regolamentazioni locali applicabili nel paese in cui si effettua l'installazione. Fare riferimento ai codici e disegni di controllo per ulteriori e più specifiche informazioni riguardanti la messa a terra.

Solitamente le normative locali prevedono che tutti i componenti dell'attrezzatura di un sistema siano collegati e messi a terra in un unico punto. Il terminale IND256x è dotato di una vite di messa a terra esterna speciale per un collegamento di uguale potenziale (Figura 2-8).



Figura 2-8: Vite di messa a terra terminale IND256x

2.4. Collegamento equipotenziale (EB)

Il collegamento equipotenziale deve essere installato da un elettricista autorizzato dal proprietario. L'assistenza METTLER TOLEDO si occupa esclusivamente del monitoraggio e della consultazione per questa procedura.

Collegare il collegamento equipotenziale di tutti i dispositivi (alimentatore, terminale di pesa, convertitore interfaccia e piattaforma di pesatura) seguendo lo schema del terminale e tutte le norme e gli standard specifici del paese. Durante il processo, assicurarsi che:

- Tutti gli alloggiamenti dei dispositivi siano collegati allo stesso potenziale tramite i terminali EB.
- Nessuna corrente in circolazione fluisca tramite la schermatura del cavo per i circuiti intrinsecamente sicuri.
- Il punto neutro per il collegamento equipotenziale sia il più vicino possibile al sistema di pesa.

2.4.1. Avvertenze

2.4.1.1. CENELEC

2.4.1.1.1. Connessione di EB in base alla normativa specifica del paese

Assicurarsi che gli alloggiamenti di tutti i dispositivi siano collegati allo stesso potenziale tramite i terminali EB. Nessuna corrente in circolazione può fluire tramite la schermatura del cavo per i cavi intrinsecamente sicuri.

2.4.1.2. cFMus

2.4.1.2.1. Connessioni di EB per ANSI/NFPA 70, Articolo 504, e ANSI/IA RP 12.06.01 o Canadian Electric Code C22.2

Assicurarsi che gli alloggiamenti di tutti i dispositivi siano collegati allo stesso potenziale tramite i terminali EB. Nessuna corrente in circolazione può fluire tramite la schermatura del cavo per i cavi intrinsecamente sicuri.

2.5. Chiusura dell'armadietto

Per accertarsi che il coperchio anteriore sia stato installato correttamente:

- Posizionare il coperchio anteriore su una superficie piana
- Accertarsi che l'anello di tenuta sia stato posizionato con precisione
- Montare il coperchio posteriore e assicurarsi che sia posizionato correttamente
- Installare le viti nella loro posizione originale
- Serrare ciascuna vite a 3,0 Nm

2.6. Collegamento per cella di carico analogica

Le celle analogiche sono collegate alla scheda madre sul connettore come indicato nella sezione Introduzione del Capitolo 1.

Il terminale IND256x è progettato per fornire alimentazione fino a quattro celle di carico da 350 ohm (o una resistenza minima di circa 87 ohm). Per confermare che la cella di carico per l'installazione rientri nei limiti, è necessario calcolare la resistenza totale della bilancia (Total Scale Resistance - TSR).

Per calcolare la TSR:

$$TSR = \frac{\text{Resistenza di ingresso della cella di carico (}\Omega\text{ms)}}{\text{Numero di celle}}$$


Prima di connettere le celle di carico, accertarsi che la TSR della rete delle celle di carico da connettere all'IND256x sia superiore a 87 Ohm. Se la resistenza è inferiore a 87 ohm, l'IND256x non funzionerà correttamente.

Inoltre, è necessario esaminare la distanza massima del cavo. La Tabella 2-4 fornisce le lunghezze massime consigliate per il cavo in base al diametro del cavo e al corretto funzionamento del terminale. Tenere presente che i valori dell'entità per il cavo della cella di carico vanno considerati come fattore di sicurezza durante l'installazione.

Tabella 2-4: Lunghezze massime consigliate per il cavo

TSR (Ohm)	Misura 24 (metri/piedi)	20 Gauge (metri/piedi)	16 Gauge (metri/piedi)
1-4 celle da 350 Ω	60/200	182/600	304/1000

La Figura 2-9 mostra il cablaggio per le celle di carico analogiche. Quando viene utilizzata una cella a quattro conduttori, occorre cortocircuitare +Exc con +Sen e -Exc con -Sen.

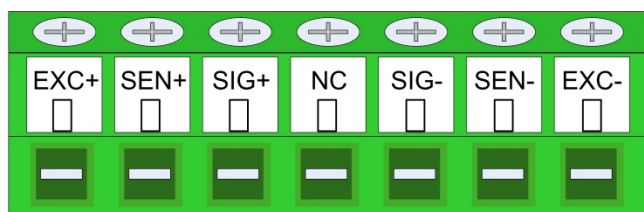

NOTE
 1. DIMENSIONI FILO: 18 AWG (0.823 mm²) MAX.,
 24 AWG (0.205 mm²) MIN.
 2. TERRA DELLO CHASSIS: PREMISTOPPA
 METALLO

Figura 2-9: Terminazione cella di carico

2.7. Collegamento schede di comunicazione

2.7.1. Porta seriale (COM1)

La porta COM1 prevede connessioni per un dispositivo seriale intrinsecamente sicuro. La Figura 2-10 mostra il connettore della porta COM1. La lunghezza del cavo per questo collegamento non supera i 10 m (33 piedi).

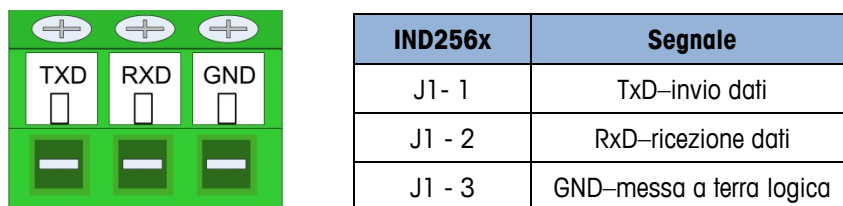


Figura 2-10: Segnali porta COM1

Nella Figura 2-11 viene riportato un esempio della connessione a un dispositivo RS-232 nell'area sicura tramite una barriera a diodi Zener. Durante la selezione della barriera, fare riferimento ai valori di approvazione dell'entità della COM1. Tenere presente che tutti i sigilli e gli altri dispositivi di protezioni saranno necessari per la conformità ai codici di cablaggio nelle aree pericolose.

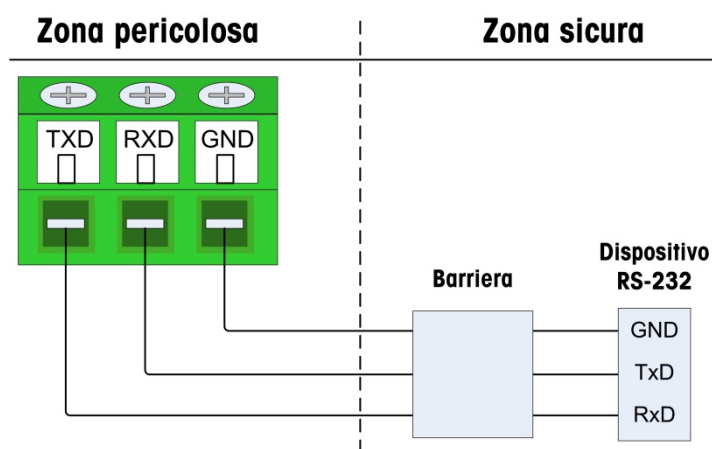


Figura 2-11: Connessione RS-232 campione

Una barriera testata per il corretto funzionamento con l'IND256x e che può essere collegata direttamente alla COM1 è:

- MTL7761Pac (certificazioni IECEx e ATEX)

2.7.2.

Circuito di corrente attivo


È possibile installare la scheda opzionale del circuito di corrente attivo esclusivamente nella presa COM3 della scheda madre. Quando il terminale IND256x è collegato all'ACM200, è necessario collegare quest'ultimo utilizzando il circuito di corrente attivo per garantire la comunicazione nell'area di sicurezza.

Tabella 2-5: Collegamenti del circuito di corrente attivo a ACM200

IND256x COM3 (J2)	ACM200 COM (J3)
1	4
2	3
3	2
4	1

I cavi specifici del cliente per i circuiti intrinsecamente sicuri devono essere personalizzati nel modo seguente:

	IND256x – ACM200
Cavo	2 x 2 x 0,5 mm ²
Dimensione A (IND256x)	110 mm (2,4")
Dimensione B (ACM200)	70 mm (2,8")
Lunghezza Max.	300 m (1000 ft)

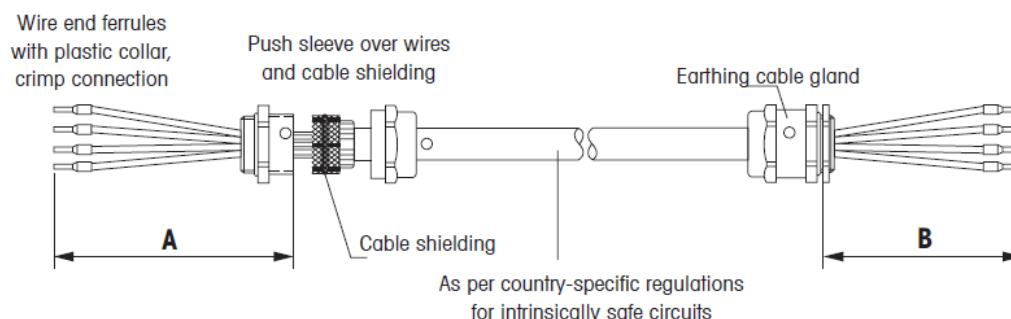

1. Ridurre il cavo alla lunghezza necessaria e spellarne le estremità in base alla dimensione A/B.
2. Ridurre la schermatura del cavo su entrambi i lati a 10 mm (0,4").
3. Spellare le estremità del cavo.
4. Crimpa i capicorda alle estremità del cavo con uno strumento di crimpatura.
5. Spingere la seconda sezione del pressacavo di terra, quella posteriore, nel cavo.
6. Applicare la schermatura del cavo solo all'estremità dell'IND256x spingendo la guaina sui cavi e sulla schermatura e ripiegandola sulla schermatura stessa.
7. Fare pressione sulla parte frontale del pressacavo e avvitare sulla parte posteriore.

2.7.3.

Circuito di corrente passivo

Nel caso in cui il terminale IND256x sia collegato a un altro sistema di pesatura IND256x come display remoto, è necessario collegare l'interfaccia del circuito di corrente passivo al circuito di corrente attivo di un altro terminale IND256x. È possibile installare il circuito di corrente passivo esclusivamente nella presa COM3 della scheda madre.

Tabella 2-6: Collegamento del circuito di corrente passivo tra i terminali

IND256x COM3 (circuito di corrente passivo J4) (Display remoto)		IND256x COM3 (circuito di corrente attivo J2) (Strumento che collega la piattaforma di pesatura)
1	←→	1
2	←→	2
3	←→	3
4	←→	4

2.7.4. Uscita analogica 4-20 mA intrinsecamente sicura

La scheda di comunicazione analogica opzionale intrinsecamente sicura 4-20 mA si collega alla porta COM2 sulla scheda madre dell'IND256x. Fornisce un segnale analogico da 4-20 mA intrinsecamente sicuro, proporzionale al peso applicato alla bilancia o al tasso di variazione del peso sulla bilancia. La lunghezza massima del cavo per il collegamento dell'uscita analogica è 300 m/980 piedi. Il cavo utilizzato per il segnale dell'uscita analogica deve essere schermato.

■ Questa opzione non può essere usata con l'opzione WiFi.



Figura 2-12: Scheda opzionale uscita analogica intrinsecamente sicura

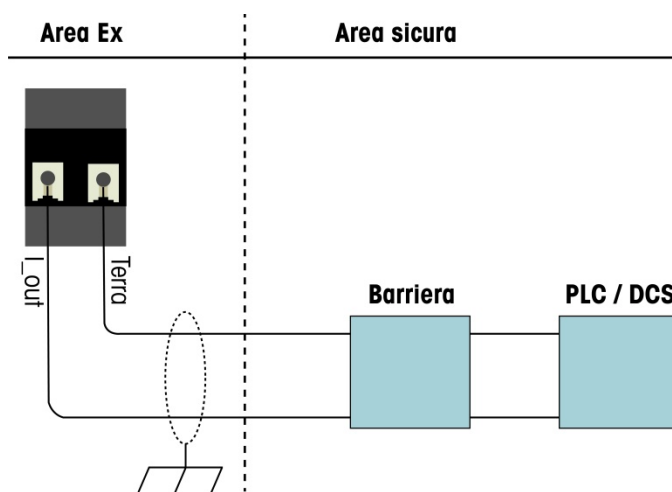


Figura 2-13: Cablaggio uscita Analogica

La barriera isolata analogica KFD2-STC4-EX1 prodotta da P&F (numeri di certificato: IECEx BAS 04.0016X; BAS 99 ATEX 7060X) è stata verificata e può essere collegata direttamente con l'opzione analogica a 4-20 mA intrinsecamente sicura dell'IND256x e poi collegata ad un sistema PLC o DCS nell'area sicura.

2.7.5. Comunicazione wireless

La scheda opzionale di comunicazione wireless dell'IND256x è installata sulla scheda madre con le altre schede opzionali e non è collegata alle periferiche. L'opzione deve essere configurata come descritto nel Capitolo 3, sezione 3.8.4. Per ottenere la comunicazione wireless con le periferiche è necessario un segnale WiFi forte.

L'IND256x supporta una singola opzione WiFi.

- Questa opzione non può essere usata insieme all'opzione di uscita analogica 4-20 mA intrinsecamente sicura.



Figura 2-14: Antenna e scheda opzionale WiFi IND256x

2.8. Sigillatura dell'armadietto

Quando l'IND256x è in modalità "Approvazione", è necessario un sigillo esterno.

I dettagli relativi al sigillo in piombo sono riportati nella Figura 2-15. Di seguito la procedura da seguire:

1. Accertarsi di aver selezionato l'area corretta in **Bilancia > Tipo > Approvazione** e impostare l'interruttore metrologico SW1-1 su ON (consultare il Capitolo 2, **Funzionamento** per verificare la posizione e la funzione di questo interruttore).
2. Far passare il cavo di tenuta attraverso due bulloni di tenuta adiacenti, quindi fissare il fermo del sigillo come mostrato nella Figura 2-15.
3. Tagliare il cavo in eccesso del sigillo in piombo.

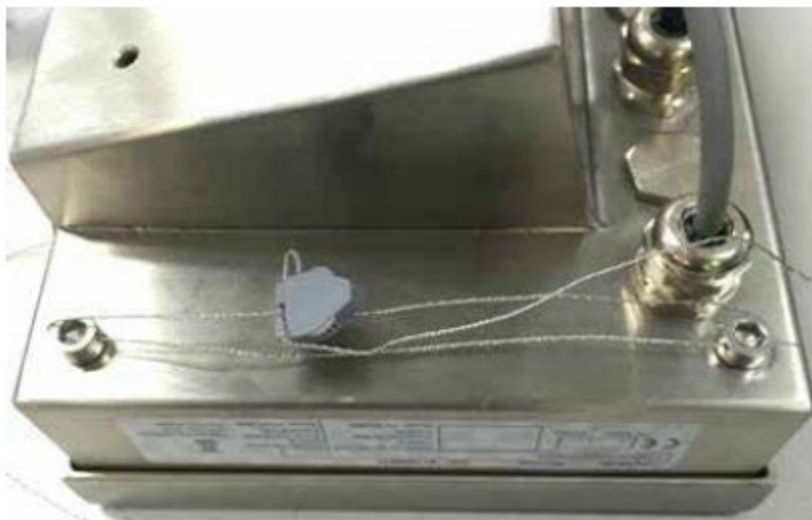


Figura 2-15: Metodo di sigillatura

2.9. Parametri di interfaccia

2.9.1. Circuito di alimentazione (porta alimentazione)

Circuito di alimentazione	Parametri
Variante con alimentazione CA non intrinsecamente sicura (la chiave del tipo termina con con "46" o "44") (solo approvati ATEX e IECEx) Cavo collegato in modo permanente con ferrite	Tensione nominale: CA 187...250 V (50/60 Hz) Corrente nominale: 125 mA Tensione massima in entrata: Um CA 250 V
Variante con alimentazione CC non intrinsecamente sicura (la chiave del tipo termina con con "56" o "54") (solo approvati ATEX e IECEx) Cavo collegato in modo permanente con ferrite: Blu: +24V, Marrone: gnd, Verde-giallo: PE	Tensione nominale: CC 18...30 V Corrente nominale: 250 mA Tensione massima in entrata su apparecchi associati: Um CA 250 V (Note: la tensione nominale è inferiore)
Variante con alimentazione CC intrinsecamente sicura (batteria) (la chiave del tipo termina con con "25" o "27") Terminali di connessione: V+, GND, BATT, DATA	Tensione nominale ingresso: CC 10 V Corrente nominale ingresso: 350 mA
	Tensione massima ingresso: Ui CC12,8 V Massima corrente in ingresso: Ii 3,03 A Potenza massima in ingresso: Pi 6,83 W
	Induttanza effettiva interna: Li trascurabile Capacitanza interna effettiva: Ci trascurabile

2.9.2. Interfaccia RS232 intrinsecamente sicura

Interfaccia RS232 intrinsecamente sicura	Parametri
Terminali J1.1 (TXD), J1.2(RXD) – J1.3 (GND)	Tensione massima in ingresso: U_i CC ± 10 V
	Capacitanza interna effettiva: C_i trascurabile
	Induttanza effettiva interna: L_i trascurabile
	Massima corrente in uscita: U_o CC
	J1.1-GND risp. J1.2-GND ciascuno: $\pm 5,36$ V
	Massima corrente in uscita: I_o
	J1.1-GND risp. J1.2-GND ciascuno: $\pm 12,9$ mA
	Massima potenza emessa: P_o
	J1.1-GND risp. J1.2-GND ciascuno: 17,2 mW
	Capacitanza esterna massima: C_o 100 nF
	Induttanza esterna massima: L_o 100 μ H

2.9.3. Uscita intrinsecamente sicura per la connessione a una cella di carico

Uscita intrinsecamente sicura per la connessione a una cella di carico	Parametri
Terminali J5.1 (EXC+), J5.2 (SEN+), J5.3 (SIG+), J5.5 (SIG-), J5.6 (SEN-), J5.7 (EXC-)	Massima corrente in uscita: U_o CC 5,88 V
	Massima corrente in uscita: I_o 171 mA
	Massima potenza emessa: P_o 940 mW
	Capacitanza esterna massima: C_o 6,8 μ F
	Induttanza esterna massima: L_o 0,3 mH

2.9.4. Interfacce scheda di comunicazione opzionale

Interfacce delle schede di comunicazione opzionali	Parametri
Interfaccia 4-20 mA intrinsecamente sicura Solo per le varianti con scheda opzionale uscita analogica (chiave di tipo "A") Terminali J2.1 (I_OUT) – J2.2 (GND)	Massima tensione in ingresso: U_i CC 3,5 V
	Massima corrente in ingresso: I_i 115 mA
	Capacitanza interna massima: C_i 110 nF
	Induttanza interna massima: $L_o=0$
	Massima corrente in uscita: U_o CC 13,65 V
	Massima corrente in uscita: I_o 115 mA
	Massima potenza emessa: P_o 0,4 W
	Capacitanza esterna massima: C_o 680 nF
	Induttanza esterna massima: L_o 400 μ H
Connessione antenna WiFi Solo per le varianti con scheda opzionale WiFi (chiave di tipo "A") Connettore IPEX per la connessione all'antenna esterna, tipo AC-Q24-50ZD	Massima potenza RF: $< 1,3$ W
	Frequenza: 2400...2483 MHz
Interfaccia circuito di corrente attivo intrinsecamente sicuro Solo per le varianti con scheda opzionale	Massima corrente in uscita: U_o CC 5,36 V
	Massima corrente in uscita: I_o 131 mA
	Massima potenza emessa: P_o 176 mW

Interfacce delle schede di comunicazione opzionali	Parametri
circuito corrente attivo (chiave di tipo "E") Morsettiera J2, terminali J2.1...J2.4 (CL attivo)	Capacitanza esterna massima: Co 600 nF Induttanza esterna massima: Lo 400 µH
Interfaccia circuito di corrente passivo intrinsecamente sicuro Solo per le varianti con scheda opzionale circuito corrente passivo (chiave di tipo "P") Morsettiera J4, terminali J4.1...J4.4 (CL passivo)	Tensione massima ingresso: Ui CC 10 V Massima corrente in ingresso: Ii 300 mA Potenza Massima in ingresso: Pi 500 mW
	Capacitanza interna effettiva: Ci 110 nF Induttanza effettiva interna: Li trascurabile

2.9.5. Intervallo di temperatura ambiente

Parametri
Intervallo di temperatura ambiente: Ta -10 °C...+40 °C

IND256x

Terminal de pesagem



METTLER TOLEDO

Terminal de pesagem IND256x

METTLER TOLEDO Service

Serviços essenciais para o desempenho confiável

Parabéns por escolher a qualidade e precisão da METTLER TOLEDO. O uso adequado de seu novo equipamento de acordo com este manual e a calibração e manutenção regulares feitas por nossa equipe treinada na fábrica garante uma operação confiável e precisa, protegendo o seu investimento. Entre em contato para discutirmos um contrato de serviço adequado às suas necessidades e ao seu orçamento. Mais informações estão disponíveis em www.mt.com/service.

Há vários meios importantes para garantir que o desempenho de seu investimento seja o ideal:

1. **Registre seu produto:** Convidamos você a registrar seu produto em www.mt.com/productregistration para que possamos informá-lo sobre melhorias, atualizações e notificações importantes sobre o seu produto.
2. **Se precisar de serviço, fale com a METTLER TOLEDO:** O valor de uma medição é proporcional à sua exatidão – uma balança fora da especificação pode reduzir a qualidade, diminuir os lucros e aumentar a responsabilidade. A manutenção da METTLER TOLEDO em tempo hábil garante a exatidão e otimiza o tempo de operação e a vida do equipamento.
 - a. **Instalação, configuração, integração e treinamento:** Nossos representantes de serviços treinados na fábrica são especialistas em equipamentos de pesagem. Asseguramos que seu equipamento de pesagem está pronto para produzir de maneira rentável e no momento adequado e que o pessoal é treinado para o sucesso.
 - b. **Documentação de calibração inicial:** O ambiente de instalação e os requisitos da aplicação são peculiares para cada balança industrial, por isso o desempenho deve ser testado e certificado. Nossos serviços de calibração e certificados documentam a exatidão para garantir a qualidade da produção e fornecer um registro de desempenho para o sistema de qualidade.
 - c. **Manutenção da calibração periódica:** Um Contrato de Serviço de Calibração confere confiabilidade contínua ao seu processo de pesagem e uma documentação de conformidade aos requisitos. Oferecemos uma variedade de planos de serviço programados para atender às suas necessidades e idealizados para se adequarem a seu orçamento.
 - d. **Verificação GWP®:** Uma abordagem baseada em riscos para gerenciar o equipamento de pesagem permite controlar e aprimorar todo o processo de medição, que garante qualidade de produto reproduzível e minimiza os custos do processo. O GWP (Good Weighing Practice), o padrão com base em ciência para gerenciamento de um ciclo de vida eficiente de equipamento de pesagem, fornece respostas claras sobre como especificar, calibrar e garantir precisão do equipamento de pesagem, independente da marca.

© METTLER TOLEDO 2019

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida ou transmitida em qualquer formato ou por meios eletrônicos ou mecânicos, inclusive fotocópia e gravação, para qualquer finalidade sem a expressa permissão escrita da METTLER TOLEDO.

Direitos restritos do governo dos EUA: Esta documentação é fornecida com Direitos restritos.

Copyright 2019 METTLER TOLEDO. Esta documentação contém informações proprietárias da METTLER TOLEDO. Ela não pode ser copiada total ou parcialmente sem o consentimento expresso por escrito da METTLER TOLEDO.

A METTLER TOLEDO reserva-se o direito de fazer melhorias ou alterações no produto e no manual sem prévio aviso.

COPYRIGHT

METTLER TOLEDO® é marca registrada da Mettler-Toledo, LLC. Todas as demais marcas e nomes de produto são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de suas respectivas empresas.

A METTLER TOLEDO RESERVA-SE O DIREITO DE FAZER MELHORIAS OU ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO.

Notificação FCC


Este dispositivo atende a Parte 15 das Normas FCC e os Requisitos para rádio interferência do Departamento Canadense de Telecomunicações. A operação está sujeita às seguintes condições: (1) este dispositivo pode causar interferência prejudicial e (2) é necessário que ele aceite toda e qualquer interferência recebida, inclusive interferências que ocasionem operação indesejada.


Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe A, conforme a Parte 15 das Normas FCC. Estes limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais quando o equipamento for operado em um ambiente comercial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. A operação deste equipamento em uma área residencial pode causar interferência prejudicial, caso em que o usuário será obrigado a corrigir a interferência por sua própria conta.

- A Declaração de conformidade está disponível em <http://glo.mt.com/global/en/home/search/compliance.html/compliance/>.

Precauções

- LEIA este manual ANTES de usar ou fazer a manutenção deste equipamento e SIGA cuidadosamente estas instruções.
- GUARDE este manual para consulta futura.

	 ATENÇÃO
	NÃO INSTALE NEM EFETUE QUALQUER MANUTENÇÃO NESTE EQUIPAMENTO ANTES QUE A ÁREA NA QUAL SE ENCONTRA O IND245x TENHA SIDO PROTEGIDA PELO PESSOAL AUTORIZADO PELO RESPONSÁVEL NO SITE DO CLIENTE.
	 PRECAUCIÓN
	CONFIRME A CONFORMIDADE COM REGULAMENTOS NACIONAIS E LOCAIS DE WIFI ANTES DE INSTALAR E COMMISSIONAR O TERMINAL IND256x CONFIGURADO COM MÓDULO WIFI. A METTLER TOLEDO NÃO SE RESPONSABILIZA PELA INSTALAÇÃO DE TERMINAIS EM PAÍSES NOS QUAIS OS REGULAMENTOS DE WIFI NÃO FOREM CUMPRIDOS.
	 ATENÇÃO
	SE O TECLADO, AS LENTES OU O LA CAJA DO DISPLAY DO IND245x ESTIVEREM DANIFICADOS, O COMPONENTE COM DEFEITO PRECISA SER SUBSTITUÍDO IMEDIATAMENTE. SUSPENDA A ENERGIA IMEDIATAMENTE E NÃO A REAPLIQUE ATÉ QUE AS LENTES DO VISOR, O TECLADO OU O LA CAJA TENHA SIDO REPARADO OU SUBSTITUÍDO POR PESSOAL QUALIFICADO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DEIXAR DE FAZÊ-LO PODE RESULTAR EM LESÃO CORPORAL E/OU DANOS À PROPRIEDADE.
	 ATENÇÃO
	EVITE A CARGA ELECTROSTÁTICA DURANTE O FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO.
	 ATENÇÃO
	OPERAÇÃO SÓ É PERMITIDA QUANDO OPERACIONAL E PROCESS RELATED ELECTROSTATIC CARGOS NÃO ESTÃO PRESENTES.
	 ATENÇÃO
	USE O TERMINAL DE PESAGEM SOMENTE QUANDO NÃO HOUVER POSSIBILIDADE DE PROCESSOS ELETROSTÁTICOS GERAREM DESCARGAS ELÉTRICAS.
	 ATENÇÃO
	MANTENHA O TERMINAL AFASTADO DE PROCESSOS QUE GERAM ALTO POTENCIAL DE CARGA ELETROSTÁTICA, COMO REVESTIMENTO ELETROSTÁTICO, TRANSFERÊNCIA RÁPIDA DE MATERIAIS NÃO CONDUTORES, JATOS DE AR RÁPIDOS E AEROSSÓIS DE ALTA PRESSÃO.
	 ATENÇÃO
	NÃO USE PANOS SECOS PARA LIMPAR O TERMINAL DE PESAGEM. SEMPRE USE UM PANO ÚMIDO PARA LIMPAR O TERMINAL, COM DELICADEZA.

	 ATENÇÃO
	USE ROUPAS ADEQUADAS. EVITE NYLON, POLIÉSTER OU OUTROS MATERIAIS SINTÉTICOS QUE GERAM E SUSTENTAM CARGA. USE CALÇADOS E CHÃO CONDUTORES.
	 ATENÇÃO
	EVITE COBERTURAS PLÁSTICAS SOBRE O TERMINAL.
	 ATENÇÃO
	PROVIDENCIE O ATERRAMENTO EQUIPOTENCIAL DO TERMINAL, ACESSÓRIOS DE MONTAGEM E BASE DA BALANÇA.
	 ATENÇÃO
	PROTEJA O TERMINAL DA LUZ UV.
	 ATENÇÃO
	É PRECISO GARANTIR O ALÍVIO DE TENSÃO SUFICIENTE PARA EVITAR A RESISTÊNCIA À TENSÃO NOS PRENSA-CABOS.
	 ATENÇÃO
	NA VERSÃO DE CC DO TERMINAL IND256x, NÃO HÁ SEPARAÇÃO GALVÂNICA ENTRE O CIRCUITO DE ENERGIA NÃO INTRINSECAMENTE SEGURO E OS CIRCUITOS DE SAÍDA INTRINSECAMENTE SEGUROS. CONECTE O CIRCUITO NÃO INTRINSECAMENTE SEGURO AO ATERRAMENTO COM SEGURANÇA. É PRECISO HAVER A POSSIBILIDADE DE EQUALIZAR OS CIRCUITOS INTRINSECAMENTE SEGUROS. OUTRA POSSIBILIDADE É SEPARAR O CIRCUITO NÃO INTRINSECAMENTE SEGURO (SELV) DO ATERRAMENTO COM SEGURANÇA.
	 ATENÇÃO
	A CATEGORIA DE SOBRETENSÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO CC EXTERNA FORNECIDA PELO CLIENTE DEVE SER NO MÁXIMO II, DE ACORDO COM A DIRETIVA IEC 60664-1.
	 ATENÇÃO
	PROTEJA OS PRENSA-CABOS DE POSSÍVEIS IMPACTOS DANOSOS.
	 ATENÇÃO
	O TERMINAL MONTADO COM UMA ANTENA WIFI DEVE SER INSTALADO EM UMA POSIÇÃO TAL QUE O RISCO DE DANOS MECÂNICOS SEJAM PEQUENOS. SUBSTITUA A ANTENA WIFI IMEDIATAMENTE SE ESTIVER DANIFICADA!

	 ATENÇÃO OS TERMINAIS IND256x COM WI-FI E CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA SÃO APROVADOS PARA USO EM ÁREAS CLASSIFICADAS COMO ZONA 1, GRUPO DE EQUIPAMENTO IIB. NÃO USE OS TERMINAIS IND256x COM WI-FI E CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA EM ÁREAS CLASSIFICADAS COMO GRUPO DE EQUIPAMENTO IIC. O USO DO TERMINAL IND256X COM WI-FI E CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA EM UMA ÁREA CLASSIFICADA PARA A QUAL ELE NÃO FOI APROVADO PODE CAUSAR LESÕES FÍSICAS E/OU DANOS À PROPRIEDADE.
	 ATENÇÃO A FONTE DE ALIMENTAÇÃO CC EXTERNA FORNECIDA PELO CLIENTE DEVE TER UMA CATEGORIA MÁXIMA DE SOBRETENSÃO II, DE ACORDO COM A IEC 60664-1.
	 ATENÇÃO NÃO ABRA O TERMINAL SE HOUVER PÓ EXPLOSIVO NA ATMOSFERA. DESLIGUE O IND256x DA FONTE DE ENERGIA ANTES DE ABRIR O LA CAJA PARA EVITAR A IGNIÇÃO EM AMBIENTES PERIGOSOS. FECHER BEM A TAMPA ANTES DE LIGAR O CIRCUITO. NÃO A ABRA EM PRESENÇA DE ATMOSFERA EXPLOSIVA.
	 ATENÇÃO TODO O EQUIPAMENTO DEVE SER INSTALADO DE ACORDO COM O DESENHO Nº 30282892B DO DOCUMENTO DO FABRICANTE E OS CÓDIGOS LOCAIS APLICÁVEIS.
	 ATENÇÃO SOMENTE OS COMPONENTES ESPECIFICADOS NO GUIA DE INSTALAÇÃO INCLUSO NO CD-ROM 30512916 DA DOCUMENTAÇÃO PODEM SER USADOS NESSE DISPOSITIVO. TODO O EQUIPAMENTO DEVE SER INSTALADO DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO. COMPONENTES INCORRETOS OU SUBSTITUÍDOS E/OU O DESVIO DESSAS INSTRUÇÕES PODEM PREJUDICAR A SEGURANÇA INTRÍNSECA DO TERMINAL E PODEM RESULTAR EM LESÃO CORPORAL E/OU DANOS À PROPRIEDADE.
	 ATENÇÃO PARA PROTEÇÃO CONTINUA CONTRA PERIGO DE CHOQUE CONECTE SOMENTE A UMA TOMADA DEVIDAMENTE ATERRADA. NÃO REMOVA O PINO TERRA.
	 ATENÇÃO QUANDO ESTE EQUIPAMENTO FOR INCLUÍDO COMO PARTE COMPONENTE DE UM SISTEMA, O DESIGN RESULTANTE DEVE SER REVISADO POR PESSOAL QUALIFICADO QUE ESTEJA FAMILIARIZADO COM A CONSTRUÇÃO E A OPERAÇÃO DE TODOS OS COMPONENTES NO SISTEMA E COM OS RISCOS POTENCIAIS ENVOLVIDOS. A NÃO OBSERVAÇÃO DESSA PRECAUÇÃO PODE RESULTAR EM LESÃO CORPORAL E/OU DANOS À PROPRIEDADE.
	 ATENÇÃO PERMITA APENAS QUE PESSOAL QUALIFICADO REALIZE A MANUTENÇÃO DO IND245x. TENHA CUIDADO AO REALIZAR VERIFICAÇÕES, TESTES E AJUSTES QUE PRECISAM SER FEITOS COM A ENERGIA LIGADA. A NÃO OBSERVAÇÃO DESSAS PRECAUÇÕES PODE RESULTAR EM LESÃO CORPORAL E/OU DANOS À PROPRIEDADE.
	 ATENÇÃO ANTES DE CONECTAR/DESCONECTAR QUALQUER COMPONENTE ELETRÔNICO INTERNO OU INTERCONECTAR A FIAÇÃO ENTRE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, SEMPRE REMOVA A ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA E AGUARDE NO MÍNIMO TRINTA (30) SEGUNDOS ANTES DO PROCEDIMENTO. A NÃO OBSERVAÇÃO DESSAS PRECAUÇÕES PODE RESULTAR EM DANO AO, OU DESTRUIÇÃO DO EQUIPAMENTO.

**AVISO****SIGA ESTAS PRECAUÇÕES AO MANUSEAR DISPOSITIVOS SENSÍVEIS À ELETRICIDADE ESTATICA.****Requisito sobre disposição segura**

Em conformidade com a Diretiva Europeia 2002/96/EC sobre Descarte de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (WEEE) este dispositivo não deve ser descartado como resíduo doméstico. Isto também é aplicável a países fora da EU, conforme requisitos específicos.



Descarte este dispositivo conforme os requisitos locais nos pontos de coleta especificados para equipamentos elétricos e eletrônicos.

Se tiver dúvidas, entre em contato com a autoridade responsável ou distribuidor de quem adquiriu este equipamento.

Se este dispositivo for transferido a terceiros (para uso privado ou profissional), é necessário que o teor deste regulamento também esteja associado.

Agradecemos sua contribuição à proteção do meio ambiente.

Sumário

1	Introdução	1-1
1.1.	Introdução ao IND256x	1-1
1.2.	Especificação do Produto.....	1-2
1.3.	Padrões de teste	1-4
1.4.	Advertências e Precauções.....	1-6
1.5.	Inspeção e Lista de Verificação de Conteúdo	1-6
1.6.	Configuração.....	1-7
1.7.	Ligação Equipotencial (EB).....	1-9
1.8.	Ambiente de Operação.....	1-9
1.9.	Dimensões.....	1-10
1.10.	Placa Principal	1-12
1.11.	Placas Opcionais de Comunicação	1-12
2	Instalação	2-1
2.1.	Como Abrir o Gabinete.....	2-1
2.2.	Instalação de Cabos e Conectores	2-2
2.3.	Conexão e Aterramento	2-6
2.4.	Ligação Equipotencial (EB).....	2-6
2.5.	Fechamento do Gabinete	2-7
2.6.	Conexão Analógica de Célula de Carga	2-7
2.7.	Conexão de Placas de Comunicação	2-8
2.8.	Vedação do Gabinete	2-12
2.9.	Parâmetros da Interface	2-13

1 Introdução

1.1. Introdução ao IND256x

O IND256x reflete a última tecnologia de pesagem da METTLER TOLEDO. O IND256x foi aprovado em certificação de terceiros para pesagem em áreas perigosas e pode ser diretamente utilizado em locais com classificações de Zona 1/Zona 21.

Um terminal de pesagem de faixa única ou múltiplas faixas de alto desempenho, o IND256x usa células de carga analógicas para obter uma pesagem de baixo custo, desde poucas gramas até toneladas. Ele é facilmente integrado em sistemas de pesagem já existentes.

Ao se conectar à barreira de segurança apropriada ou à barreira isolada, o IND256x pode fornecer diversas interfaces intrinsecamente seguras para comunicação com PCs e impressoras na área segura. Esses recursos permitem que o IND256x ofereça suporte à maioria de aplicações de pesagem na grande maioria dos campos industriais, incluindo:

- Farmácia
- Petroquímicos
- Engenharia de Produtos Químicos Refinados
- Processos em Pó
- Agricultura
- Produtos Químicos Especiais
- Corantes e Tintas

1.1.1. Versão do Terminal IND256x

O IND256x está disponível com três opções diferentes de alimentação:

- Entrada de energia CA, usando a tensão alternada externa (187-250 V 50/60 Hz)
- Entrada de energia CC, usando a tensão direta externa (CC 18-30 V)
- Entrada de energia intrinsecamente segura, usando o pacote de baterias NiMH Ex externo (64060627)

Cada uma dessas versões recebeu aprovações ATEX e IECEx para uso em áreas classificadas como Zona 1 e Zona 21.

1.1.2. Características do Produto IND256x

- Pesagem básica em áreas perigosas, incluindo as funções zerar, tara e imprimir.
- Gabinete para ambiente adverso montado em mesa, coluno ou pared
- Conecta-se a uma plataforma de pesagem analógica única
- LCD de backlight branca com 240 x 96 pixels, e dígitos com altura de 25 mm
- Relógio em tempo real (desligamento automático para poupar energia)

- Inclui uma porta serial intrinsecamente segura (COM1) para saída de impressão e comunicação bilateral assíncrona
- Suporte para as seguintes placas opcionais internas:
 - Saída analógica intrinsecamente segura de 4-20 mA
 - Módulo de comunicação WiFi com antena (apenas para terminais IND256x configurados de fábrica com módulo WiFi)
 - Loop de corrente ativo – para conexão a um módulo de comunicação ACM200 localizado na área segura, ou para conectar um segundo terminal IND256x configurado com opção de loop de corrente passivo
 - Loop de corrente passivo (usado como um segundo display para conectar outro terminal com um loop de corrente ativo)
- Permite três entradas de ID personalizadas
- Tabela de alvos permite 25 alvos predefinidos para Verificação de Peso
- Tabela de taras oferece suporte a 20 valores de tara predefinidos
- Suporte para g, kg, ton, lb e oz
- Salva 60 mil dados de transações
- Oferece suporte para acúmulo e total acumulativo
- Permite a personalização de cinco modelos de impressão diferentes
- Oferece suporte à calibração sem peso (CalFREE™)

1.2. Especificação do Produto

A Tabela 1-1 mostra as especificações do IND256x.

Tabela 1-1: Especificações do IND256x

Item	Especificação
Gabinete	aço inoxidável, pode ser montado em parede ou poste
Dimensões a × l × p)	173 mm × 230 mm × 127 mm (6,8 pol. 9,1 pol. 5,0 pol.)
Peso para transporte	3,5 kg (8 lb.)
Nível de proteção	IP66
Ambiente de armazenamento	Faixa de temperatura de armazenamento: -20 °C a 60° C (-4 °F a 140 °F) Umidade Relativa: 10% a 95%, sem condensação
Ambiente de manutenção	Faixa de temperatura de operação: -10 °C a 40° C (14 °F a 104 °F) Umidade Relativa: 10% a 95%, sem condensação

Item	Especificação
Área de Risco	A aprovação da IND256x é usada para Zona 1 a Zona 21 de área perigosa.
Fornecimento de energia	Alimentação CA (187-253 V 50/60 Hz)
	Alimentação CC (CC 18-30 V)
	Pacote de baterias externo NiMH (64060627)
Display	LCD de backlight branca com 240 x 96 pixels, e dígitos com altura de 25 mm Taxa de atualização do display: 10 Hz
Display de peso	Máximo de 100.000 divisões
Tipo de plataforma de pesagem	Célula de carga analógica
Quantidade do sensor	Máximo de quatro células de carga de 350 ohm (mínimo de 87 ohm), 2 mv/V ou 3 mv/V
Quantidade da plataforma de pesagem	Suporte para uma plataforma de pesagem
Taxa de atualização	>366 Hz
Tensão de excitação de sensor	4,5 V CC
Sensibilidade mínima	0,6 μ V/e
Teclado	26 teclas; teclado com membrana de 1,5 mm de espessura
Modo de comunicação	Interface padrão: A placa principal é fornecida com uma interface de comunicação RS-232 intrinsecamente segura Opções de interface: Saída analógica intrinsecamente segura de 4-20 mA, com conversão D / A de 16 bits e taxa de atualização de 25 Hz para PLC ou módulo WiFi (apenas em terminais configurados com WiFi) ou loop de corrente ativo Intrinsecamente Seguro ou loop de corrente passivo Intrinsecamente Seguro Protocolos de Comunicação: Entrada de porta serial: Comandos ASCII - CTPZ (Limpar, Tara, Imprimir, Zerar), comandos SICS (suporte a comandos SICS nível 0 e nível 1) Saída de porta serial: Saída contínua Toledo, saída de impressão do comando (5 modelos configuráveis), comando SICS e impressão de relatório
Aprovação metrológica	Europa: OIML R76; Classe III, 6000e; TC10878 Global: OIML R76; Classe III, 6000e; R76-2006-A-NL1-18.27

Item	Especificação
Aprovações para Áreas de Risco, versão WiFi configurada de fábrica	com fonte de alimentação não intrinsecamente segura (versão CA e versão CC): II 2G Ex eb ib [ib] mb IIB T4 Gb II 2D Ex tb [ib] IIIC T60 °C Db com bateria intrinsecamente segura: II 2G Ex ib IIB T4 Gb II 2D Ex tb [ib] IIIC T60 °C Db
Aprovações para Áreas de Risco, versão sem WiFi	com fonte de alimentação não intrinsecamente segura (versão CA e versão CC): II 2G Ex eb ib [ib] mb IIC T4 Gb II 2D Ex tb [ib] IIIC T60 °C Db com alimentação intrinsecamente segura (bateria/APS50x): II 2G Ex ib IIC T4 Gb II 2D Ex tb [ib] IIIC T60 °C Db

Tabela 1-2: Especificação de Módulo WiFi

Item	Especificação
Padrão	802.11 b/g/n
Potência de transmissão	14 dBm (média)
Faixa de Frequência RF	2,4 GHz – 2,497 GHz
Criptografia	WEP, WPA
WEP	64 bits, 128 bits
WPA	WPA-TKIP, WPA2-AES
Protocolo	TCP/IP
Modo de Trabalho	Servidor, Cliente
Distância de Transmissão	Máximo de 50 metros em área aberta
Aprovação	China: SRRC

1.3. Padrões de teste

O terminal IND256x foi testado de acordo com os seguintes padrões.

EN 60079-0:2012 + A11:2013	Requisitos Gerais
EN 60079-7:2015	Aumento da segurança "e"
EN 60079-11:2012	Segurança intrínseca "i"
EN 60079-18:2015	Encapsulamento "m"
EN 60079-31:2014	Proteção por gabinete "t"
IEC 60079-0:2017, Ed. 7.0	Requisitos Gerais

IEC 60079-7:2017, Ed. 5.1	Aumento da segurança "e"
IEC 60079-11:2011, Ed. 6.0	Segurança intrínseca "i"
IEC 60079-18:2017, Ed. 4.1	Encapsulamento "m"
IEC 60079-31:2013, Ed. 2.0	Proteção por gabinete "t"
FM3600 (2011)	Requisitos gerais do equipamento elétrico para uso em Locais Perigosos (Classificados)
FM3610 (2010)	Equipamento intrinsecamente seguro e equipamento associado para uso em Classe I, II e III, Divisão 1 e Locais Perigosos (Classificados)
FM3810 (2005)	Equipamento Elétrico para Uso em Medição, Controle e Laboratórios
ANSI/IEC 60529	Graus de proteção fornecidos por gabinetes (Código IP)
CSA C22.2 No. 157-1992 / 2006	Equipamento intrinsecamente seguro e não inflamável para uso em locais perigosos
CSA C22.2 No. 142-1990 / 2004	Equipamento de controle de processo
CSA C22.2 No. 61010.1-2004	Requisitos de segurança para equipamento elétrico, equipamento de medição, controle e uso em laboratório – Parte 1: Requisitos Gerais
CAN/CSA 22.2 No. 60529-2005	Graus de proteção fornecidos por gabinetes (Código IP)

1.3.1.

Condições especiais para uso seguro

1. O aparelho deve ser protegido de luz UV
2. Carga eletrostática durante a operação e manutenção tem que ser excluída. O terminal só deve ser instalado em áreas onde as cargas eletrostáticas relacionadas ao processo e operacionais não estejam presentes.
3. Para versões não intrinsecamente seguras para fornecimento de CC (o código de tipo termina com "44" ou "46"): Não há uma separação galvânica entre circuitos de abastecimento não intrinsecamente seguro e circuitos de saída intrinsecamente seguros:

O circuito de abastecimento não intrinsecamente seguro tem que ser conectado com segurança à terra. Neste caso, os circuitos intrinsecamente seguros também são aterrados. Junto com os circuitos intrinsecamente seguros, deve haver uma equalização de potencial.

ou

O circuito não intrinsecamente seguro tem que ser separado com segurança da terra (ex. Circuito SELV).
4. Para o terminal versão CC, o circuito de alimentação deve ter uma categoria de sobretensão máxima II de acordo com a IEC 60664-1.
5. Os prensa-cabos Série HSK-M-Ex... e V-Ms-Ex... de acordo com o KEMA 99 ATEX 6971X resp. IECEx BVS 07.0014X são testados com uma força tensora reduzida (25%) de acordo com a cláusula A.3.1 se IEC 60079-0 e só podem ser usados para instalações fixas de um aparelho de grupo II. O usuário deve garantir grampos adequados do cabo.
6. A antena WiFi é testada para baixo risco de perigo mecânico (altura de impacto 0,4 m com 1 kg de massa) e deve ser protegida contra níveis de energia que causem grande impacto.

1.4. Advertências e Precauções

Leia essas instruções com cuidado antes de colocar o novo terminal em operação.

Embora o IND256x seja construído com material resistente, ele continua sendo um instrumento de precisão. Tenha cuidado ao manipular e instalar o terminal.

	 ADVERTÊNCIA
	NÃO INSTALE, DESCONECTE OU REALIZE QUALQUER SERVIÇO NESTE EQUIPAMENTO ANTES QUE PESSOAL AUTORIZADO PELO RESPONSÁVEL LOCAL DO CLIENTE TENHA CONSIDERADO A ÁREA NÃO PERIGOSA.
	 ADVERTÊNCIA
	SOMENTE OS COMPONENTES ESPECIFICADOS NESTE MANUAL PODEM SER USADOS NESTE TERMINAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER INSTALADOS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DETALHADAS NESTE MANUAL. COMPONENTES INCORRETOS OU SUBSTITUTOS E/OU QUE NÃO ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM ESTAS INSTRUÇÕES PODEM PREJUDICAR A SEGURANÇA INTRÍNSECA DO TERMINAL E RESULTAR EM LESÕES CORPORAIS E/OU DANOS MATERIAIS.
	 ADVERTÊNCIA
	NÃO ABRA SE ESTIVER ENERGIZADA.
	 ADVERTÊNCIA
	RISCO POTENCIAL DE CARGA ELETROSTÁTICA - VEJA AS INSTRUÇÕES.
	 ADVERTÊNCIA
	NÃO ABRA QUANDO HOUVER UMA ATMOSFERA EXPLOSIVA.
	 ADVERTÊNCIA
	O TERMINAL MONTADO COM UMA ANTENA WIFI DEVE SER INSTALADO EM UMA POSIÇÃO TAL QUE O RISCO DE DANOS MECÂNICOS SEJAM PEQUENOS. SUBSTITUA A ANTENA WIFI IMEDIATAMENTE SE ESTIVER DANIFICADA!

1.5. Inspeção e Lista de Verificação de Conteúdo

No recebimento do IND256x, verifique se o pacote está intacto. Se a caixa estiver danificada, verifique se o IND256x está danificado e, se necessário, apresente reclamações referente ao frete à transportadora. Se a embalagem não estiver danificada, desembale o IND256x, com atenção à sua embalagem original e verifique se nada está danificado.

- Para garantir o transporte seguro, é melhor usar a embalagem original e o método de embalagem correto.

A caixa de embalagem contém:

Terminal de pesagem IND256x CD de documentação (incluindo manual e certificado de inspeção)

Bolsa de acessórios para uso durante instalação

1.6. Configuração

1.6.1. Configuração do Sistema

A Figura 1-1 mostra as opções de configuração para o terminal

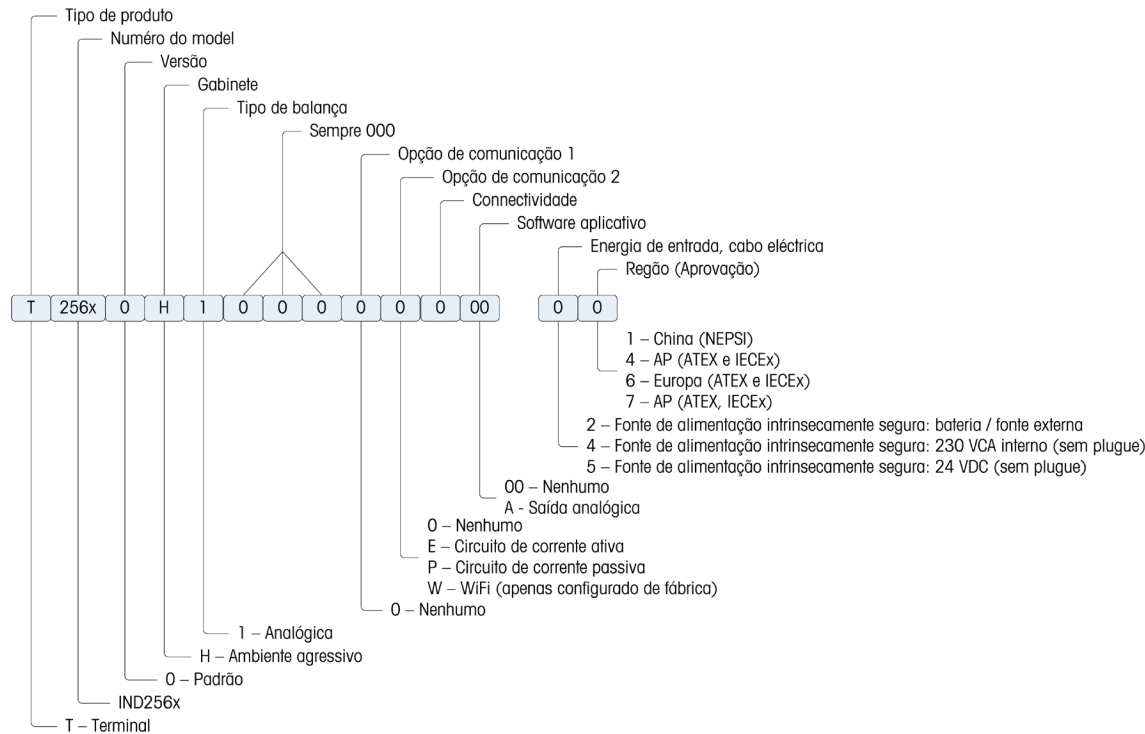


Figura 1-1: Gráfico de Configuração do IND256x

	ATENÇÃO
	OS TERMINAIS IND256x COM WI-FI E CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA SÃO APROVADOS PARA USO EM ÁREAS CLASSIFICADAS COMO ZONA 1, GRUPO DE EQUIPAMENTO IIB. NÃO USE OS TERMINAIS IND256x COM WI-FI E CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA EM ÁREAS CLASSIFICADAS COMO GRUPO DE EQUIPAMENTO IIC. O USO DO TERMINAL IND256x COM WI-FI E CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA EM UMA ÁREA CLASSIFICADA PARA A QUAL ELE NÃO FOI APROVADO PODE CAUSAR LESÕES FÍSICAS E/OU DANOS À PROPRIEDADE.
	AVISO
A CAPACIDADE DE WIFI ESTÁ APENAS DISPONÍVEL NOS TERMINAIS IND256x CONFIGURADOS ASSIM NA FÁBRICA.	

1.6.2. Código de Datas do Produto

A data de fabricação ou o código de datas do terminal podem ser encontrados na placa de dados de série (no topo do gabinete).

O número de série começará com uma letra e um número (por exemplo, B212000371). A letra representa os primeiros três dígitos do ano pela tabela de código de datas na Tabela 1-3 (a letra "B" no nosso exemplo representa "201x") e o número é o dígito da unidade do ano (o número "2" no nosso exemplo). Portanto, "B4" decodifica como o ano 2014.

Tabela 1-3: Formatos de Código de Data Atual e Data Posterior

Código de datas	Ano	Código de datas	Ano
A	200x	F	205x
B	201x	G	206x
C	202x	H	207x
D	203x	J	208x
E	204x	K	209x

1.6.3. Conexões

A figura a seguir mostra as localizações de conexão na parte posterior do gabinete para ambientes adversos.

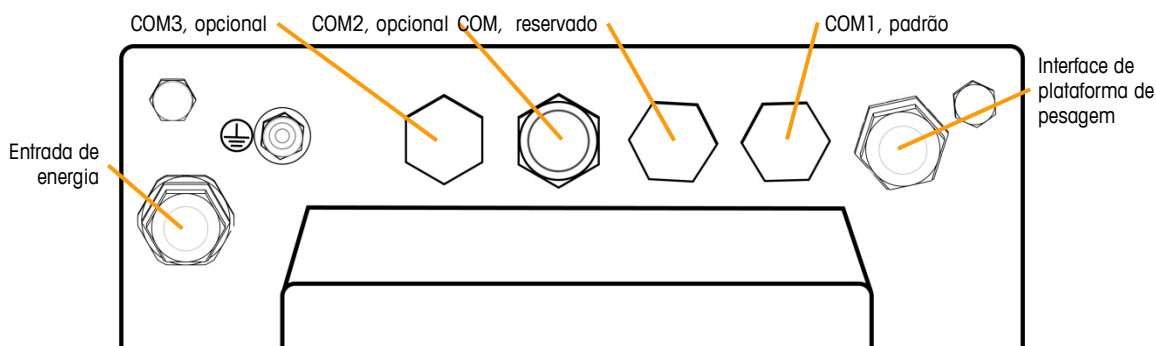


Figura 1-2: Localizações de Portas de Conexão do IND256x

Entrada de energia	Entrada de fonte de alimentação CA 220V (187-250 V 50/60 Hz) (versão ATEX e IECEx) <i>ou</i> entrada de fonte de Alimentação CC 24 V (18V-30 V) (versão ATEX e IECEx) <i>ou</i> bateria Ex externa
COM1 (padrão)	Intrinsecamente seguro RS-232
COM2 (opcional)	Saída analógica intrinsecamente segura 4-20 mA <i>ou</i> módulo de comunicação WiFi (apenas configurado de fábrica)
COM3 (opcional)	Loop de corrente ativo intrinsecamente segura

ou loop de corrente passiva intrinsecamente segura

COM Reservada

Não utilizado

1.6.4. Avisos

1.6.4.1. CENELEC

Conexão de Ligação Equipotencial conforme Regulamentação Específica de cada País: É necessário assegurar que os compartimentos de todos os dispositivos estejam conectados ao mesmo potencial através dos terminais de conexão equipotencial. Nenhuma corrente circulante pode fluir pela blindagem do cabeamento intrinsecamente seguro.

1.6.4.2. cFMus

Conexão de EB por ANSI/NFPA 70, Artigo 504 e ANSI/IA RP 12.06.01 ou Código Elétrico Canadense C22.2: É necessário assegurar que os compartimentos de todos os dispositivos estejam conectados ao mesmo potencial através dos terminais de conexão equipotencial. Nenhuma corrente circulante pode fluir pela blindagem do cabeamento intrinsecamente seguro.

1.7. Ligação Equipotencial (EB)

A Ligação Equipotencial deve ser instalada por um eletricista autorizado pelo proprietário. O Serviço da METTLER TOLEDO executa apenas uma função de monitoramento e consolidação deste procedimento.

Conecte a ligação equipotencial de todos os serviços (unidade de fonte de alimentação, terminal de pesagem, conversor de interface e plataforma de pesagem) de acordo com o diagrama do terminal e todas as regulamentações e normas específicos do país. No processo, é necessário assegurar que:

- Todos os compartimentos de dispositivos estejam conectados ao mesmo potencial através de terminais de ligações equipotenciais.
- A corrente não circulante flua através da blindagem de cabos para circuitos intrinsecamente seguros.
- O ponto neutro para a ligação equipotencial está o mais próximo possível do sistema de pesagem.

1.8. Ambiente de Operação

Ao selecionar uma localização:

- Escolha uma superfície estável e livre de vibração para montar o terminal.
- Certifique-se de que não haja flutuações excessivas na temperatura e **não haja exposição direta à luz do sol**.
- Evite correntes de ar na plataforma de pesagem (por exemplo, das janelas abertas ou de ar condicionado)

- Calibre o terminal após qualquer mudança significativa na localização geográfica

1.8.1.1.

Temperatura e Umidade

O IND256x pode ser armazenado nas condições de temperatura e umidade relativa estabelecidas em Ambiente de Operação em Tabela 1-1.

1.8.1.2.

Proteção Ambiental

O terminal IND256x tem proteção ambiental conforme especificado em Tabela 1-1.

1.9. Dimensões

As Figuras 13 e 14 mostram as dimensões do terminal. As unidades são polegadas e [mm].

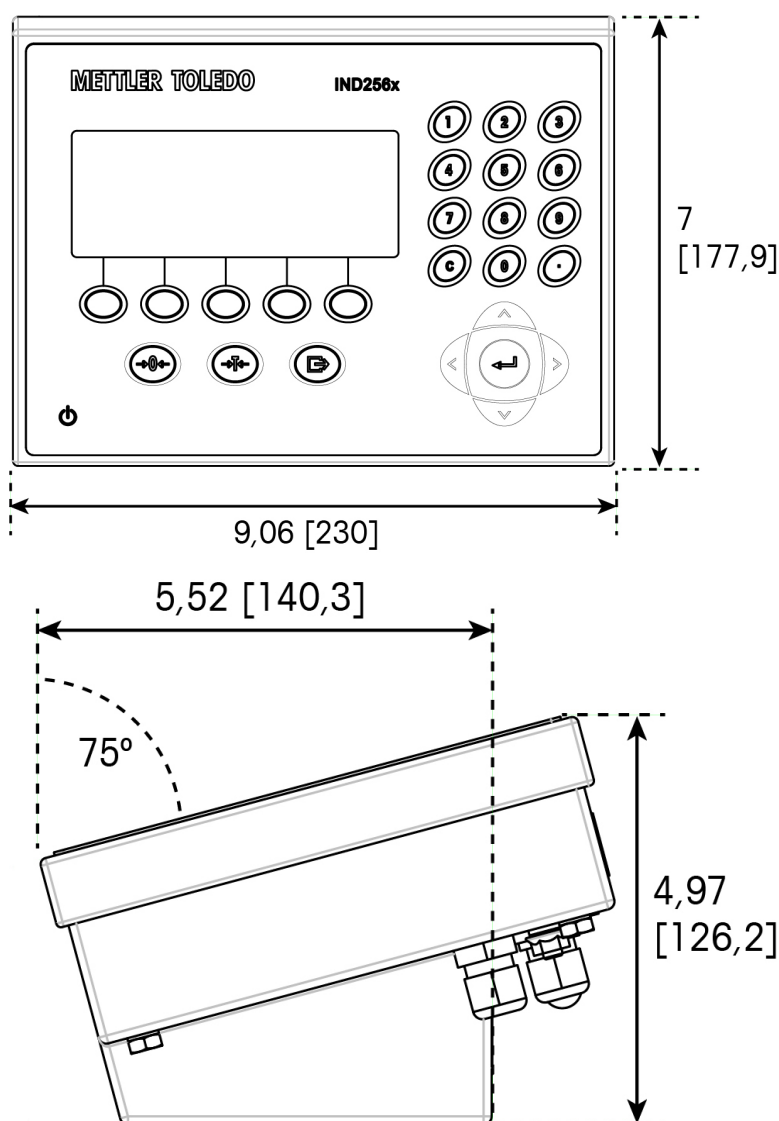


Figura 1-3: Dimensões do IND256x, Instalação em Bancada

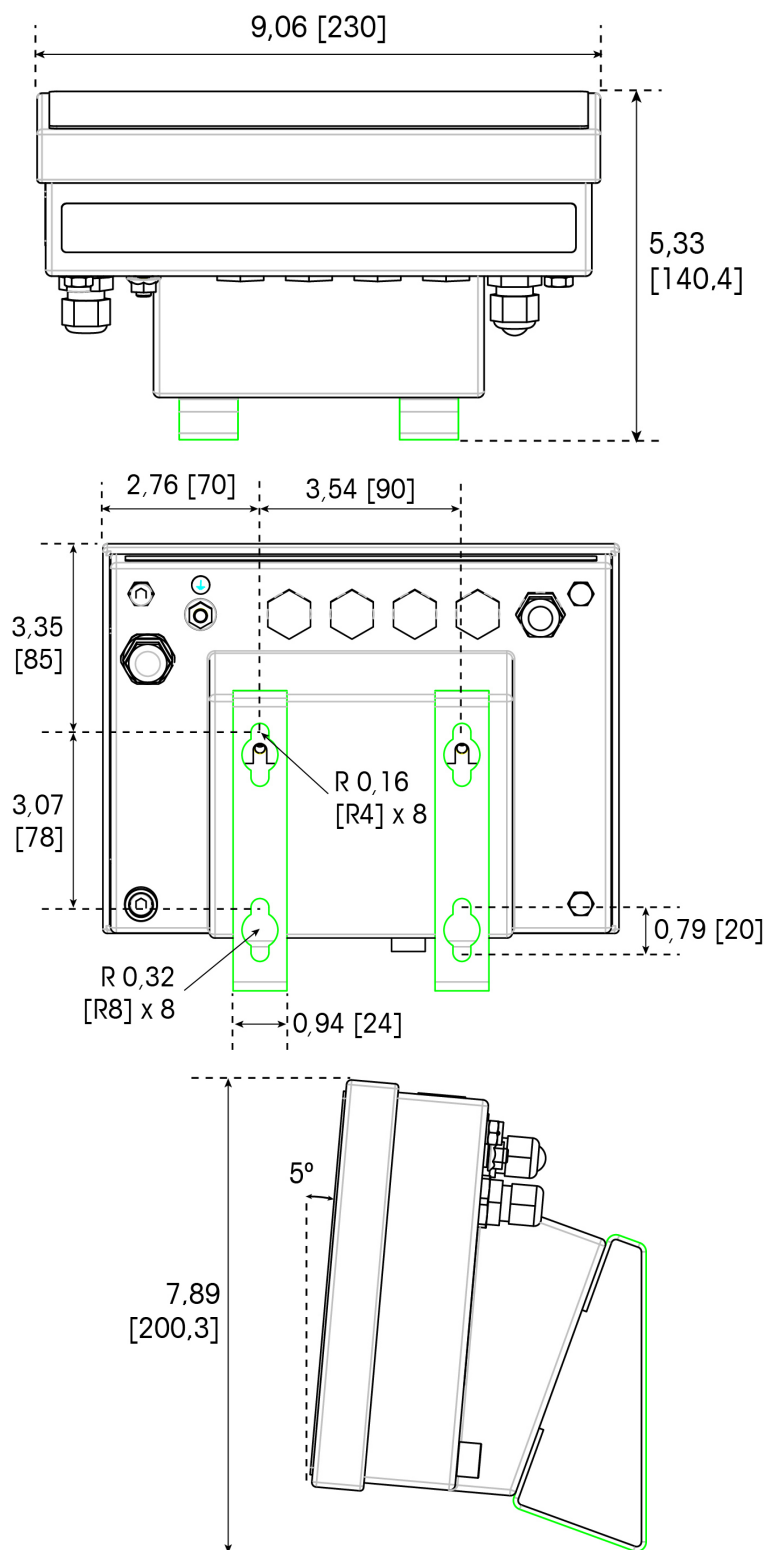


Figura 1-4: Dimensões IND256x, com suporte fixo de montagem na parede

1.10. Placa Principal

A placa principal do IND256x tem as seguintes conexões principais, indicadas em Figura 1-5:

1. Interface analógica de pesagem de célula de carga
2. Interface de entrada de alimentação intrinsecamente segura, conectando o módulo de potência
3. Interface de arnês de fita plana, usada para conectar o display
4. Interface RS-232 intrinsecamente segura (COM1)
5. Duas interfaces de placa opcional de comunicação (COM2 e COM3)

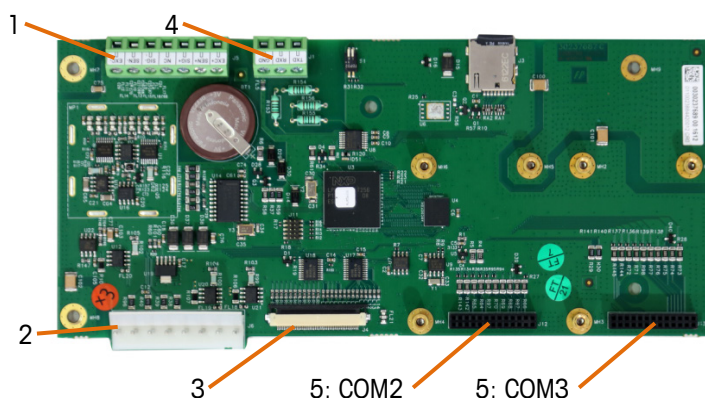


Figura 1-5: Placa Principal do IND256x

1.11. Placas Opcionais de Comunicação

O IND256x pode ser configurado com um máximo de duas ou três placas opcionais de comunicação instaladas dentro do gabinete. As opções são:

- Módulo de Comunicação por WiFi (disponível apenas nos terminais IND256x configurados de fábrica com WiFi)
- Saída analógica intrinsecamente segura de 4-20 mA
- Loop de corrente ativo para conexão ao módulo de comunicação ACM200 localizado na área segura, ou para conectar o segundo terminal IND256x configurado com opção de loop de corrente passivo
- O loop de corrente passivo (usado como o segundo display para conectar outro IND256x com loop de corrente ativo)

2 Instalação

2.1. Como Abrir o Gabinete

	 ADVERTÊNCIA
	NÃO INSTALE, DESCONECTE OU REALIZE QUALQUER SERVIÇO NESTE EQUIPAMENTO ANTES QUE PESSOAL AUTORIZADO PELO RESPONSÁVEL LOCAL DO CLIENTE TENHA CONSIDERADO A ÁREA NÃO PERIGOSA.
	 CUIDADO
	CONFIRME A CONFORMIDADE COM REGULAMENTOS NACIONAIS E LOCAIS DE WIFI ANTES DE INSTALAR E COMISSONAR O TERMINAL IND256x CONFIGURADO COM MÓDULO WIFI. A METTLER TOLEDO NÃO SE RESPONSABILIZA PELA INSTALAÇÃO DE TERMINAIS EM PAÍSES NOS QUAIS OS REGULAMENTOS DE WIFI NÃO FOREM CUMPRIDOS.
	 ADVERTÊNCIA
	EVITE A IGNIÇÃO DE GÁS PERIGOSO. CORTE A ENERGIA ANTES DA ABERTURA DO GABINETE DO IND256X. APÓS O IND256X TER SIDO LIGADO, MANTENHA O GABINETE BEM VEDADO. NÃO ABRA A CAIXA NA PRESENÇA DE PÓ OU GÁS EXPLOSIVOS.

Abra o terminal IND256x de acordo com as etapas nas seções seguintes.

A tampa frontal do terminal IND256x está presa por 4 parafusos. Para a configuração de hardware dentro do instrumento, abra como mostrado abaixo:

1. Coloque o terminal virado para baixo em uma superfície plana, com cuidado para não danificar a frente do terminal.
2. Desaparafuse os quatro parafusos prisioneiros indicados na Figura 2-1.



Figura 2-1: Parafusos do gabinete

3. Erga a tampa posterior e vire-a para expor a parte interna. Observe as duas faixas que prendem o painel frontal ao gabinete.

2.2. Instalação de Cabos e Conectores

Os cabos e conectores do terminal IND256x estão da seguinte forma:

- Prensa-cabo de gabinete para ambiente adverso
- Conexões de Fiação de Placa Principal
- Conexão de Energia

	ADVERTÊNCIA
	APENAS PESSOAL DE SERVIÇO PROFISSIONAL TEM AUTORIZAÇÃO PARA OPERAR ESTE INSTRUMENTO. TENHA CUIDADO DURANTE A INSPEÇÃO, O TESTE E O AJUSTE. A OPERAÇÃO INCORRETA PODE RESULTAR EM FERIMENTOS.

O terminal IND256x é adequado para ambientes de lavagem pesada e empoeirados. No entanto, é necessário acessar a parte interna do gabinete do terminal ao instalar cabos e/ou conectores. Cada cabo que entra pelo gabinete está alocado em uma posição específica.

2.2.1. Prensa-Cabo do Gabinete para Ambiente Hostil

Para assegurar a resistência à água e a vedação à entrada de pó:

1. Passe o cabo de tamanho apropriado através do prensa-cabo correto antes de conectar os fios. Dependendo do tamanho do prensa-cabo, devem ser utilizados cabos de um diâmetro específico. Os tamanhos de cabo necessários são mostrados na Tabela 2-1.

Tabela 2-1: Diâmetros de Cabos para Prensa-Cabos

Prensa-Cabos	Diâmetro do cabo
Célula de carga analógica	6–10 mm (0,24 – 0,39 pol.)
COM1 (IS-RS232)	6–10 mm (0,24 – 0,39 pol.)

Prensa-Cabos	Diâmetro do cabo
Loop de corrente (ativa e passiva)	6–10 mm (0,24 – 0,39 pol.)
Cabo de energia CA/CC	6–10 mm (0,24 – 0,39 pol.)
Bateria externa	4-8 mm (0,16 – 0,39 pol.)

Avisos importantes

- Devem ser utilizados apenas prensa-cabos e tampões certificados pela ATEX com o terminal IND256x.
 - As prensa-cabos devem ser protegidas contra danos causados or impacto.
 - O alívio de tensão suficiente deve ser assegurado para evitar forças de tração nos prensa-cabos.
2. Ao fazer terminações de cabo dentro do gabinete resistente, certifique-se de que o tamanho do cabo da faixa/conector do terminal ao gabinete até o terminal seja suficiente para que não seja aplicada nenhuma força no conjunto do conector quando o gabinete estiver na posição totalmente aberto.
 3. Todos os cabos que incluem blindagem devem ter a blindagem terminada no prensa-cabo conforme mostrado na Figura 2-2. Distribua os fios blindados e se certifique de que haja fio com blindagem suficiente para estabelecer um bom contato com a parte de metal do cabo-prensa.

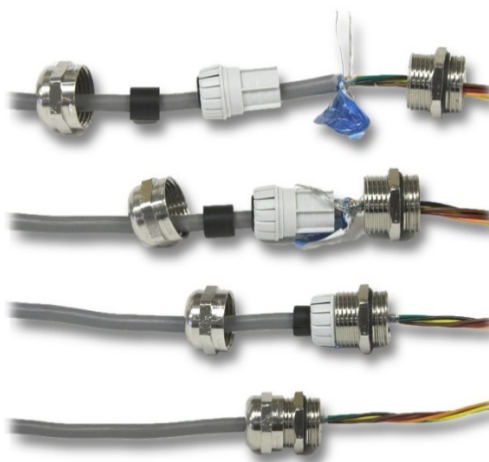


Figura 2-2: Terminação de Blindagem no Prensa-Cabos

2.2.2.

Conexão de Energia

	 ADVERTÊNCIA
	A CONEXÃO ELÉTRICA DA FONTE DE ENERGIA DEVE SER EXECUTADA POR UM ELETRICISTA PROFISSIONAL AUTORIZADO PELO PROPRIETÁRIO E DE ACORDO COM O RESPECTIVO DIAGRAMA DE TERMINAL, AS INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E TAMBÉM REGULAMENTAÇÕES ESPECÍFICAS DO PAÍS.

Em locais que aceitam IECEx e ATEX, o IND256x pode ser alimentado por uma fonte de alimentação interna conectada a uma entrada de energia CA 230 V.

A energia é conectada através de um conector de maior segurança no canto direito interno do gabinete (Figura 2-3). O conector está protegido por uma tampa plástica.

O terminal é fornecido com um cabo de energia de 5 metros, sem plugue.

2.2.2.1.

Entrada de Energia CA Interna (Terminais Aprovados pela IECEx e ATEX Apenas)

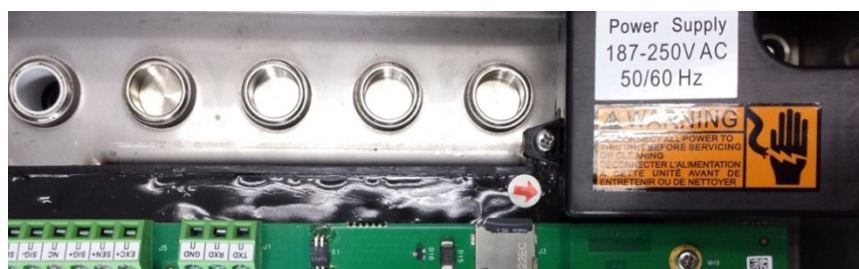


Figura 2-3: Conector de Entrada de Energia CA com Tampa



Figura 2-4: Conector de Entrada de Energia CA, Tampa Removida

Tabela 2-2: Código de Cor do Cabo de Entrada de Energia CA

Pino	Cor do pino
A	Marrom
N	Azul

2.2.2.2.

Entrada de Energia CA Interna (apenas terminais aprovados pela IECEx e ATEX)

	 ADVERTÊNCIA
	A FONTE DE ALIMENTAÇÃO CC DEVE SE CONECTAR A UMA ENTRADA 18 A 30 V CC. NÃO CONECTE A ENERGIA CA
	 ADVERTÊNCIA
	PARA OS TERMINAIS DE VERSÃO CC DO IND256X, NÃO HÁ SEPARAÇÃO GALVÂNICA ENTRE O CIRCUITO DE FORNECIMENTO NÃO INTRINSECAMENTE SEGURO E OS CIRCUITOS DE SAÍDA INTRINSECAMENTE SEGUROS. O CIRCUITO NÃO INTRINSECAMENTE SEGURO DEVE ESTAR CONECTADO COM SEGURANÇA À TERRA. E A EQUALIZAÇÃO POTENCIAL DEVE EXISTIR AO LONGO DE CIRCUITOS INTRINSECAMENTE SEGUROS. ALTERNATIVAMENTE, O CIRCUITO DE FORNECIMENTO NÃO INTRINSECAMENTE SEGURO (SELV) DEVE SER SEPARADO DO TERRA COM SEGURANÇA.





ADVERTÊNCIA

A FONTE DE ALIMENTAÇÃO CC EXTERNA FORNECIDA PELO CLIENTE DEVE TER UMA CATEGORIA MÁXIMA DE SOBRETENSÃO II, DE ACORDO COM A IEC 60664-1.

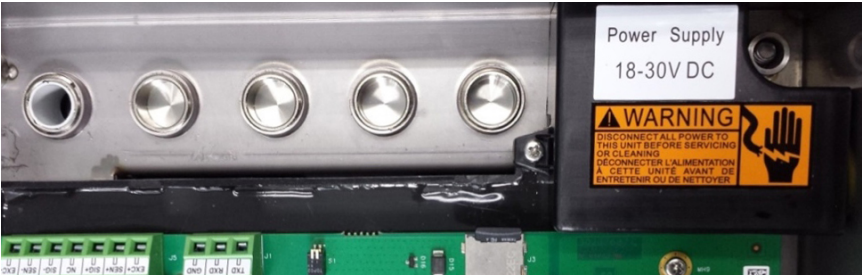


Figura 2-5: Conector de Entrada de Energia CC com Tampa

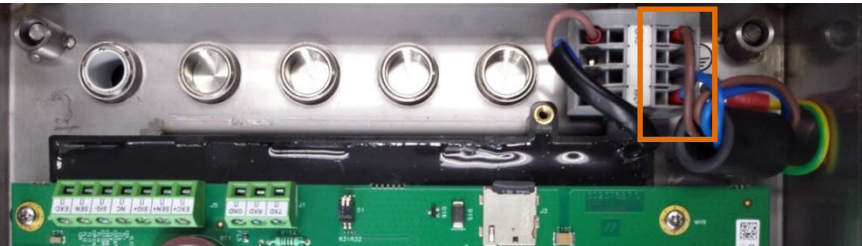


Figura 2-6: Conexões de Entrada de Energia CC, Vista Interna

Tabela 2-3: Código de Cor de Cabo de Entrada de Energia CC

Pino	Cor do pino
TERRA	Marrom
+24V	Azul

2.2.2.3. Entrada para Fonte de Alimentação Externa NiMH

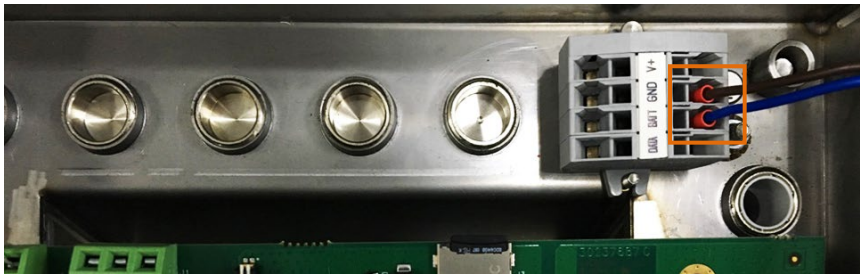


Figura 2-7: Conexões de Entrada de Bateria NiMH, Vista Interna

Tabela 2-4: Código de Cor do Cabo de Entrada de Bateria NiMH

Pino	Cor do pino
DADOS	Vazio
BAT	Azul

Pino	Cor do pino
TERRA	Marrom
V+	Vazio

2.3. Conexão e Aterramento

Todas as conexões de aterramento e compensação de potencial devem ser efetuadas de acordo com as regulamentações locais baseadas no país de instalação. Consulte as normas locais e os desenhos de controle para informações mais específicas sobre aterramento.

É comum que as regulamentações exijam que todas as peças conectadas do equipamento a um sistema intrinsecamente seguro sejam conectadas e aterradas em um único ponto. Um parafuso especial terra externo criado para fins de compensação de potencial é fornecido no terminal IND256x (Figura 2-8).



Figura 2-8: Parafuso Terra do Terminal IND256x

2.4. Ligação Equipotencial (EB)

A Ligação Equipotencial deve ser instalada por um eletricista autorizado pelo proprietário. O Serviço da METTLER TOLEDO executa apenas uma função de monitoramento e consolidação deste procedimento.

Conecte a ligação equipotencial de todos os serviços (unidade de fonte de alimentação, terminal de pesagem, conversor de interface e plataforma de pesagem) de acordo com o diagrama de terminal e todas as regulamentações e padrões específicos do país. No processo, é necessário assegurar que:

- Todos os compartimentos de dispositivos sejam conectados ao mesmo potencial através de terminais de ligações equipotenciais.
- A corrente não circulante flui através da blindagem de cabos para circuitos intrinsecamente seguros.

- O ponto neutro para a ligação equipotencial está o mais próximo possível do sistema de pesagem.

2.4.1. Avisos

2.4.1.1. CENELEC

2.4.1.1.1. Conexão de Ligação Equipotencial conforme Regulamentação Específica de cada País

É necessário assegurar que os compartimentos de todos os dispositivos estejam conectados ao mesmo potencial através dos terminais de conexão equipotencial. Nenhuma corrente circulante pode fluir pela blindagem do cabeamento intrinsecamente seguro.

2.4.1.2. cFMus

2.4.1.2.1. Conexão de Ligação Equipotencial por ANSI/NFPA 70, Artigo 504 e ANSI/IA RP 12.06.01 ou Código Elétrico Canadense C22.2

É necessário assegurar que os compartimentos de todos os dispositivos estejam conectados ao mesmo potencial através dos terminais de conexão equipotencial. Nenhuma corrente circulante pode fluir pela blindagem do cabeamento intrinsecamente seguro.

2.5. Fechamento do Gabinete

Para assegurar que a tampa frontal esteja corretamente instalada:

- Coloque a tampa frontal em uma superfície plana
- Certifique-se de que o anel de vedação esteja corretamente posicionado
- Instale a tampa posterior e certifique-se de que ela esteja corretamente posicionada
- Instale os parafusos nas posições originais
- Aperte cada parafuso a 3,0 Nm

2.6. Conexão Analógica de Célula de Carga

As células analógicas estão conectadas à placa principal no conector mostrado no Capítulo 1, Introdução.

O terminal IND256x é projetado para alimentar até quatro células de carga de 350 ohms (ou uma resistência mínima de aproximadamente 87 ohms). Para confirmar que a carga de célula para esta instalação esteja dentro dos limites, a resistência total da balança (TSR) deve ser calculada da seguinte forma:

Para calcular o TSR:

$$\text{TSR} = \frac{\text{Resistência de Entrada de Célula de Carga (}\Omega\text{hms)}}{\text{Número de Células}}$$


Certifique-se de que o TSR da rede de célula de carga a ser conectado ao IND256x tenha uma resistência maior do que 87 ohms antes de conectar as células de carga. Se a resistência for inferior a 87 ohms, o IND256x não vai operar adequadamente.

Além disso, a distância máxima do cabo deve ser revista. Tabela 2-5 Fornece comprimentos máximos de cabos recomendados com base no calibre do cabo e na operação correta do terminal. Observe se os valores da entidade para o cabo de célula da carga devem ser considerados como um fator de segurança na instalação.

Tabela 2-5: Extensões Máximas de Cabo Recomendáveis

TSR (Ohms)	Calibre 24 (metros/pés)	Calibre 20 (metros/pés)	Calibre 16 (metros/pés)
Uma a quatro células de 350 Ω	60200	182600	3041000

Figura 2-9 mostra a fiação para células de carga analógicas. Quando uma célula de quatro condutores é usada, +Exc deve ser ligada por jump em +Sen e -Exc em jump a -Sen.

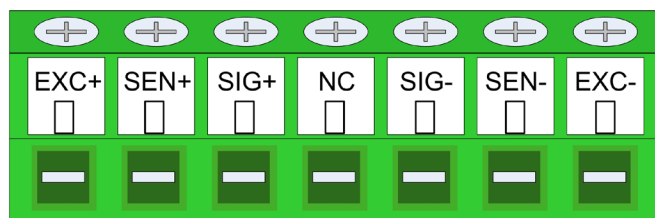

OBSERVAÇÕES


1. BITOLA DO FIO: 18 AWG (0.823 mm²) MÁX., 24 AWG (0.205 mm²) MIN.
2. TERRA DE CHASSIS: GLÂNDULA DE METAL

Figura 2-9: Terminação da Célula de Carga

2.7. Conexão de Placas de Comunicação

2.7.1. Porta Serial (COM1)

A porta COM1 inclui conexões para um dispositivo serial intrinsecamente seguro. Figura 2-10 indica o conector de porta COM1. O comprimento de cabo desta conexão está limitado a 10 metros (33 pés).



IND256x	Sinal
J1 - 1	TxD – enviar dados
J1 - 2	RxD – receber dados
J1 - 3	TERRA - terra lógico

Figura 2-10: Sinais de Porta COM1

Um exemplo de conexão a um dispositivo RS-232 em uma área segura da barreira de diodo Zener é mostrada na Figura 2-11. Consulte os valores de aprovação da entidade da porta COM1 ao selecionar uma barreira. Observe que as vedações e outros dispositivos de proteção também serão necessários para cumprir os códigos de fiação em área perigosa.

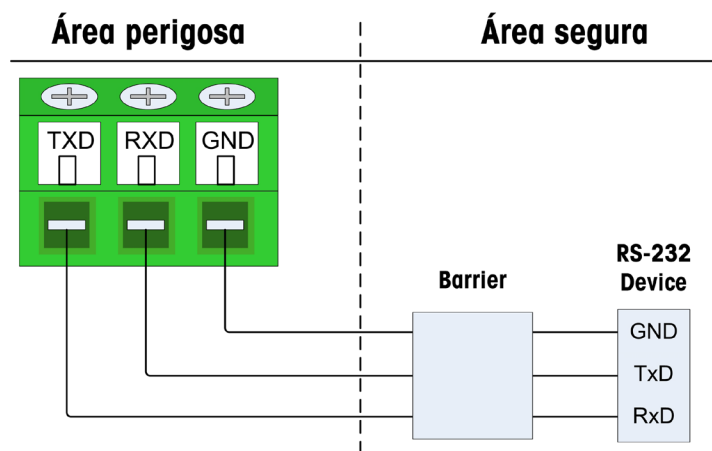


Figura 2-11: Conexão RS-232 de Amostra

Uma barreira que foi testada quanto à operação correta com o IND256x e pode ser conectada diretamente à COM 1 é:

- MTL7761Pac (aprovações de IECEx e ATEX)

2.7.2. Loop de Corrente Ativa


A placa de opcionais com loop de corrente ativa somente pode ser instalada no soquete COM3 na placa principal. Quando o IND256x estiver conectado à ACM200, é necessário conectar o ACM200 usando o loop de corrente ativa para atingir a comunicação na área de segurança.

Tabela 2-6: Conexões de Loop de Corrente Ativa para ACM200

IND256x COM3 (J2)	ACM200 COM (J3)
1	4
2	3
3	2
4	1

Cabos específicos do cliente para circuitos intrinsecamente seguros devem ser personalizados da seguinte forma:

	IND256x – ACM200
Cabo	2 x 2 x 0,5 mm ²
Dimensão A (IND256x)	110 mm (2,4 pol.)
Dimensão B (ACM200)	70 mm (2,8 pol.)
Comprimento máx.	300 m (1000 pés)

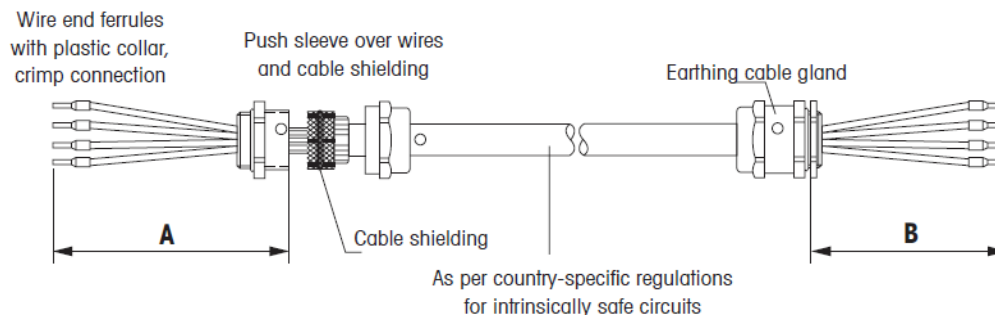

1. Corte o cabo no tamanho correto e descasque as pontas do cabo de acordo com a dimensão A/B.
2. Reduza a blindagem do cabo nos dois lados a 10 mm (0,4 pol.).
3. Descasque as pontas do fio.
4. Crimpe as ferrulas da extremidade do fio nas extremidades do fio com uma ferramenta de crimpagem.
5. Empurre a segunda seção posterior do prensa-cabo de aterramento para dentro do cabo.
6. Aplique a blindagem de cabo apenas na extremidade do IND256x empurrando a manga sobre a blindagem de fios e cabos e dobrando-a sobre a blindagem do cabo.
7. Empurre a seção frontal do prensa-cabo e aparafuse-a na seção posterior.

2.7.3.

Loop de Corrente Passiva

Se o terminal IND256x estiver conectado a outro sistema de pesagem IND256x como display remoto, a interface de loop de corrente passiva deve estar conectada ao loop de corrente ativa de outro terminal do IND256x. O loop de corrente passiva somente pode ser instalado no soquete COM3 na placa principal.

Tabela 2-7: Conexão de Loop de Corrente Passiva entre Terminais

COM3 do IND256x (loop de corrente passiva J4) (Display remoto)		IND256x COM3 (loop de corrente ativa J2) (Instrumento de conexão à plataforma de pesagem)
1	←→	1
2	←→	2
3	←→	3
4	←→	4

2.7.4.

Saída Analógica 4-20 mA Intrinsecamente Segura

As placas de comunicação analógicas 4-20 mA intrinsecamente seguras conectam-se à porta COM2 na placa principal IND256x. Isso fornece um sinal analógico intrinsecamente seguro de 4-20 mA, proporcional ao peso aplicado à balança ou à taxa de mudança na balança. O comprimento máximo do cabo da conexão de Saída Analógica é de 300 m (980 pés). O cabo utilizado para o sinal de saída analógica deve ser blindado.

- Esta opção não pode ser utilizada com a opção WiFi.



Figura 2-12: Placa de Opção de Saída Analógica Intrinsecamente Segura

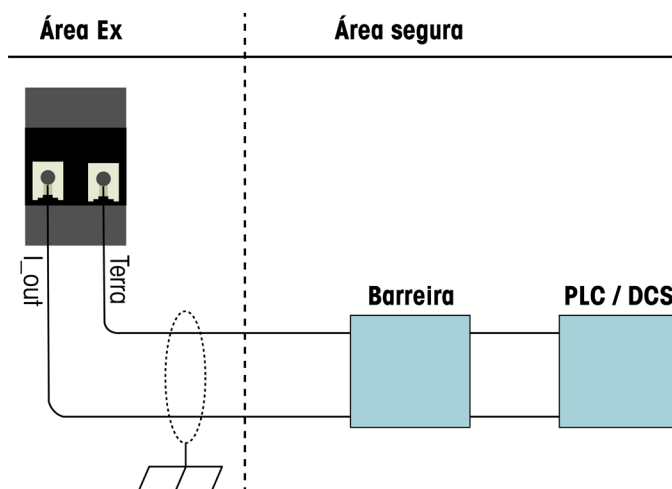


Figura 2-13: Fiação de Saída Analógica

A barreira isolada analógica KFD2-STC4-EX1 produzida pela P&F (números de certificados: IECEx BAS 04.0016X; BAS 99 ATEX 7060X) foi verificada e pode ser conectada diretamente à opção de 4-20 mA analógica intrinsecamente segura da IND256x e, em seguida, conectada a um sistema CLP ou SCD na área segura.

2.7.5. Comunicação sem Fio

A placa opcional de comunicação sem fio da IND256x é instalada na placa principal com outras placas opcionais e não é conectada aos periféricos. A opção deve ser configurada conforme descrito no Capítulo 3, seção 3.8.4. Um forte sinal WiFi é necessário para atingir a comunicação sem fio com periféricos.

A IND256x permite uma única opção WiFi.

- Esta opção não pode ser utilizada com saída analógica 4-20 mA intrinsecamente segura.



Figura 2-14: Placa de Opção de WiFi e Antena da IND256x

2.8. Vedação do Gabinete

Quando o IND256x estiver no modo "Aprovação", é necessário ter uma vedação externa.

Os detalhes da vedação de cabos do IND256x são mostrados na Figura 2-15. O procedimento é o seguinte:

1. Determine se a área correta foi selecionada em **Balança > Tipo > Aprovação** e defina a chave de metrologia SW1-1 para ON (consulte o Capítulo 2, **Operação**, para a localização e função dessa chave).
2. Passe o fio de vedação através de dois parafusos de vedação adjacentes e, em seguida, fixe o retentor de vedação como mostrado na Figura 2-15.
3. Corte o fio de vedação excedente.

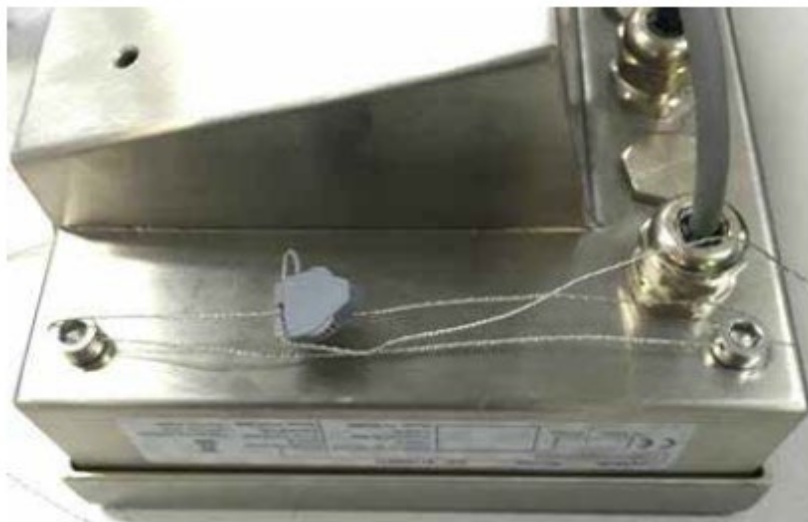


Figura 2-15: Método de Vedação

2.9. Parâmetros da Interface

2.9.1. Circuito de Alimentação (Porta de Alimentação)

Circuito de alimentação	Parâmetros
Variante com fonte de alimentação CA não intrinsecamente segura (código do tipo termina com "46" ou "44") (apenas aprovado por ATEX e IECEx) Cabo permanentemente conectado com ponteira.	Tensão nominal: CA 187...250 V (50/60 Hz) Corrente nominal: 125 mA Tensão máxima de entrada: Um AC 250 V
Variante com fonte de alimentação CC não intrinsecamente segura (código do tipo termina com "56" ou "54") (apenas aprovado por ATEX e IECEx) Cabo permanentemente conectado com ponteira: Azul: +24V, marrom: terra, verde-amarelo: PE	Tensão nominal: CC 18...30 V Corrente nominal: 250 mA Tensão máxima de entrada em aparelho associado: Um AC 250 V (Observação: a tensão nominal é menor)
Variante com fonte de alimentação CC intrinsecamente seguras (bateria) (código de tipo termina com "25" ou "27") Terminais de conexão: V+, GND, BATT, DATA	Tensão nominal de entrada: CC 10 V Corrente nominal de entrada: 350 mA
	Tensão máxima de entrada: Ui CC 12,8 V Corrente de entrada máxima: Ii 3.03 A Energia de entrada máxima: Pi 6.83 W
	Indutância interna efetiva: Li negligenciável Capacitância interna efetiva: Ci negligenciável

2.9.2. Interface intrinsecamente Segura RS-232

Interface intrinsecamente segura RS-232	Parâmetros
Terminais J1.1 (TXD), J1.2(RXD) – J1.3 (GND)	Tensão máxima de entrada: Ui CC ± 10 V Capacitância interna efetiva: Ci negligenciável Indutância interna efetiva: Li negligenciável
	Tensão máxima de entrada: Uo DC J1.1-GND resp. J1.2-GND cada: $\pm 5,36$ V
	Tensão máxima de saída: Io J1.1-GND resp. J1.2-GND cada: $\pm 12,9$ mA
	Tensão máxima de saída: Po J1.1-GND resp. J1.2-GND cada: 17,2 mW
	Capacitância externa máxima: Co 100 nF Indutância externa máxima: 100 μ H

2.9.3. Saída Intrinsecamente Segura para Conexão a uma Célula de Carga

Saída intrinsecamente segura para conexão a uma célula de carga	Parâmetros
Terminais J5.1 (EXC+), J5.2 (SEN+), J5.3 (SIG+), J5.5 (SIG-), J5.6 (SEN-), J5.7 (EXC-)	Tensão máxima de entrada: Uo CC 5,88 V
	Tensão máxima de saída: Io 171 mA
	Tensão máxima de saída: Po 940 mW
	Capacitância externa máxima: Co 6,8 µF Indutância externa máxima: Lo 0,3 mH

2.9.4. Interfaces das Placas de Comunicação Opcionais

Interfaces das placas de comunicação opcionais	Parâmetros
Interface de 4-20 mA intrinsecamente segura Apenas para variantes com placa de opção de saída analógica (código de tipo "A") Terminais J2.1 (I_OUT) – J2.2 (GND)	Tensão máxima de entrada: Ui CC 3,5 V
	Corrente de entrada máxima: Ii 115 mA
	Capacitância interna máxima: Ci 110nF
	Indutância interna máxima: Lo 0 mH
	Tensão máxima de entrada: Uo CC 13,65 V
	Tensão máxima de saída: Io 115 mA
WiFi-antena-conexão Apenas para variantes com placa de opção de WiFi (código de tipo "W") Conector IPEX para conexão com o tipo de antena externa AC-Q24-50ZD	Tensão máxima de saída: Po 0,4 W
	Capacitância externa máxima: Co 680 nF
	Indutância externa máxima: 400 µH
	Potência-RF máxima: < 1,3 W
	Frequência: 2400 a 2483 MHz
Interface-loop de corrente ativo intrinsecamente segura Apenas para variantes com placa de opção de loop de corrente ativo (código de tipo "E") Bloco de terminais J2, terminais J2.1...J2.4 (LC ativo)	Tensão máxima de entrada: Uo CC 5,36 V
	Tensão máxima de saída: Io 131 mA
	Tensão máxima de saída: Po 176 mW
	Capacitância externa máxima: Co 600 nF Indutância externa máxima: 400 µH
Interface-loop de corrente passivo intrinsecamente segura Apenas para variantes com placa de opção de loop de corrente passivo (código de tipo "P") Bloco de terminais J4, terminais J4.1...J4.4 (LC passivo)	Tensão máxima de entrada: Ui CC 10 V
	Corrente de entrada máxima: Ii 300 mA
	Energia de entrada máxima: Pi 500 mW
	Capacitância interna efetiva: Ci 110 nF Indutância interna efetiva: Li negligenciável

2.9.5. Faixa de temperatura ambiente

Parâmetros
Faixa de temperatura ambiente: Ta -10 °C a +40 °C

METTLER TOLEDO Service

To protect your product's future:

Congratulations on choosing the quality and precision of METTLER TOLEDO. Proper use according to these instructions and regular calibration and maintenance by our factory-trained service team ensure dependable and accurate operation, protecting your investment. Contact us about a service agreement tailored to your needs and budget.

We invite you to register your product at www.mt.com/productregistration so we can contact you about enhancements, updates and important notifications concerning your product.

www.mt.com

For more information

Mettler-Toledo, LLC
1900 Polaris Parkway
Columbus, OH 43240

© 2019 Mettler-Toledo, LLC
30491430 Rev. 02, 11/2019



30491430